



2026-01-1326

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ, 32/25 in 112/25 – odl. US) in v zvezi s 26., 27. in 28. členom Zakona o digitalizaciji zdravstva (Uradni list RS, št. 100/25) ministrica za zdravje izdaja

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov

I. POGLAVJE
SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik ureja podrobnejše pogoje glede:

- organizacije in načina dela službe nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: služba NMP);
- organizacije in pogojev za izvajanje nujnih reševalnih prevozov pacientov in nenujnih prevozov;
- kadra, prostorov in opreme službe NMP;
- delovanja prvih posredovalcev v službi NMP;
- zagotavljanja zdravstvenega varstva osebam na javnih prireditvah in javnih shodih v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja (v nadaljnjem besedilu: prireditve).

(2) Organizacijo in način financiranja službe NMP v turističnih območjih, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, se določa s posebnim dogovorom med izvajalcem turistične dejavnosti oziroma samoupravno lokalno skupnostjo in javnimi zdravstvenimi zavodi, ki imajo organizirano službo NMP v skladu s tem pravilnikom.

(3) Organizacijo in način izvajanja dispečerske službe zdravstva ter izvajanje letalske dejavnosti zdravstva ureja poseben predpis.

(4) Organizacijo, način izvajanja, zaščitno opremo, vozila ter simbole in oznake za delovanje pripadnikov Slovenske vojske v službi NMP ureja poseben predpis.

2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

1. I. prioriteta (rdeča) je stopnja nujnosti, ugotovljena s slovenskim indeksom za NMP (v nadaljnjem besedilu: Sloln NMP), ki označuje zdravstveno stanje pacienta, ki ogroža ali bi lahko v kratkem času ogrozilo njegovo življenje;

2. II. prioriteta (rumena) je stopnja nujnosti, ugotovljena s SloIn NMP, ki označuje možnost nevarnega zdravstvenega stanja, ki bi lahko ogrozilo njegovo zdravje ali življenje;

3. Avtomatski zunanji defibrilator (v nadaljnjem besedilu: AED) je prenosna naprava, ki se uporablja pri ukrepanju ob srčnem zastoju in jo lahko uporabljajo tudi laiki;

4. Dežurno mesto (v nadaljnjem besedilu: DM) je oblika zagotavljanja obravnave pacientov v sklopu neprekinjenega zdravstvenega varstva in se organizira v okviru službe NMP na podlagi mreže službe NMP v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: mreža službe NMP);

5. Dispečerska služba zdravstva (v nadaljnjem besedilu: DSZ) je služba, ki deluje neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu, sprejema klice z zdravstvenega področja, spremlja, razporeja in koordinira delovanje vseh mobilnih enot nujne medicinske pomoči ter ekip izvajalcev nenujnih prevozov, vodi evidenco razpoložljivih zmogljivosti bolnišnic, urgentnih centrov in javnih zdravstvenih zavodov, ki so vključeni v mrežo nujne medicinske pomoči;

6. Dispečerski center zdravstva (v nadaljnjem besedilu: DCZ) je operativni center, kjer se izvajajo naloge DSZ;

7. Dostopni čas je čas od javljanja zdravstvenega dispečerja na klic (dvig telefonske slušalke) in vse do prihoda ekipe na kraj dogodka (status »NA KRAJU«);

8. Enotni digitalni standardizirani zapis (v nadaljnjem besedilu: EDSZ) predstavlja enoten ter celovit dokument obravnave pacienta, v katerega podatke vnašajo vsi sodelujoči zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci;

9. Izvajalec službe NMP je javni zdravstveni zavod, ki službo NMP izvaja v organizacijski obliki urgentnega centra, satelitskega urgentnega centra ali zunajbolnišnične dejavnosti v obliki mobilne enote in DM, ki so del mreže službe NMP;

10. Izvajalec nenujnih reševalnih prevozov in izvajalec sanitetnih prevozov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec nenujnih prevozov) je javni zdravstveni zavod ali druga pravna oziroma fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika;

11. Izvozni čas mobilne enote NMP je seštevek aktivacijskega in odzivnega časa mobilne enote NMP. Aktivacijski čas je čas od trenutka, ko zdravstveni dispečer aktivira ekipo nujne medicinske pomoči do statusa SPREJETO. Odzivni čas je čas od statusa SPREJETO do statusa NA POTI;

12. Letalska dejavnost zdravstva je enoten in strokovno voden sistem izvajanja helikopterske NMP ter nujnih reševalnih prevozov z zrakoplovi;

13. Mobilna enota vozila dežurnega zdravnika (v nadaljnjem besedilu: MoE VDZ) je ekipa, ki v okviru zagotavljanja DM obravnava paciente v ambulanti in izvaja neodložljive zdravstvene storitve na terenu ter na podlagi poziva DSZ, do prihoda mobilne enote NMP (v nadaljnjem besedilu: MoE NMP), nudi nujno zdravniško pomoč;

14. Nujna medicinska pomoč (v nadaljnjem besedilu: NMP) pomeni izvajanje nujnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi v kratkem vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt pacienta in jo v skladu s tem pravilnikom izvajajo ustrezno usposobljeni zdravstveni delavci;

15. Nenujni prevoz je prevoz pacienta, ki se izvaja kot nenujni reševalni prevoz ali kot sanitetni prevoz;

16. Nenujni reševalni prevoz je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno obravnavo zdravstvenega delavca. Opravi se z nenujnim reševalnim vozilom;

17. Nenujno reševalno vozilo (v nadaljnjem besedilu: RV) je vozilo, ki je namenjeno nenujnim reševalnim prevozom in izpolnjuje zahteve v skladu s tem pravilnikom;

18. Nujni reševalni prevoz je prevoz pacienta, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožen ali pri katerem bi glede na zdravstveno stanje do takšne ogroženosti lahko v kratkem prišlo oziroma prevoz pacienta zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki zahteva čimprejšnji pregled pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe;

19. Nujno reševalno vozilo (v nadaljnjem besedilu: NRV) je reševalno vozilo, ki je namenjeno izvajanju NMP in nujnih reševalnih prevozov pacientov ter izpolnjuje zahteve v skladu s tem pravilnikom;

20. Pogodbeni prevoz je prevoz pacienta, tkiva ali organa, ki se izvede na podlagi sklenjene pogodbe med naročniki in izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki izpolnjuje zahteve v skladu s tem pravilnikom;

21. Prvi posredovalec (v nadaljnjem besedilu: PPO) je polnoletna oseba, ki je usposobljena in evidentirana v skladu s tem pravilnikom ter se odzove na poziv DSZ in pride na kraj dogodka z namenom izvajanja neposrednih in temeljnih ukrepov za ohranitev življenja pred prihodom službe NMP;

22. Sanitetni prevoz je prevoz pacienta, ki med prevozom ne potrebuje spremstva ali zdravstvene obravnave zdravstvenega delavca. Sanitetni prevoz se izvaja s sanitetnim vozilom;

23. Sanitetno vozilo je osebno vozilo, ki je namenjeno za sanitetni prevoz in izpolnjuje zahteve v skladu s tem pravilnikom;

24. Satelitski urgentni center (v nadaljnjem besedilu: SUC) je organizacijska oblika službe NMP, namenjena razširjeni obravnavi akutno obolelih ali poškodovanih pacientov. Organizirana je za hitro diagnostiko, stabilizacijo in obravnavo pacientov z večino akutnih stanj ali začetno zdravljenje življenjsko ogrožajočih stanj. SUC zagotavlja neprekinjeno delovanje službe NMP v lokalnem okolju, kjer ni neposredne bolnišnične obravnave ter predstavlja povezovalni člen med MoE NMP in urgentnim centrom;

25. Sekundarni prevoz pacienta je nujni ali nenujni prevoz pacienta med izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki se izvede med ali po zdravstveni obravnavi;

26. Služba NMP je organizirana zdravstvena dejavnost, ki se izvaja neprekinjeno 24 ur na dan in obsega izvajanje NMP na terenu in v zdravstvenih zavodih, ki vključno z DSZ in nujnimi reševalnimi prevozi zagotavljajo nujno zdravniško obravnavo ter druge postopke in ukrepe, potrebne za takojšnjo obravnavo življenjsko ogroženih pacientov in pacientov z nujnimi zdravstvenimi stanji;

27. Triaža je postopek, s katerim se oceni nujnost zdravstvenega stanja pacienta in se pacienta razvrsti glede na potrebo po začetku zdravstvene obravnave. Triaža ob prihodu pacienta v urgentni center in SUC se izvaja na osnovi odločitvenega modela Manchesterskega triažnega sistema (v nadaljnjem besedilu: MTS), ki lahko vključuje tudi triažo po telefonu;

28. Urgentni center (v nadaljnjem besedilu: UC) je samostojna organizacijska enota bolnišnice, namenjena obravnavi pacientov z nujnimi in življenjsko ogrožajočimi stanji;

29. Zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah pomeni izvajanje NMP ali ukrepov za zagotovitev varstva in zdravja ljudi na prireditvah in jo izvajajo izvajalci zdravstvenega varstva;

30. Zdravstveni delavec v dejavnosti zdravstvene nege ima enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja zdravstveno nego in babištvo;

31. Zdravstveni reševalec je oseba, ki ima pridobljeno ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo »zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka« v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.

II. POGLAVJE ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA SLUŽBE NMP

3. člen (mobilne enote službe NMP)

Mobilne enote nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: MoE NMP) so:

– ekipa vozila urgentnega zdravnika (v nadaljnjem besedilu: MoE VUZ), ki izvaja nujno medicinsko pomoč na terenu in obravnava paciente v ambulanti nujne medicinske pomoči na način, da zagotovi ustrezen izvozni čas;

– ekipa nujnega reševalnega vozila (v nadaljnjem besedilu: MoE NRV), ki izvaja nujno medicinsko pomoč na terenu in sodeluje pri obravnavi pacientov v ambulanti nujne medicinske pomoči na način, da zagotovi ustrezen izvozni čas;

– ekipa enote helikopterske nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: HNMP);

– reševalec motorist (v nadaljnjem besedilu: MoE RM), ki izvaja nujno medicinsko pomoč na terenu z reševalnim motorjem.

4. člen (organiziranost službe NMP)

(1) V bolnišnični zdravstveni dejavnosti se izvaja služba NMP v UC. V sklopu UC delujejo najmanj naslednje dejavnosti:

- Triaža in administrativni sprejem;
- Enota za poškodbe;
- Enota za bolezni;
- Enota za hitre preglede (v nadaljnjem besedilu: EHP);
- Enota za opazovanje in nadzor;
- MoE NMP, če niso organizirane v zunajbolnišnični dejavnosti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek delovanje EHP v času dežurstva zagotavljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v obliki DM v okviru zdravstvene regije. V rednem delovnem času so delovišča EHP v okviru UC zagotovljena s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v okviru zdravstvene regije.

(3) Za izvajanje NMP v bolnišnični zdravstveni dejavnosti mora biti stalno zagotovljena laboratorijska in slikovna diagnostika. Obravnava pacienta v UC ne sme presegati osem ur od začetka obravnave. Če pacient potrebuje nadaljnjo bolnišnično obravnavo, skrb zanj prevzame ekipa bolnišničnega oddelka.

(4) Na zunajbolnišnični ravni zdravstvene dejavnosti se izvaja služba NMP v sklopu SUC, na lokacijah MoE NMP in DM.

(5) SUC je strokovno in informacijsko povezan s sprejemnim UC. V SUC delujejo najmanj naslednje dejavnosti:

- Triaža, opazovanje in nadzor;
- Ambulanta za pregled in zdravstveno obravnavo;
- MoE NRV;
- MoE VUZ.

(6) Za izvajanje NMP je v zunajbolnišnični dejavnosti v sklopu SUC zagotovljena laboratorijska in slikovna diagnostika.

5. člen

(sestava ekip in pogoji za izvajanje službe NMP)

Dejavnost službe NMP opravljajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Ekipa v MoE VUZ:
 - zdravnik specialist urgentne medicine ali
 - zdravnik z ustreznimi znanji in usposobljenostjo iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, če ni mogoče zagotoviti zdravnika specialista urgentne medicine in
 - diplomirani zdravstvenik z dodatnimi znanji iz Priloge 1 tega pravilnika.
2. Ekipa v MoE NRV:
 - diplomirani zdravstvenik z dodatnimi znanji iz Priloge 1 tega pravilnika;
 - zdravstveni reševalec z opravljenim preverjanjem znanja za delo v NMP, določenim v Prilogi 1 tega pravilnika.
3. Ekipa v enoti HNMP:
 - zdravnik specialist urgentne medicine ali
 - zdravnik specialist z ustreznimi znanji in usposobljenostjo, določenimi v Prilogi 1 tega pravilnika, če ni mogoče zagotoviti zdravnika specialista urgentne medicine in
 - diplomirani zdravstvenik z dodatnimi znanji, določenimi v Prilogi 1 tega pravilnika.
4. Reševalec motorist v MoE RM:
 - diplomirani zdravstvenik z dodatnimi znanji, določenimi v Prilogi 1 tega pravilnika.
5. Ekipa v DM:
 - zdravnik z najmanj osnovno licenco;

– diplomirani zdravstvenik.

6. Ekipo v SUC:

– MoE VUZ;

– Ekipo v DM;

– diplomirani zdravstvenik z dodatnimi znanji s področja MTS;

– drugi zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci glede na obseg dejavnosti pri izvajalcu službe NMP.

7. Ekipo v UC:

– zdravnik specialist urgentne medicine ali zdravnik drugih specialnosti glede na organizacijo in obseg dejavnosti v bolnišnici;

– diplomirani zdravstvenik z dodatnimi znanji iz Priloge 1 tega pravilnika;

– diplomirani zdravstvenik z dodatnimi znanji s področja MTS;

– tehnik zdravstvene nege z dodatnimi znanji iz Priloge 1 tega pravilnika;

– drugi zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci glede na obseg dejavnosti v bolnišnici;

– MoE VUZ, če ni organizirana na primarnem nivoju;

– Ekipo v DM.

6. člen (strokovno vodenje UC in SUC)

(1) Strokovno vodenje UC izvaja zdravnik specialist urgentne medicine, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju NMP.

(2) Strokovno vodenje SUC izvaja zdravnik specialist urgentne medicine ali zdravnik specialist, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju NMP.

(3) Podrobnejši pogoji in način imenovanja organov vodenja SUC in UC se določijo v notranjih aktih javnega zdravstvenega zavoda.

7. člen (dostopnost službe NMP)

(1) Povprečni dostopni čas je povprečje dostopnih časov prve prispele MoE NMP na kraj dogodka in se izračuna za obdobje enega leta. Ta čas za intervencije I. prioritete ne sme presegati 15 minut.

(2) Izvozni čas MoE NMP za intervencije I. prioritete ne sme presegati ene minute od aktivacije s strani DSZ.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko izvozni čas MoE VUZ zaradi obravnave pacienta v ambulanti daljši od ene minute, vendar ne sme presegati pet minut od aktivacije s strani DSZ. V primeru, da ekipa MoE VUZ v času od aktivacije s strani DSZ obravnava ambulantnega pacienta, mora to obravnavo in obrazložitev zakasnjene izvoza obvezno zabeležiti v zdravstveno dokumentacijo pacienta oziroma dokumentacijo primera, zaradi katerega je bila aktivirana s strani DSZ.

(4) Izvozni čas MoE NRV za intervencije II. prioritete ne sme presegati pet minut od aktivacije s strani DSZ.

8. člen (obveznost vključevanja v izvajanje službe NMP)

(1) V službo NMP se v okviru zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva vključujejo zdravstveni delavci na območju izvajalca službe NMP.

(2) V program MoE VUZ se vključuje zdravnik specialist urgentne medicine ali zdravnik z ustreznimi znanji in usposobljenostjo, ki so določeni v Prilogi 1 tega pravilnika.

(3) V bolnišnično službo NMP v okviru UC se vključujeta zdravnik specialist urgentne medicine ali zdravnik drugih specialnosti glede na organizacijo in obseg dejavnosti v bolnišnici ter zdravnik specializant z ustreznimi znanji in usposobljenostjo, ki so določeni v Prilogi 1 tega pravilnika.

(4) V izvajanje dejavnosti EHP v okviru UC se vključujejo zdravniki, ki na območju delovanja UC opravljajo javno zdravstveno službo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, razen osebnih ginekologov. Ne glede na prejšnji stavek se v izvajanje dejavnosti EHP v okviru UC vključujejo tudi zdravniki z osnovno licenco in zdravniki specializanti.

(5) V zagotavljanje DM se vključujejo zdravniki, ki na območju delovanja DM opravljajo javno zdravstveno službo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti razen osebnih ginekologov. Zdravniki v DM se v primerih potrebe po nudenju NMP na poziv DSZ vključujejo v delo na terenu.

(6) V službo NMP se lahko vključujejo zdravstveni delavci v dejavnosti zdravstvene nege, ki za delo v službi NMP izpolnjujejo pogoje iz Priloge 1 tega pravilnika.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek se v EHP v okviru UC in v okviru ekipe DM v zunajbolnišnični NMP vključujejo zdravstveni delavci v dejavnosti zdravstvene nege, ki na območju izvajalca neprekinjenega zdravstvenega varstva opravljajo dejavnost v okviru javne zdravstvene službe.

(8) Obseg vključevanja zdravstvenih delavcev v službo NMP in DM se določi s pogodbo med delodajalcem in izvajalcem neprekinjenega zdravstvenega varstva.

9. člen

(dejavnost Centra za zastripitve)

Center za zastripitve je organiziran v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in ob osnovni dejavnosti zdravljenja v primerih zastripitev opravlja še 24-urno posvetovalno-informacijsko službo.

III. POGLAVJE

NALOGE IN DELOVANJE SLUŽBE NMP

10. člen

(odgovornost izvajalcev službe NMP)

(1) Za organizacijo službe NMP v okviru UC, razen delovanja EHP v času dežurstva iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, je odgovorna bolnišnica, za delovanje zunajbolnišnične NMP pa je odgovoren izvajalec, ki izvaja službo NMP na svojem območju.

(2) Naloga MoE NMP je, da v najkrajšem možnem času začne nuditi NMP pacientu, ga oskrbi in ga, če je to potrebno, prepelje na lokacijo nadaljnje zdravstvene obravnave.

(3) Po obravnavi na lokaciji DM ali SUC se paciente, ki potrebujejo nadaljnjo zdravstveno obravnavo, napoti v ustrezni UC ali sprejemno bolnišnico po predhodnem dogovoru med lečečim zdravnikom in zdravnikom v UC.

(4) DSZ razporeja MoE NMP glede na najkrajši dostopni čas, ne glede na območje pristojnosti izvajalca službe NMP.

(5) Odločitve o posredovanju in vrsti ustrezne MoE NMP za izvedbo posredovanja NMP na terenu na podlagi prejetih informacij in merilih Sloln NMP sprejme DSZ.

(6) Za vključevanje posameznih MoE NMP in njihovo usklajeno delovanje z drugimi interventnimi službami skrbi DSZ.

(7) Za namen spremljanja poteka intervencije in njihove razpoložljivosti, MoE NMP posredujejo DSZ statute v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

IV. POGLAVJE OPREMA ZA IZVAJANJE SLUŽBE NMP

11. člen **(zaščitna oprema službe NMP)**

Izvajalec službe NMP uporablja zaščitno opremo, določeno v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

12. člen **(zdravila, oprema in medicinski pripomočki službe NMP)**

(1) Seznam zdravil, opreme in medicinskih pripomočkov za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP in prevoze pacientov je določen v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, ter predstavlja minimalni nabor in količino zdravil, opreme ter medicinskih pripomočkov za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP.

(2) Oprema, ki se uporablja v primeru množičnih nesreč, je opredeljena v Prilogi 4 tega pravilnika. Izvajalci službe NMP, ki upravljajo s prikolicami za množične nesreče, so odgovorni za redno vzdrževanje opreme, medicinskih pripomočkov in materiala v prikolicah za množične nesreče.

13. člen **(oznake službe NMP)**

(1) Izvajalci službe NMP uporabljajo enotne oznake, ki so določene v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Oznake, ki se uporabljajo v službi NMP, se brez soglasja ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ne sme uporabljati v druge namene.

(2) Oznake, ki se uporabljajo v službi NMP in pri reševalnih prevozi, so:

- Znak NMP Slovenija;
- Znak klicne številke 112;
- Znak Prevoz pacientov Slovenija.

14. člen **(vozila službe NMP)**

(1) Za izvajanje službe NMP se uporabljajo vozila, ki izpolnjujejo zahteve v skladu s Prilogo 6, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Izvajalec službe NMP zagotovi zadostno število vozil za zagotavljanje dogovorjenega števila ekip MoE NMP v različnih časovnih obdobjih. Poleg teh vozil izvajalec zagotavlja tudi nadomestno vozilo za nemoteno izvajanje dejavnosti.

V. POGLAVJE DOKUMENTACIJA

15. člen **(zdravstvena dokumentacija in izmenjava podatkov službe NMP)**

(1) Nabor podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja digitalizacijo zdravstva, za EDSZ ministrstvo objavi na svoji spletni strani in se izpolnjuje v elektronski obliki, razen v primeru nedelovanja informacijskega sistema za Nujno medicinsko pomoč, ki deluje v okviru javne centralne informacijsko-komunikacijske infrastrukture na področju zdravstva za obdelavo podatkov zbirke Centralni elektronski zdravstveni zapis in zbirke podatkov DSZ (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem). Vnos podatkov v EDSZ je obvezen za vse sodelujoče zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce. Vse ekipe, ki sodelujejo pri obravnavi istega pacienta, podatke vnašajo v isti zapis, ki predstavlja enoten in celovit dokument obravnave.

(2) Informacijski sistem mora zagotavljati celovitost, sledljivost, varnost ter časovno označevanje vseh vnosov. Vsaka naknadna sprememba podatkov mora biti evidentirana z razlogom, časom in identiteto izvajalca NMP.

(3) Najpozneje ob predaji pacienta v sprejemno ustanovo mora MoE NMP digitalne podatke o obravnavi pacienta dati na razpolago informacijskemu sistemu sprejemne ustanove.

(4) Izvajalci službe NMP vsakih šest mesecev o obremenitvah službe NMP poročajo ministrstvu, v skladu s Prilogo 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Podatki se ministrstvu posredujejo v agregirani in anonimizirani obliki.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek poročanje ministrstvu ni potrebno v delu ali v celoti, za katerega ministrstvo vzpostavi digitalno, avtomatizirano zbiranje in pridobivanje teh podatkov iz informacijskih sistemov izvajalcev ali centralnih informacijskih rešitev, če je zagotovljena njihova vsebinska ustreznost, popolnost in dostopnost ministrstvu.

VI. POGLAVJE PROGRAM USPOSABLJANJA ZA NMP

16. člen **(usposabljanje zdravstvenih delavcev za delo v službi NMP)**

(1) Zdravstveni delavec v službi NMP opravi usposabljanja in izpopolnjevanja v skladu s Prilogo 1 tega pravilnika. Financiranje usposabljanja in izpopolnjevanja je vključeno v financiranje programa NMP.

(2) Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične NMP (v nadaljnjem besedilu: preverjanje NMP) izvaja izvajalec, ki ga je pooblastilo ministrstvo. Komisija za preverjanje NMP je sestavljena iz treh članov in ustreza zahtevam iz Priloge 1 tega pravilnika.

(3) Zdravstveni delavec opravi preverjanje NMP enkrat na vsakih sedem let. Vsebinsko preverjanja NMP in izjeme določa Priloga 1 tega pravilnika.

(4) Stroške preverjanja NMP krije:
– za primer prvega opravljanja ob prvi oziroma obnovitveni prijavi na sedem let iz prejšnje točke: ministrstvo;
– v vseh drugih primerih: zdravstveni delavec.

(5) Zdravstveni delavec, ki uspešno opravi zgolj pisni del oziroma zgolj praktični del preverjanja NMP ima možnost ponovnega opravljanja preverjanja NMP na neopravljenem delu v roku treh mesecev od dneva preverjanja NMP. V primeru, da zdravstveni delavec ne pristopi k ponovnemu preverjanju NMP v roku treh mesecev, mora ponovno opravljati celotno preverjanje NMP. V čas od prvega opravljanja preverjanja NMP se ne štejeta mesec julij in avgust, ko ni razpisanih terminov za preverjanje NMP. K ponovnemu opravljanju preverjanja NMP sme zdravstveni delavec pristopiti največ petkrat, pri čemer se za en pristop šteje opravljanje posameznega dela ali opravljanje preverjanja NMP v celoti.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru, da zdravstveni delavec ne opravi praktičnega dela preverjanja NMP, sme pristopiti k ponovnemu opravljanju slednjega največ trikrat.

(7) Zahteva po usposabljanju in preverjanju NMP iz prvega odstavka tega člena ne velja za zdravnike specialiste urgentne medicine

(8) Prvega in obnovitvenega preverjanja znanja in usposobljenosti ni potrebno opraviti zdravstvenim delavcem, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika.

17. člen **(usposobljenost za varno vožnjo)**

Za upravljanje intervencijskih vozil ali RM v okviru službe NMP zdravstveni delavec usposobljenost izkazuje z uspešno opravljenim tečajem varne vožnje v skladu s Prilogo 1 tega pravilnika.

VII. POGlavJE **PSIHOSOCIALNA POMOČ**

18. člen **(psihosocialna pomoč v službi NMP)**

(1) Izvajalec službe NMP zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem, ki opravljajo delo v službi NMP, omogoči psihosocialno pomoč.

(2) Če izvajalec službe NMP nima organizirane psihosocialne pomoči znotraj službe, javnega zavoda ali v okviru drugih organizacij, psihosocialno pomoč nudijo centri za duševno zdravje odraslih.

VIII. POGlavJE **PRVI POSREDOVALCI**

19. člen **(prvi posredovalci)**

(1) Izvajalci službe NMP na svojem območju:

- ugotavljajo potrebe po PPO;
- evidentirajo, usposablajo kandidate za PPO in preverjajo znanje kandidatov za PPO;
- vodijo evidenco usposobljenih PPO;
- posredujejo ministrstvu poročilo iz Priloge 7.

(2) PPO pridobi znanje z opravljenim usposabljanjem in preverjanjem znanja iz vsebin ukrepov za ohranitev življenja v skladu s Prilogo 8, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Po opravljenem usposabljanju iz prejšnjega odstavka PPO vsaj enkrat letno obnovi svoje znanje iz vsebin, določenih v Prilogi 8 tega pravilnika.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izvajalci službe NMP na svojem območju sklenejo dogovor z organiziranimi skupinami PPO. O sklenitvi dogovora izvajalec službe NMP obvesti DSZ, ki določi nabor kriterijev iz SloIn NMP in način aktivacije organizirane skupine PPO.

(5) DSZ aktivira PPO v okviru informacijskega sistema DSZ.

(6) Sredstva za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena izvajalcem službe NMP zagotavlja proračun Republike Slovenije.

20. člen

(AED)

(1) AED, katerih lastniki dovolijo javno uporabo, se vključijo v evidenco, ki jo vodi in upravlja DSZ.

(2) Za vzdrževanje AED je odgovoren njegov lastnik. Vsak AED vključen v evidenco mora biti redno vzdrževan v skladu z navodili proizvajalca.

(3) AED, za katerega se ugotovi, da ni vzdrževan v skladu s prejšnjim odstavkom, ga DSZ izključi iz evidence iz prvega odstavka tega člena.

IX. POGLAVJE

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA PRIREDITVAH

21. člen

(način zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah)

(1) Zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah se ureja s pisnim dogovorom med organizatorjem prireditve in izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom in v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Zdravstveno varstvo na prireditvah financira organizator prireditve.

(2) Organizator prireditve vloži za izvedbo prireditve, ki jo odda upravni enoti ali policijski postaji, priloži izpolnjen obrazec prijave javne prireditve oziroma shoda za izračun potrebnega zdravstvenega varstva (v nadaljnjem besedilu: obrazec prijave) iz Priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika. Za prireditve iz 3. do vključno 11. točke prvega odstavka 23. člena tega pravilnika obrazec prijave predhodno potrdi izvajalec službe NMP, ki deluje na območju, kjer se bo prireditev izvedla.

(3) Upravna enota ali policijska postaja podatke o izvajalcu zdravstvenega varstva na prireditvi, ko gre za vrsto prireditve iz 3. do vključno 11. točke prvega odstavka 23. člena tega pravilnika, vnese v aplikacijo, namenjeno javni objavi podatkov o prireditvah in shodih. Podatki o izvajalcu zdravstvenega varstva, ki so vneseni v aplikacijo iz prejšnjega stavka, so dostopni le DSZ.

(4) V primeru dogodkov na prireditvi, ki narekujejo večji obseg izvajanja zdravstvenega varstva, kot ga opredeljuje dogovor med organizatorjem prireditve in izvajalcem zdravstvenega varstva na prireditvi, stroške krije organizator prireditve. Enako velja, če so zaradi prireditve dodatno obremenjeni izvajalec službe NMP na območju prireditve, UC in DSZ.

22. člen
(načrt za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah)

(1) Načrt za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvi iz Priloge 9 pripravi organizator prireditve v sodelovanju z izvajalcem zdravstvenega varstva na prireditvi za vse srednje, zahtevne in zelo zahtevne ter tvegane prireditve.

(2) Ustreznost načrta za srednje in zahtevne prireditve potrdi odgovorna oseba službe NMP na območju prireditve, za zelo zahtevne in tvegane pa tudi odgovorna oseba DSZ in UC.

23. člen
(vrste prireditev)

(1) Prireditve glede na število udeležencev, zdravstveno tveganje in tveganje za dogodke delimo na:

1. nezahtevna prireditev A;
2. nezahtevna prireditev B;
3. manj zahtevna prireditev A in A+;
4. manj zahtevna prireditev B in B+;
5. srednje zahtevna prireditev A in A+;
6. srednje zahtevna prireditev B;
7. zahtevna prireditev;
8. zelo zahtevna prireditev A;
9. zelo zahtevna prireditev B;
10. tvegana prireditev A;
11. tvegana prireditev B.

(2) Pri določanju vrste prireditve se upoštevajo merila iz Priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika.

24. člen
(izvajalci zdravstvenega varstva na prireditvah)

(1) Na prireditvah se zagotavlja zdravstveno varstvo v skladu s Prilogo 10 tega pravilnika.

(2) Izvajalci, ki izvajajo zdravstveno varstvo na prireditvi, morajo biti usposobljeni in opremljeni v skladu z zahtevami tega pravilnika.

(3) V primeru, ko je pacienta potrebno peljati v nadaljnjo zdravstveno obravnavo, prevoz izvede:

1. pristojni izvajalec službe NMP, kadar gre za prevoz s prireditve:
 - iz 1. do vključno 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena za paciente, ki so življenjsko ogroženi;
 - iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena za paciente, ki niso življenjsko ogroženi.
2. izvajalec, ki izvaja zdravstveno varstvo na prireditvi, kadar gre za prevoz s prireditve:
 - iz 8. do vključno 11. točke prvega odstavka prejšnjega člena za paciente, ki so življenjsko ogroženi in se jih ne pelje s helikopterjem;
 - iz 3. do vključno 11. točke prvega odstavka prejšnjega člena za paciente, ki niso življenjsko ogroženi.

(4) Zdravstveno varstvo na prireditvah iz 3. do vključno 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena lahko izvajajo samo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na področju reševalnih prevozov ali NMP v zunajbolnišnični dejavnosti.

(5) Nosilec zdravstvenega varstva na zelo zahtevnih in tveganih prireditvah je lahko samo javni zdravstveni zavod, ki ima dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na področju reševalnih prevozov ali NMP v zunajbolnišnični oziroma bolnišnični dejavnosti.

(6) Zdravstveni delavci se ob začetku in zaključku izvajanja zdravstvenega varstva na prireditvi javijo DSZ.

X. POGlavJE IZVAJANJE PREVOZOV PACIENTOV

25. člen **(oblike prevozov pacientov)**

Prevozi pacientov se organizirajo v obliki:

- nujnih reševalnih prevozov, ki so organizirani v okviru mreže službe NMP;
- nenujnih reševalnih prevozov, kot so opredeljeni v 16. točki 2. člena tega pravilnika;
- pogodbenih prevozov, kot so opredeljeni v 20. točki 2. člena tega pravilnika;
- sanitetnih prevozov, kot so opredeljeni v 22. točki 2. člena tega pravilnika;
- sekundarnih prevozov, kot so opredeljeni v 25. točki 2. člena tega pravilnika.

26. člen **(izvajanje nenujnih prevozov)**

(1) Izvajalci nenujnih prevozov so pravne oziroma fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov ali izvajanje sanitetnih prevozov v skladu s tem pravilnikom in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

(2) Izvajalci iz prejšnjega odstavka, ki opravljajo dejavnost nenujnih prevozov v okviru javne zdravstvene službe, v sorazmernem deležu zagotavljajo dejavnost nenujnih prevozov neprekinjeno.

27. člen **(izvajanje nenujnih reševalnih prevozov)**

(1) Pravna oziroma fizična oseba mora za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov pridobiti dovoljenje ministrstva. Za izdajo dovoljenja mora, poleg pogojev iz zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, imeti:

- v rednem delovnem razmerju zaposlene zdravstvene delavce, ki izpolnjujejo pogoje iz 31. člena tega pravilnika za delovanje najmanj dveh ekip;
- najmanj dve reševalni vozili, ki izpolnjujeta pogoje glede tehnične opremljenosti v skladu s Prilogo 4 in Prilogo 6 tega pravilnika. Poleg vozil iz prejšnjega stavka izvajalec nenujnih reševalnih prevozov zagotavlja tudi nadomestno vozilo za nemoteno izvajanje dejavnosti.

(2) Izvajalec nenujnih reševalnih prevozov mora pred začetkom opravljanja dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov ministrstvu predložiti seznam zaposlenih oseb in vozil, ki se vpiše v evidenco izvajalcev prevozov in vozil iz 36. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: evidenca izvajalcev prevozov in vozil).

28. člen **(izvajanje sanitetnih prevozov)**

(1) Pravna oziroma fizična oseba mora za izvajanje sanitetnih prevozov pridobiti dovoljenje ministrstva. Za izdajo dovoljenja mora, poleg pogojev iz zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, imeti:

- v rednem delovnem razmerju zaposlenega najmanj enega voznika, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge 1 tega pravilnika;
- najmanj eno sanitetno vozilo, ki izpolnjuje pogoje glede tehnične opremljenosti v skladu s Prilogo 4 in Prilogo 6 tega pravilnika. Poleg vozila iz prejšnjega stavka izvajalec sanitetnih prevozov zagotavlja tudi nadomestno vozilo za nemoteno izvajanje dejavnosti.

(2) Izvajalec sanitetnih prevozov mora pred začetkom opravljanja dejavnosti sanitetnih prevozov ministrstvu predložiti seznam zaposlenih oseb in vozil.

29. člen **(sekundarni prevozi)**

(1) Izvajalec sekundarnih prevozov mora izpolnjevati pogoje glede tehnične opremljenosti, določene v Prilogi 4 in Prilogi 6 tega pravilnika.

(2) Sekundarni prevoz se lahko izvede z ekipo MoE NRV, ekipo izvajalca nenujnih prevozov ali ekipo za prevoz s helikopterjem.

(3) Način prevoza, sestavo dodatne ekipe in opreme po dogovoru s pristojnim DCZ določi lečeči zdravnik. Ustrezno usposobljeno dodatno ekipo in opremo zagotovi naročnik prevoza.

30. člen **(pogodbeni prevozi)**

(1) Izvajalec pogodbenih prevozov mora izpolnjevati pogoje glede tehnične opremljenosti, določene v Prilogi 4 in Prilogi 6 tega pravilnika.

(2) Izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko sklene pogodbo z izvajalcem nenujnih prevozov za prevoze, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja in jih financira naročnik.

31. člen **(sestava ekip za izvajanje nenujnih prevozov)**

(1) Nenujne reševalne prevoze opravlja ekipa v sestavi zdravstvenega reševalca in tehnika zdravstvene nege z dodatnimi znanji iz Priloge 1 tega pravilnika.

(2) Sanitetne prevoze opravlja voznik z dodatnimi znanji iz Priloge 1 tega pravilnika.

(3) Tečaj iz vsebin NMP iz Priloge 1 tega pravilnika izvaja izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ga za navedeno nalogo pooblasti ministrstvo.

32. člen **(vključevanje izvajalcev nenujnih prevozov v službo NMP)**

(1) Izvajalec nenujnih prevozov v mreži javne zdravstvene službe se mora v primeru potreb službe NMP, ki so posledica nenadnega, enkratnega in kratkotrajnega povečanja potreb po službi NMP, odzvati na poziv DSZ in se vključiti v delovanje službe NMP.

(2) Podrobnejši način vključevanja in način financiranja vključevanja izvajalcev nujnih prevozov v službo NMP se določi v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

33. člen **(zaplet med nujnim prevozom)**

V primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja pacienta med nujnim prevozom mora ekipa izvajalca nujnih reševalnih prevozov ali voznik sanitetnih prevozov nuditi nujne zdravstvene ukrepe v skladu s svojimi kompetencami in DSZ sporočiti stanje pacienta ter ravnati v skladu z navodili zdravstvenega dispečerja.

34. člen **(oznake, vozila in opremljenost vozil)**

(1) Izvajalec nujnih prevozov pacientov, ki deluje v okviru službe NMP, uporablja na vozilih, opremi in oblačilih oznake NMP, določene v Prilogi 5 tega pravilnika.

(2) Izvajalec nujnih prevozov, ki ne deluje v okviru službe NMP, oznak NMP ne sme uporabljati, ampak namesto tega na vozilih, opremi in oblačilih uporablja oznako »PREVOZ PACIENTOV«.

(3) Vozilo za izvajanje nujnih reševalnih prevozov mora imeti tehnične lastnosti v skladu z evropskim standardom SIST EN 1789, tip A, medicinsko opremo v skladu s Prilogo 4 tega pravilnika in komunikacijsko opremo v skladu s pravilnikom, ki ureja dispečersko službo zdravstva.

(4) Vozilo za sanitetne prevoze mora biti ustrezno za prevoz potnikov in imeti medicinsko opremo v skladu s Prilogo 4 tega pravilnika.

35. člen **(zvočni in svetlobni signali)**

(1) Na vozilu izvajalcev nujnih reševalnih prevozov je namestitev zvočnih in svetlobnih signalov dovoljena na podlagi in v okviru mnenja nadzorne komisije o določitvi pogojev za prostore in opremo ter postopka njegove verifikacije za opravljanje zdravstvene dejavnosti v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje dejavnosti nujnih prevozov.

(2) Vozilo izvajalcev sanitetnih prevozov, ki ne deluje v okviru službe NMP, ne sme imeti nameščenih zvočnih in svetlobnih signalov.

36. člen **(evidenca izvajalcev prevozov in vozil)**

V evidenco izvajalcev prevozov in vozil, ki jo vodi ministrstvo, se vpiše vse izvajalce, ki imajo dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na področju reševalnih prevozov ali NMP v zunajbolnišnični dejavnosti.

37. člen **(podatki v evidenci izvajalcev prevozov in vozil)**

V evidenci izvajalcev prevozov in vozil se vodijo naslednji podatki:

- predmet vpisa;
- kontaktni podatki izvajalca prevozov pacientov;
- številka potrdila o skladnosti vozila;
- podatki iz prometnega dovoljenja;
- številka in datum vpisa oziroma izbrisa iz evidence.

38. člen
(sprememba vpisa v evidenci izvajalcev in vozil)

V evidenco izvajalcev prevozov in vozil se vpisujejo spremembe podatkov na zahtevo izvajalca prevozov ali zaradi začasnega oziroma trajnega odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti prevozov pacientov. Izvajalec prevozov mora sporočiti spremembe podatkov v 15 dneh od njihovega nastanka.

39. člen
(izpis iz evidence izvajalcev prevozov in vozil)

Če izvajalec prevozov preneha obstajati zaradi prenehanja opravljanja dejavnosti prevozov pacientov ali pa mu je bilo na podlagi pravnomočne odločbe odvzeto dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, ministrstvo izvajalca prevozov in njegova vozila izbriše iz evidence izvajalcev in vozil.

XI. POGLAVJE
POSEBNA DOLOČBA

40. člen
(delovanje in izvajanje službe NMP v posebnih pogojih ob naravnih in drugih nesrečah, izrednem stanju ter vojni)

(1) Služba NMP je organizirana, opremljena in usposobljena tako, da tudi v posebnih pogojih ob naravnih in drugih nesrečah, izrednem stanju ter vojni deluje kot sestavni del mreže javne zdravstvene službe v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje zdravstvene dejavnosti v posebnih pogojih.

(2) Izvajalci nenujnih reševalnih prevozov v javni zdravstveni službi se v posebnih pogojih ob naravnih in drugih nesrečah, izrednem stanju ter vojni na podlagi začasnega ukrepa ministra, pristojnega za zdravje in poziva DSZ, vključijo v delovanje službe NMP.

(3) Usposabljanje zdravstvenih delavcev in opremljanje službe NMP za delo v posebnih pogojih ob naravnih in drugih nesrečah, izrednem stanju ter vojni financira ministrstvo, na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme minister, pristojen za zdravje.

XII. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
(uskladitev delovanja MoE NMP)

Izvajalci službe NMP statusna sporočila NMP iz Priloge 2 tega pravilnika, uskladijo v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.

42. člen
(usposobljenost zdravstvenih delavcev)

(1) Zdravstveni delavci v dejavnosti zdravstvene nege in zdravniki, ki delujejo v službi NMP, opravijo preverjanje NMP iz Priloge 1 tega pravilnika v treh letih od uveljavitve tega pravilnika.

(2) Izvajalci prevozov izpolnijo pogoje usposobljenosti iz Priloge 1 tega pravilnika v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

(3) Ne glede na tretjo alinejo 1. točke 5. člena tega pravilnika lahko do 31. decembra 2029 delo voznika v MoE VUZ opravlja tudi zdravstveni reševalec, ki je usposobljen v skladu s Prilogo 1 tega pravilnika, če je v času opravljanja dela vpisan v dodiplomski študijski program zdravstvene nege.

(4) Ne glede na prvi odstavek 31. člena tega pravilnika lahko do 31. decembra 2029 delo voznika v ekipi za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov opravlja oseba, ki je pri izvajalcu nenujnih prevozov zaposlena najmanj zadnjih pet let in izpolnjuje pogoje za izvajanje sanitetnih prevozov.

43. člen
(uskladitev vozil in zaščitne ter delovne opreme)

(1) Za vozila namenjena izvajanju službe NMP in prevozov pacientov, za katera je postopek nakupa v teku oziroma se je postopek nakupa zaključil pred uveljavitvijo tega pravilnika, ni treba izpolnjevati zahtev iz Priloge 6 tega pravilnika.

(2) Izvajalci službe NMP morajo zagotoviti zaščitno in delovno opremo za zaposlene v skladu z zahtevami iz Priloge 3 tega pravilnika v štirih letih od uveljavitve tega pravilnika.

44. člen
(aktivacija PPO)

Do vzpostavitve pogojev, ki bodo DSZ omogočali aktivacijo PPO, iz petega odstavka 19. člena tega pravilnika, aktivacijo PPO na zahtevo DSZ izvaja krajevno pristojni regijski center za obveščanje, ki deluje v okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

45. člen
(nabor podatkov za EDSZ)

Nabor podatkov za EDSZ iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika ministrstvo objavi na svoji spletni strani v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.

46. člen
(vzpostavitev evidenc)

Evidence iz 36. člena tega pravilnika ministrstvo vzpostavi v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

47. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Pravilnik o prevozihi pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10, 81/15 in 32/25 – ZZDej-N) in Pravilnik o službi nujne medicinske

pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15 – popr. in 32/25 – ZZDej-N), razen prvega odstavka 6. člena in Priloge 1 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15 – popr. in 32/25 – ZZDej-N), ki se uporabljata do vključno 31. decembra 2026.

48. člen
(začetek uporabe)

15. člen tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na zbirko podatkov dispečerske službe zdravstva in zbirko Centralni elektronski zdravstveni zapis, začne uporabljati ko so izpolnjeni tehnični pogoji za njuno vzpostavitev v skladu s 65. členom Zakona o digitalizaciji zdravstva (Uradni list RS, št. 100/25). Do takrat se uporablja Centralni register podatkov o pacientih iz 14.b člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP, 141/22 – ZNUNBZ, 18/23 – ZDU-10, 84/23 – ZDOsk-1, 112/24 – ZDIUZDZ in 100/25 – ZDigZ).

49. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-55/2025

Ljubljana, dne 15. maja 2026

EVA 2025-2711-0056

Dr. Valentina Prevolnik Rupel
ministrica
za zdravje

Priloga 1: Znanja in usposobljenost za izvajanje službe NMP in prevozov pacientov

Izvajalci pripravijo in vodijo evidenco usposabljanj in izpopolnjevanj zaposlenih.

1. Interno usposabljanje za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

ZAP. ŠT.	MODULI INTERNEGA USPOSABLJANJA	ZDRAVNIK	DIPL. ZN./ DIPL. ZN. SPEC.	ZR / TZN	MIN. ŠT. UR
1.	ORGANIZACIJSKI MODUL				6
a.	organizacija, zakonodaja, pravilniki in dokumentacija v NMP	X	X	X	3
b.	informacijska tehnologija in komunikacija v NMP	X	X	X	2
c.	delovna in zaščitna oprema ter higienski režim v NMP	X	X	X	1
2.	OSNOVNI MODUL				6
a.	medicinska oprema, pripomočki in material za zdravstveno obravnavo pacientov	X	X	X	3
b.	vozila, pregled in vožnja vozil za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP		X	X	2
c.	dvigovanje, prenos in transport pacienta	X	X	X	1
3.	PRISTOP K ŽIVLJENJSKO OGROŽENEMU ODRASLEMU				22
a.	delavnica tujki v dihalnih poteh pri odraslih	X	X	X	1
b.	delavnica pregled in zdravstvena obravnava kritično bolnega odraslega	X	X	X	4
c.	delavnica začetni postopki oživljanja odraslih	X	X	X	5
č.	delavnica defibrilacija, sinhrona kardioverzija in zunanja elektrostimulacija srca	X	X	X	2
d.	delavnica snemanje večkanalnega EKG in monitoring		X	X	2
e.	vzpostavitev vaskularne poti, aplikacija infuzijskih raztopin, zdravil in kisika		X	X	4
f.	delavnica oskrba dihalne poti, aspiracija dihalne poti, umetna ventilacija in neinvazivna ventilacija	X	X	X	4
4.	PRISTOP K ŽIVLJENJSKO OGROŽENEMU OTROKU				8
a.	delavnica temeljni postopki oživljanja otrok in tujki v dihalnih poteh pri otroku	X	X	X	4
b.	porod, zdravstvena obravnava novorojenca in oživljanje novorojenca	X	X	X	4
5.	PRISTOP K POŠKODOVANCU				18
a.	delavnica pregled in zdravstvena obravnava poškodovanca	X	X	X	4
b.	delavnica osnove tehničnega reševanja, iznos poškodovanca in sodelovanje z gasilci		X	X	5
c.	delavnica oskrba krvavitev in ran ter odstranjevanje motoristične čelade		X	X	3
č.	delavnica osnove imobilizacije in uporaba pripomočkov za imobilizacijo odraslih ter otrok		X	X	6
6.	DELOVANJE NMP OB DOGODKIH Z VEČJIM ŠTEVILOM PACIENTOV	X	X	X	4

7.	DELO Z MENTORJEM KOT DODATNI ČLAN EKIPE NMP		X	X	92
8.	PISNO, USTNO IN PRAKTIČNO PREVERJANJE ZNANJA	X	X	X	4
	SKUPNO ŠTEVILO ur	46	160	160	160

Dodatna obrazložitev:

- a. 160-urno interno usposabljanje s preverjanjem znanja organizira izvajalec službe NMP (lahko v sodelovanju z drugimi izvajalci). Novozaposleni opravi usposabljanje pred pričetkom samostojnega dela v zunajbolnišnični službi NMP, preostanek poskusnega dela pa opravlja skupaj z dodeljenim mentorjem. Čas internega usposabljanja za izvajanje zunajbolnišnične NMP se šteje v kvoto ur redne delovne obveznosti;
- b. Do 25 % obsega opredeljenih ur internega usposabljanja se lahko nameni za pripravo na usposabljanje (npr. prebiranje literature, e-izobraževanja ipd.). Interno usposabljanje po pripravi zajema predavanja in delavnice, ob zaključku pa pisno, ustno ter praktično preverjanje znanja;
- c. Izvajalec pripravi knjižico internega usposabljanja za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP, ki vsebuje vsaj minimalni nabor znanj, opredeljen v modulih internega usposabljanja. Knjižico novozaposlenemu podpisuje dodeljeni mentor, prav tako pa tudi preostali zdravstveni delavci, ki se vključujejo v interno usposabljanje;
- č. Prilagojeno in skrajšano obliko internega usposabljanja s preverjanjem znanja opravi tudi zdravnik, ki ni specialist urgentne medicine;
- d. Kriterije za pričetek dela v VUZ določi izvajalec. DIPL. ZN. ali DIPL. ZN. SPEC. (ali prehodno ZR), ki izpolnjuje pogoje za delo v VUZ in je zaposlen pri izvajalcu, ki operira tako z VUZ kot z NRV, mora vsaj 40 % mesečnega obsega dela opraviti v NRV;
- e. Reševalec motorist lahko prične s samostojnim delom na reševalnem motorju po vsaj petih letih dela v zunajbolnišnični službi NMP, če ima opravljene vsaj tri tečaje in dve delavnici iz 4. poglavja te priloge ter opravljen tečaj varne vožnje za motoriste, ki ga obnavlja vsako leto pred pričetkom motoristične sezone;
- f. Tehnik zdravstvene nege oziroma tehničar zdravstvene nege (TZN), zdravstveni reševalec oziroma zdravstvena reševalka (ZR) ali diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra (DIPL. ZN.) ali diplomirani zdravstvenik specialist ali diplomirana medicinska sestra specialistka (DIPL. ZN. SPEC.) pred pričetkom dela kot voznik reševalnega vozila ali VUZ/VDZ opravi tečaj varne vožnje za intervencijska vozila;
- g. Module se prilagodi glede na obseg pričakovanih znanj, spretnosti in kompetenc.

2. Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP in prevoze pacientov

2.1. Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

2.1.1. Zdravnik/zdravnica

Zdravnik specialist oziroma zdravnica specialistka urgentne medicine je ustrezno usposobljen/a za samostojno delo v NMP. Predpisana izobraževanja za specializante in specialiste urgentne medicine so navedena v vsebini trenutno veljavnega kurikulumuma specializacije iz urgentne medicine.

Zdravnik, ki ni specialist urgentne medicine, opravi preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP v roku 12 mesecev od pričetka dela pri izvajalcu zunajbolnišnične službe NMP.

Zdravniku, ki ni specialist urgentne medicine, se prizna prvo preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP, če ima opravljen tečaj dodatnih postopkov oživljanja (ALS ERC ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv), tečaj oskrbe poškodovanca (ITLS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv), tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok (EPALS ERC ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv), tečaj oživljanja novorojenčka (NLS ERC ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv), tečaj ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah (MRMI ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv) in tečaj urgentnega UZ (WINFOCUS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv).

Zdravniku, ki ni specialist urgentne medicine, se prizna obnovitveno preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP, če v obdobju sedmih let opravi tečaj dodatnih postopkov oživljanja (ALS ERC ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv), tečaj oskrbe poškodovanca (ITLS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv) in dva dodatna tečaja po lastni izbiri iz 4. poglavja te priloge.

DELOVIŠČI Enote za bolezni (EzB) in Enote za poškodbe (EzP)

Za vključevanje zdravnikov specialistov internističnih strok na delovišče UC EzB se zahteva opravljen tečaj dodatnih postopkov oživljanja (ALS ERC ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv) in tečaj množičnih nesreč, definirana v skladu s trenutno veljavnim kurikulumom za specializacijo iz urgentne medicine.

Za vključevanje zdravnikov specialistov kirurških strok na delovišče UC EzP se zahteva opravljen tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev in tečaj množičnih nesreč, definirana v skladu s trenutno veljavnim kurikulumom za specializacijo iz urgentne medicine.

DELOVIŠČE Enote za hitre preglede (EHP)

Delovišča EHP primarno zapolnijo zdravniki specialisti družinske medicine. Poleg njih se lahko s samostojnim delom (z obvezno možnostjo konzultacije za zdravnike brez specializacije) vključujejo zdravniki, ki imajo osnovno licenco ter ob tem tudi:

- zdravniki pred nastopom specializacije, ki so opravili vsaj dvomesečno dobo polnega delovnega časa samostojnega obravnavanja pacientov v EHP/DM pod nadzorom mentorja. Ob koncu obravnave pacientov mora biti izvid vsakokrat potrjen s strani nadzornega zdravnika specialista,
- zdravniki s pričeto specializacijo ali zdravniki z veljavno licenco – končano specializacijo vseh ostalih strok (če ta licenca ni DM/UM) morajo imeti uspešno opravljen kolokvij iz nujnih stanj v EHP/DM, potrjen s strani strokovnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda.

2.1.2. Diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik specialist/diplomirana medicinska sestra specialistka

DIPL. ZN. ali DIPL. ZN. SPEC. opravi preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične NMP v roku 12 mesecev od pričetka dela pri izvajalcu zunajbolnišnične službe NMP. DIPL. ZN. ali DIPL. ZN. SPEC. pred izvajanjem funkcije voznika opravi tečaj varne vožnje za intervencijska vozila.

DIPL. ZN. ali DIPL. ZN. SPEC. se prizna prvo preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP, če ima:

- zaključen podiplomski študij iz urgentnih stanj v zdravstvu (mag. zdr. nege / mag. zdr. nege s podr. urg. st.) ali
- opravljene: tečaj dodatnih postopkov oživljanja (ALS ERC ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv), tečaj oskrbe poškodovanca (ITLS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv), tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok (EPALS ERC ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv) in tečaj ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah (MRMI ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv).

DIPL. ZN. ali DIPL. ZN. SPEC. se prizna obnovitveno preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP, če v obdobju sedmih let opravi tečaj dodatnih postopkov oživljanja (ALS ERC ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv), tečaj oskrbe poškodovanca (ITLS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv), en dodatni tečaj po lastni izbiri (izključen tečaj varne vožnje za intervencijska vozila) in eno delavnico po lastni izbiri iz 4. poglavja te priloge.

Oznaka DIPL. ZN. ali DIPL. ZN. SPEC. velja za oba spola in se uporablja za vse izvajalce zdravstvene nege, ki so dosegli najmanj visokošolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege (vključuje tudi izvajalce z višješolsko izobrazbo in strokovnim izpitom).

2.1.3. Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka

Tehnik zdravstvene nege oziroma srednja medicinska sestra (TZN) mora v roku 12 mesecev od zaposlitve pri izvajalcu zunajbolnišnične službe NMP opraviti nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka (ZR), če le-te še nima opravljene. ZR pred izvajanjem funkcije voznika reševalnega vozila opravi tečaj varne vožnje za intervencijska vozila.

Zdravstveni reševalec oziroma zdravstvena reševalka (ZR) po sedmih letih od opravljenega NPK pristopi na preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP.

ZR se prizna prvo oziroma obnovitveno preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične NMP, če v obdobju sedmih let opravi tečaj začetnih postopkov oživljanja (ALS ERC ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv) ali tečaj dodatnih postopkov oživljanja (ALS ERC ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv), tečaj oskrbe poškodovanca (ITLS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv), en dodatni tečaj po lastni izbiri (izključen tečaj varne vožnje za intervencijska vozila) ter dve delavnici po lastni izbiri iz 4. poglavja te priloge.

Oznaka ZR velja za oba spola in se uporablja za vse izvajalce zdravstvene nege z najmanj srednješolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege, opravljenim pripravništvom in strokovnim izpitom ter z opravljenim NPK.

2.2. Ustrezna znanja in usposobljenost za izvajalce prevozov pacientov

2.2.1. Ekipa izvajalca nenujnih prevozov

Tehnik zdravstvene nege oziroma tehničar zdravstvene nege (TZN) v roku 12 mesecev od zaposlitve pri izvajalcu prevozov pacientov, glede na potrebe delodajalca, opraviti nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka (ZR), če le-te še nima opravljene. ZR, ki opravlja

delo voznika, pred izvajanjem funkcije voznika reševalnega vozila opravi tečaj varne vožnje za intervencijska vozila.

TZN, ki glede na potrebe izvajalca ne bo opravljal NPK ZR, mora v roku šestih mesecev od zaposlitve pri izvajalcu prevozov pacientov opraviti usposabljanje iz vsebin NMP za izvajalce prevozov ter pred pričetkom dela kot voznik vozila opraviti še tečaj varne vožnje za intervencijska vozila.

Oznaka TZN velja za oba spola in se uporablja za vse izvajalce zdravstvene nege z doseženo najmanj srednješolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege, opravljenim pripravništvom in strokovnim izpitom s področja zdravstvene dejavnosti.

2.2.2. Voznik izvajalca sanitetnih prevozov

Voznik sanitetnih prevozov pred začetkom izvajanja dela opravi usposabljanje iz vsebin NMP za izvajalce prevozov in pred nastopom dela še tečaj varne vožnje.

ZAP. ŠT.	USPOSABLJANJE IZ VSEBIN NMP ZA IZVAJALCE PREVOZOV	TEORETIČNI DEL	PRAKTIČNI DEL	MIN.ŠT. UR
1.	sistem NMP v RS, klic 112 in komunikacija z DSZ	X		0.5
2.	nudenje pomoči, etična odgovornost in zakonodaja	X		0.5
3.	temeljni postopki oživljanja odraslih in otrok z uporabo AED	X	X	2
4.	prepoznavna in ukrepi ob nujnih stanjih (tujki v dihalnih poteh, nezavest, epileptični napad, dihalna stiska, bolečina v prsih, možganska kap)	X	X	2
5.	pristop k poškodovancu	X	X	1
6.	oskrba ran in krvavitev	X	X	1
7.	osnove imobilizacije s pripomočki	X	X	1
	SKUPNO ŠTEVILO ur			8

Dodatna obrazložitev:

- a. Veljavnost izpita iz vsebin NMP je sedem let. Izpit TZN oziroma voznik sanitetnih prevozov obnavlja na vsakih sedem let.

2.3. Komisija za preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične NMP

Komisijo za preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične NMP sestavljajo trije člani, od katerih ima:

- en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 8 s področja medicine in je specialist urgentne medicine vsaj pet let, kar dokazuje z veljavno licenco zdravnika specialista urgentne medicine (potrdilo Zdravniške zbornice Slovenije) in trenutno opravlja vsaj 40 % delovnega časa v sistemu NMP, kar dokazuje s potrdilom delodajalca, ter ima vsaj eno veljavno licenco polnega inštruktorja mednarodno priznanih tečajev (dokazuje z veljavnim certifikatom):
 - ERC ALS ali ERC EPALS ali ERC NLS
 - ITLS Advanced ali ITLS Pediatric
 - MRMI
 - WINFOCUS

- en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja zdravstvene nege in ima veljavno licenco Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) za delo na področju zdravstvene nege (potrdilo Zbornice – Zveze), ima opravljeno preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične NMP, kar dokazuje s potrdilom o uspešno opravljenem preverjanju (potrdilo RP LJ / MZ), ima vsaj deset let delovnih izkušenj s področja zunajbolnišnične NMP in trenutno opravlja vsaj 40 % delovnega časa v sistemu NMP, kar oboje dokazuje s potrdilom delodajalca, ter ima vsaj eno veljavno licenco polnega inštruktorja mednarodno priznanih tečajev (dokazuje z veljavnim certifikatom):
 - ERC ALS ali ERC EPALS ali ERC NLS
 - ITLS Advanced ali ITLS Pediatric
 - MRMI

- en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja zdravstvene nege in ima veljavno licenco Zbornice – Zveze za delo na področju zdravstvene nege (potrdilo Zbornice – Zveze), ima opravljeno preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične NMP, kar dokazuje s potrdilom o uspešno opravljenem preverjanju (potrdilo RP LJ / MZ), ima vsaj deset let delovnih izkušenj s področja zunajbolnišnične NMP, kar dokazuje s potrdilom delodajalca, ter ima opravljene mednarodno priznane tečaje (dokazuje z veljavnim certifikatom):
 - ERC ALS ali ERC EPALS ali ERC NLS
 - ITLS Advanced ali ITLS Pediatric
 - MRMI

Pri preverjanju znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične NMP je pri preverjanju zdravnikov tričlanska komisija sestavljena iz dveh članov s pogoji iz prve alineje ter enega člana s pogoji iz druge alineje tega poglavja.

3. Interna izpopolnjevanja za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

ZAP. ŠT.	MODULI INTERNEGA IZPOPOLNJEVANJA	MIN. ŠT. UR	OPOMBA
1.	izpopolnjevanje iz zdravstvene obravnave kritično bolnih odraslih in oživljanja odraslih	4	lahko izmenično v letih
2.	izpopolnjevanje iz zdravstvene obravnave kritično bolnih otrok in oživljanje otrok	4	lahko izmenično v letih
3.	izpopolnjevanje iz poroda in oživljanje novorojenčka	4	lahko izmenično v letih
4.	izpopolnjevanje iz pregleda in zdravstvene obravnave poškodovancev	4	lahko izmenično v letih
5.	izpopolnjevanje iz ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah (lahko tudi nevarnih snovi)	4	vsakoletno
6.	izpopolnjevanje iz oskrbe dihalne poti in umetne ventilacije	4	lahko izmenično v letih
7.	izpopolnjevanje iz snemanja EKG in interpretacija EKG zapisa	4	lahko izmenično v letih
8.	izpopolnjevanje iz imobilizacije poškodovancev	4	lahko izmenično v letih
9.	izpopolnjevanje iz intraosalne poti	4	lahko izmenično v letih
10.	izpopolnjevanje iz iznosa poškodovanca in tehničnega reševanja	4	lahko izmenično v letih
11.	izpopolnjevanje iz ukrepanja NMP pri aktivnih življenju nevarnih dogodkih	4	lahko izmenično v letih
12.	izpopolnjevanje iz poznavanja in aplikacije zdravil, infuzijskih raztopin in kisika	4	lahko izmenično v letih
13.	izpopolnjevanje iz najpogostejših nujnih stanj v NMP	4	vsakoletno
14.	izpopolnjevanje iz psihosocialnih vsebin	4	lahko izmenično v letih
	SKUPNO ŠTEVILO ur	72	v 3 letih

Dodatna obrazložitev:

- a. Interno izpopolnjevanje za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP organizira izvajalec zunajbolnišnične službe NMP (lahko v sodelovanju z drugimi izvajalci) izven rednega delovnega časa, vsako leto v obsegu vsaj 24 ur na zdravstvenega delavca. Čas internega izpopolnjevanja se šteje v kvoto ur redne delovne obveznosti;
- b. Do 25 % obsega opredeljenih ur internega izpopolnjevanja se lahko nameni za potrebe priprav na izpopolnjevanje (kot je prebiranje literature, e-izpopolnjevanje ipd.). Moduli poleg teoretičnega dela vsebujejo tudi praktični del, razen vsebin iz 13. in 14. točke tabele tega poglavja, ki sta lahko zgolj teoretični;
- c. Zdravstveni delavci, ki so se v tekočem letu udeležili eksternega usposabljanja na enako ali podobno tematiko, kot je predvidena za interno izpopolnjevanje, so opravičeni udeležbe na internem izpopolnjevanju;
- č. Najpogostejša nujna stanja v NMP, ki jih izvajalci zunajbolnišnične službe NMP vključijo v triletni program internega izpopolnjevanja, se izvedejo v obliki predavanj na priporočene teme:
 - aritmije, šok in periarrestna stanja,
 - izbrana internistična nujna stanja,
 - izbrana travmatološka nujna stanja,
 - izbrana nujna stanja v nevrologiji,
 - izbrana nujna stanja v infektologiji,
 - izbrana nujna stanja v psihiatriji,
 - izbrana nujna stanja v pediatriji,
 - izbrana nujna stanja v ginekologiji in porodništvu,
 - izbrana nujna stanja v toksikologiji,
 - zdravila v zunajbolnišnični službi NMP,

- ostale vsebine po presoji;
- d. Module se prilagodi glede na obseg pričakovanih znanj, spretnosti in kompetenc.

4. Eksterna usposabljanja za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

ZAP. ŠT.	TEČAJI IN DELAVNICE	ZDRAVNIK	DIPL. ZN./ DIPL. ZN. SPEC.	ZR	MIN. ŠT. UR
1.	tečaj začetnih postopkov oživljanja (ERC ILS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)			X	6
2.	tečaj začetnih postopkov oživljanja otrok (ERC EPILS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)			X	6
3.	tečaj dodatnih postopkov oživljanja (ERC ALS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)	X	X	(X)	12
4.	tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok (ERC EPALS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)	X	X	(X)	12
5.	tečaj zdravstvene obravnave poškodovanca (ITLS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)	X	X	X	16
6.	tečaj oživljanja novorojenčka (ERC NLS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)	X	X		6
7.	tečaj ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah (MRMI ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)	X	X	X	16
8.	tečaj urgentnega UZ (WINFOCUS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)	X			4
9.	tečaj za ukrepanje služb NMP v nesrečah z nevarnimi snovmi (MRMI NNS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)	X	X	X	16
10.	tečaj tehničnega reševanja (seminar tehnično reševanje PGD/NMP Postojna ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)		X	X	6
11.	delavnica pristop k življenjsko ogroženemu otroku in odraslemu bolniku (Sekcija reševalcev ali delavnica, ki je po učnem načrtu primerljiva)		X	X	6
12.	delavnica poroda (SIM center ZD Ljubljana ali delavnica, ki je po učnem načrtu primerljiva)	X	X	X	6
13.	delavnica oskrbe dihalne poti in umetne ventilacije (Sekcija reševalcev ali delavnica, ki je po učnem načrtu primerljiva)		X	X	6
14.	delavnica interpretacije EKG zapisa (Sekcija reševalcev ali delavnica, ki je po učnem načrtu primerljiva)		X	X	6
15.	delavnica imobilizacije (Sekcija reševalcev ali delavnica, ki je po učnem načrtu primerljiva)		X	X	6
16.	tečaj varne vožnje za intervencijska vozila (AMZS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)		X	X	4
17.	tečaj varne vožnje za motoriste (AMZS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv) – zgolj za reševalca motorista		X		4

Dodatna obrazložitev:

- Reševalec motorist opravi tečaj varne vožnje za motoriste vsako leto pred začetkom motoristične sezone;
- Reševalec voznik (ZR/DIPL., ZN/DIPL., ZN. SPEC.) ima za vožnjo vozil (RV, VDZ, NRV, VUZ) opravljen tečaj varne vožnje za intervencijska vozila, katerega obnavlja na tri leta;

- c. ZR lahko opravi tečaj začetnih ali dodatnih postopkov oživljanja – izbirno (X);
 č. ZR lahko opravi tečaj začetnih ali dodatnih postopkov oživljanja otrok – izbirno (X).

5. Interna in eksterna usposabljanja za izvajanje službe NMP: SUC in UC

ZAP. ŠT.	MODULI INTERNEGA USPOSABLJANJA	DIPL. ZN./ DIPL. ZN. SPEC.	TZN	MIN. ŠT. UR
1.	organizacija, pravilniki in dokumentacija v NMP	X	X	2
2.	oprema, pripomočki in material za zdravstveno obravnavo pacientov	X	X	2
3.	delavnica tujki v dihalnih poteh pri otroku in odraslih	X	X	1
4.	delavnica pregled in zdravstvena obravnava kritično bolnega pacienta	X	X	2
5.	delavnica začetnih postopkov oživljanja odraslih	X	X	4
6.	delavnica defibrilacija, sinhrona kardioverzija in zunanja elektrostimulacija srca	X	X	1
7.	delavnica snemanje večkanalnega EKG, monitoring in prepoznavanje najpogostejših motenj srčnega ritma	X	X	2
8.	odvzem vzorca venske krvi, odvzem vzorca za plinsko analizo arterijske krvi; vzpostavitev intravenske poti, intraosalne poti, aplikacija infuzijskih raztopin, zdravil in kisika; priprava zdravil za perfuzor ter uporaba perfuzorja	X	X	6
9.	delavnica oskrba dihalne poti, aspiracija dihalne poti, umetna ventilacija in neinvazivna ventilacija	X	X	4
10.	delavnica temeljnih postopkov oživljanja otrok	X (P)	X (P)	4
11.	delavnica pregled in zdravstvena obravnava poškodovanca	X (EzP)	X (EzP)	4
12.	triažiranje in delovanje NMP ob dogodkih z večjim številom pacientov	X	X	4
13.	DELO Z MENTORJEM KOT DODATNI ČLAN TIMA	X	X	40
14.	PISNO, USTNO IN PRAKTIČNO PREVERJANJE ZNANJA	X	X	4
	SKUPNO ŠTEVILO ur			80

Dodatna obrazložitev:

- a. Oznake: enota za poškodbe (EzP), enota za bolezni (EzB), enota za hitre preglede (EHP), pediatrična urgenca, odsek ali delovišče, kjer se poleg odraslih pacientov obravnava tudi pediatrična populacija (P);
- b. 80-urno interno usposabljanje s preverjanjem znanja organizira izvajalec službe NMP (lahko v sodelovanju z drugimi izvajalci). Novozaposleni opravi usposabljanje pred pričetkom samostojnega dela v službi NMP (SUC in UC), preostanek poskusnega dela pa opravlja skupaj z dodeljenim mentorjem. Čas internega izpopolnjevanja se šteje v kvoto ur redne delovne obveznosti;
- c. Do 25 % obsega opredeljenih ur temeljnega internega usposabljanja se lahko nameni za potrebe priprav na usposabljanje (kot je prebiranje literature, e-izobraževanja ipd.);
- č. Izvajalec pripravi knjižico internega usposabljanja za izvajanje službe NMP vsaj z minimalnim naborom znanj, kot jih opredeljujejo moduli internega usposabljanja; knjižico pa novozaposlenemu podpisuje dodeljen mentor kot tudi preostali zdravstveni delavci, ki se vključujejo v interno usposabljanje;

- d. Zdravstveni delavci, ki opravljajo delo zgolj na pediatrični urgenci ali na delovišču, kjer obravnavajo tudi pediatrično populacijo, morajo opraviti tudi vsebino iz 10. točke tabele tega poglavja (P);
- e. Zdravstveni delavci, ki opravljajo delo zgolj na poškodbenem delu urgence ali na delovišču, kjer obravnavajo tudi poškodovance, morajo opraviti tudi vsebino iz 11. točke tabele tega poglavja (EzP);
- f. Zdravstveni delavci, ki delo opravljajo zgolj v EHP, opravijo prilagojeno in skrajšano interno usposabljanje z moduli, ki mu bodo koristili pri delu v EHP;
- g. Module se prilagodi glede na obseg pričakovanih znanj, spretnosti in kompetenc.

ZAP. ŠT.	TEČAJI EKSTERNEGA USPOSABLJANJA	ZDRAVNIK	DIPL. ZN./ DIPL. ZN. SPEC.	TZN / SMS	MIN. ŠT.UR
1.	tečaj začetnih postopkov oživljanja (ERC ILS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)		(X)	X	6
2.	tečaj začetnih postopkov oživljanja otrok (ERC EPILS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)		(X) (P)	X (P)	6
3.	tečaj dodatnih postopkov oživljanja (ERC ALS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)	X (EzB)	(X) (EzB)		12
4.	tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok (APLS/ERC EPALS ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)	X (P)	(X) (P)		12
5.	tečaj zdravstvene obravnave poškodovanca (ATLS/ATCN/ETC ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)	X (EzP)	X (EzP)	X (EzP)	12
6.	tečaj ukrepanja zdravstva b velikih nesrečah (MRMI ali tečaj, ki je po učnem načrtu primerljiv)	X	X	X	16
7.	tečaj triaže po načelih manchestrskega triažnega sistema (MTS)		X (T)		16

Dodatna obrazložitev:

- a. Zdravnikom specialistom urgentne medicine ni potrebno opravljati navedenih tečajev. Tečaje morajo opraviti vsi preostali profili zdravnikov, ki opravljajo delo v SUC ali UC: EzB, EzP itd., in niso specialisti urgentne medicine;
- b. Zdravstveni delavci, ki opravljajo delo zgolj v EzB, morajo opraviti vsaj tečaj ERC ILS/ALS in MRMI – (EzB);
- c. Zdravstveni delavci, ki opravljajo delo zgolj v EzP, morajo opraviti vsaj tečaj ATLS/ATCN/ETC (velja tudi ITLS) in MRMI;
- č. Zdravstveni delavci, ki opravljajo delo zgolj na pediatrični urgenci ali na delovišču, kjer obravnavajo tudi pediatrično populacijo, morajo opraviti tečaj APLS ali ERC EPILS/EPALS in MRMI – (P);
- d. Zdravstvenim delavcem, ki opravljajo delo zgolj v EHP, ni potrebno opravljati navedenih eksternih usposabljanj;
- e. Tečaj triaže po načelih MTS opravi število oseb glede na obseg programa pri posameznem izvajalcu službe NMP – (T);
- f. DIPL. ZN. ali DIPL. ZN. SPEC. lahko opravi tečaj začetnih ali dodatnih postopkov oživljanja – izbirno (X);
- g. DIPL. ZN. ali DIPL. ZN. SPEC. lahko opravi tečaj začetnih ali dodatnih postopkov oživljanja otrok – izbirno (X);
- h. Navedene tečaje zdravstveni delavci opravijo v sedmih letih od pričetka dela pri izvajalcu službe NMP ter jih nato redno obnavljajo na vsakih sedem let.

Priloga 2: Statusna sporočila v NMP

Statusna sporočila, ki jih MoE pošiljajo DSZ omogočajo časovno spremljanje izvedbe intervencije (časovni intervencijski statusi) in operativnost MoE (operativni statusi).

MoE je v skladu s tem pravilnikom za vsako intervencijo dolžna posredovati statuse iz spodnje tabele, razen kadar je v rubriki »posebnosti« zapisano drugače.

Definicija in obrazložitev dogodka in intervencij

Dogodek nastane na podlagi obvestila (klica pacienta, svojca, ekipe,...) o potrebni pomoči NMP na določeni lokaciji. Na dogodku izvedemo eno ali več intervencij.

Intervencija nastane na podlagi dogodka, ko se aktivira enota NMP. Vsaka aktivirana MoE NMP ima svojo intervencijo.

Intervencija ima svoje časovne intervencijske statuse, ki se beležijo na posamezno MoE. V primeru, da MoE po zdravstveni obravnavi transportira pacienta do končnega mesta zdravstvene obravnave so praviloma v naslednjem vrstnem redu: SPREJETO → NA POTI → NA KRAJU → PRI PACIENTU → ODHOD S KRAJA → NA CILJU → ZAKLJUČEK INT.

Ekipe, ki konča intervencijo na kraju (pacient ostane doma,...), statusov ODHOD S KRAJA in NA CILJU ne pošilja.

Časovnemu intervencijskemu statusu ZAKLJUČEK INT obvezno sledi eden izmed operativnih statusov, ki določajo operativnost same MoE.

Časovni intervencijski statusi

Status: SPREJETO

Pomen: MoE potrdi prejem sporočila in začetek izvajanja intervencije.

Razlaga: *Vsak član ekipe posreduje status takoj, ko je aktivacijsko sporočilo sprejel. Zdravstveni dispečer smatra, da je bila aktivacija uspešno izvedena, ko je sprejel potrditev vsaj enega člana MoE. Člani MoE so praviloma skupaj, kadar temu ni tako, so se o aktivaciji dolžni medsebojno obveščati.*

Status: NA POTI

Pomen: MoE potrdi izvoz na intervencijo.

Razlaga: *Status se sporoči, ko je celotna MoE zbrana in je vozilo začelo z vožnjo na intervencijo. Status posreduje en član MoE in velja za celotno ekipo.*

Status: NA KRAJU

Pomen: MoE potrdi prihod na kraj intervencije.

Razlaga: *Status se sporoči, ko je vozilo prispelo na predvideno lokacijo intervencije. Status posreduje en član MoE in velja za celotno ekipo.*

Status: PRI PACIENTU

Pomen: MoE potrdi prihod do pacienta.

Razlaga: *Status se sporoči, ko je prvi član MoE prispel do pacienta. Kadar je pacientov več, lahko vsak član MoE posreduje svoj status.*

Posebnosti: Ni potrebno posredovati, kadar zaradi narave dela ali tehničnih zmožnosti to ni mogoče (nedelovanje radijskega sistema ali aplikacije).

Status: ODHOD S KRAJA

Pomen: MoE potrdi vračanje s kraja intervencije.

Razlaga: *Status se sporoči, ko je vozilo začelo s premikom iz lokacije intervencije do lokacije predaje pacienta. Status posreduje en član MoE in velja za celotno ekipo.*

Posebnosti: Kadar MoE zaključi z delom na lokaciji, statusa ne posreduje in je naslednji status »ZAKLJUČEK INT«.

Status: NA CILJU

Pomen: MoE potrdi prihod na lokacijo predaje pacienta.

Razlaga: *Status se sporoči, ko se je vozilo ustavilo na lokaciji predaje pacienta. Status posreduje en član MoE in velja za celotno ekipo.*

Status: ZAKLJUČEK INT

Pomen: MoE potrdi zaključek trenutne intervencije.

Razlaga: *Status je posredovan takoj, ko je MoE predala pacienta. Ta čas ni daljši od 15 minut. Status posreduje en član MoE in velja za celotno ekipo.*

Posebnosti: Kadar je ta čas podaljšan, je MoE dolžna DCZ obvestiti o vzroku podaljšanega časa. Temu statusu obvezno sledi eden izmed naslednjih operativnih statusov.

Operativni statusi

Status: PROST

Pomen: MoE in vozilo so pripravljene za naslednjo intervencijo.

Razlaga: *Status je posredovan, kadar je MoE na svojem primarnem območju in je sposobna izvesti naslednjo intervencijo.*

Posebnosti: Kadar je status sporočen po statusu »VRAČANJE RAZPOLOŽLJIV«, se le ta sporoči takoj, ko MoE vstopi na svoje primarno območje.

Status: VRAČANJE RAZPOLOŽLJIV

Pomen: MoE sporoča, da se ekipa vrača na svoje primarno območje in je v tem času razpoložljiva za izvedbo intervencije.

Razlaga: *Status je posredovan po statusu »ZAKLJUČEK INT«, kadar se ekipa po zaključku ne nahaja na svojem primarnem območju in je začela z vračanjem. MoE je v času vračanja razpoložljiva za izvedbo intervencije.*

Status: VRAČANJE NERAZPOLOŽLJIV

Pomen: MoE sporoča, da se vrača na svoje primarno območje, vendar v tem času ni razpoložljiva za izvedbo intervencije.

Razlaga: *Status je posredovan po statusu »ZAKLJUČEK INT«, kadar se ekipa po zaključku ne nahaja na svojem primarnem območju in je začela z vračanjem. Vzrok nerazpoložljivosti v času vračanja mora MoE sporočiti DCZ.*

Status: ČIŠČENJE

Pomen: MoE sporoča, da vozilo/oprema/osebje potrebuje čiščenje oz. dopolnitev.

Razlaga: *Status posreduje član MoE v primeru, ko zaradi pomankanja opreme/materiala oz. čiščenja vozila ali opreme ni možno pričeti z izvajanjem naslednje intervencije. Ravno tako se ta status uporablja, kadar je potrebna priprava/ureditev članov MoE. Ob tem statusu MoE poda indikacijo statusa (čiščenje po reanimaciji, čiščenje po oskrbi z aerogeno izolacijo, čiščenje po oskrbi s kontaktno izolacijo)*

Status: NERAZPOLOŽLJIV

Pomen: MoE sporoča, da je nerazpoložljiva za izvedbo intervencije.

Razlaga: *Status se posreduje, kadar MoE iz kakršnihkoli vzrokov (okvara vozila, izpad članov MoE, vreme,...) ni sposobna za izvedbo intervencij. Ob tem statusu MoE DCZ sporoči vzrok in predvideno časovno nerazpoložljivost.*

Posebnosti: Kadar MoE nima drugega intervencijskega ali operativnega statusa, se smatra, da je MoE v statusu »RAZPOLOŽLJIV«.

Status: POGOJNA RAZPOLOŽLJIVOST

Pomen: MoE sporoča, da je pogojno razpoložljiva.

Razlaga: *Status se posreduje, kadar ima ekipa predhodno odobritev DCZ za koriščenje odmora (malica,...).*

Priloga 3: Zaščitna in delovna obleka, obutev ter oprema

1. Namen in področje uporabe

Priloga opredeljuje zaščitno in delovno obleko, obutev ter opremo, ki jo uporabljajo zdravstveni delavci pri opravljanju nalog v zunajbolnišnični službi nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: NMP). Zaščitna obleka in obutev varujeta zdravstvenega delavca pred vremenskimi in drugimi škodljivimi vplivi ter predstavljata celostno podobo zunajbolnišnične službe NMP v Republiki Sloveniji. Priloga ne vključuje osebne zaščitne opreme, kot so zaščitne rokavice, zaščitne maske in druge oblike zaščite, ki so predmet ločenih predpisov.

Priloga določa tehnične in funkcionalne zahteve za posamezne kose zaščitne in delovne opreme, vključno z letno in zimsko obleko, zaščitno in delovno obutvijo, pasovi, kapami, jopicami, brezrokavniki, rokavicami, čeladami, majicami ter dodatki za večjo vidnost in prepoznavnost. Posebej so opredeljeni tudi elementi opreme za izredne razmere (npr. balistična zaščita, oblačila za množične nesreče) in specializirana zaščitna oprema za reševalce motoriste.

Določeni so tudi način označevanja opreme (npr. logotipi, imenske oznake, znak NMP, slovenska zastava), barvni standardi, minimalne količine in priporočena obdobja zamenjave posameznih kosov opreme ter kriteriji, po katerih se oprema šteje za obrabljeno.

Za izvajalce, ki opravljajo izključno prevoze pacientov ali zdravstveno varstvo na prireditvah, uporaba oznake NMP na obleki, obutvi ali opremi ni dovoljena. Ti izvajalci prav tako niso dolžni uporabljati naslednje opreme: taktični brezrokavnik, rokavice za tehnično reševanje ter balistična zaščita. Zaščitna obutev je lahko nižja kot 15 cm.

Vsa zaščitna in delovna oprema je skladna z veljavnimi evropskimi in nacionalnimi standardi ter zakonodajo.

1.1. Splošne zahteve za zaščitno in delovno obleko, obutev ter opremo
Barvni standard zaščitne opreme izvajalca v službi NMP

Tabela 1: Specifikacije barvnega standarda zaščitne opreme izvajalca v službi NMP

1.1.1.	Barva	Visokovidna fluorescentna rdeča (Luminous Red/RAL 3024/Pantone 185 C) Visokovidna žveplenorumena barva (Sulfur Yellow/RAL 1016/Pantone 604) Bela (Pure White/RAL 9010/Pantone 11-4301 TPG) Črna (Black /RAL 504/Pantone 19-3911 TPG)
1.1.2.	Prepoznavnost	Na zunanji strani hrbta oblačil tiskan napis črne barve REŠEVALEC ali ZDRAVNIK, višina črk 7,5–8,5 cm. Na sprednjem zgornjem desnem delu trupa zgornjih oblačil emblem pravokotne oblike dimenzij vsaj 11 cm x 3 cm v dveh vrsticah. Našitek je črne barve in zlatno vezeno obrobljen 1,5–2,0 mm. Napisi zlate barve zgoraj ime in priimek, spodaj izobrazba. Na majicah je oznaka tiskana. Na spodnjem žepu desne hlačnice emblem pravokotne oblike dimenzij vsaj 3 cm x 11 cm. Na emblemu ime in priimek. Zdravstveni delavci in sodelavci, ki so v neposrednem stiku s pacienti, imajo na vidnem mestu navedeno polno ime in priimek ter ustrezen strokovni oziroma znanstveni naziv, skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Na levem rokavu pod ramo je znak NMP, nad njim slovenska zastava (dimenzije 3-4 cm x 6-8 cm), na desnem znak zavoda/enote. Emblemi in znaki so vezeni ločeno in našiti na oblačila. Premer znakov 7-9 cm. Na majici so znaki tiskani.
1.1.3.	Pisava	Črke na emblemu so velike tiskane, pisave Arial, na hrbtu pisave Arial Black.
1.1.4.	Vidnost	Upoštevanje standarda SIST EN ISO 20471. Horizontalni odsevni trakovi so širine minimalno 5 cm, vertikalni 5 cm. Če sta dva odsevna trakova postavljena drug nad drugim (t. i. dvovrstni pas), mora biti razmak med njima najmanj 5 cm.

Znaka NMP in Prevoz pacientov sta definirana v Prilogi 5 tega pravilnika.

Zahteve za material za ojačitev na ramenih, komolcih in kolenih:

- material je visoko odporen na obrabo in trganje (kot npr. Kevlar ali kot npr. Cordura),
- vsebuje vodoodporna membrano ali vodoodbojno apreturo,
- nudi odpornost proti obrabi (SIST EN ISO 12947-2), ocena: ≥ 45.000 ciklov,
- material je črn, kontrasten,
- *opcijsko reflektira svetlobo (dokazovanje s tehničnim listom proizvajalca materiala).*

Reflektivne odsevne oznake in trakovi so:

- šivani, široki minimalno 5 cm,

- v skladu z SIST EN ISO 20471,
- odsevni trakovi srebrne barve kot je 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9910/9925 Series ali enakovredno.

Pri uporabi tega pravilnika je potrebno upoštevati najnovejše veljavne različice standardov, navedenih v besedilu. Vse zadrge so odporne na termično obdelavo v pralnici. Oblačilo je izdelano v skladu z Uredbo (EU) 2016/425, kategorija II in razpolaga z znakom skladnost izdelka z Evropsko zakonodajo (CE). Zaščitna in delovna oblačila so pralna pri vsaj 40 stopinj Celzija z ustreznimi dezinfekcijskimi sredstvi, kot je na primer sredstvo na osnovi peroksiocetne kisline, da se doseže mikrobiološke higienske zahteve standarda RAL GZ992/2.

Izvedba v moškem in ženskem kroju. Standardne velikostne številke so prilagojene posamezniku za udobno nošenje.

1.2. Zaščitna oprema

1.2.1. Zaščitna jakna - zimska (bunda)



Slika 1: Skica bunde

Tabela 2: Specifikacije za bundo

1.2.1.1.	Barva	Visokovidna fluorescentna rdeča in visokovidna žveplenorumena barva (točna specifikacija barve v točki 1.1.1)
1.2.1.2.	Vidnost	<p>Upoštevanje standarda SIST EN ISO 20471 razred 2, skupaj z zaščitnimi delovnimi hlačami dosega razred 3.</p> <p>Odsevni trak naj poteka horizontalno čez prsni del in se nadaljuje čez hrbtni del. Trak naj se v isti višini (ko so roke ob telesu) nadaljuje na oba rokava.</p> <p>Odsevni trak naj poteka horizontalno 5 cm nad spodnjim robom in se nadaljuje čez hrbtni del. Trak naj se v isti višini (ko so roke ob telesu) nadaljuje na oba rokava.</p> <p>Odsevni trak naj vertikalno poteka po obeh rokavih ob strani od ramenskega dela do odsevnega traku spodaj, vendar ne čez embleme in našitke.</p>
1.2.1.3.	Zaščita (standard materiala)	<p>SIST EN 343 - zaščita materialov in šivov pred padavinami (npr. dež, snežinke), meglo in talno vlago in vetrom</p> <p>SIST EN 11612 - zaščita pred vročino in toploto (vsaj razrede A1, B1, C1, E1, F1)</p> <p><i>SIST EN 1149-5 - antistatičnost (opcijsko)</i></p> <p><i>SIST EN ISO 9237 - zagotavljanje zračnosti (opcijsko)</i></p>

		<i>SIST EN 14058 - zaščito pred vplivi hladnega okolja s temperaturami nad -5°C, vlažnosti in vetra (opsijsko)</i>
1.2.1.4.	Tehnična izvedba	<p>Kroj zagotavlja udobno nošenje, neovirano gibljivost in je prilagojen delu na terenu.</p> <p>Bunda je lahko sestavljena iz dveh ločenih plasti, ki se preko zadrga in gumbov povežeta. <i>Termo izolacijska plast je opsijska.</i></p> <p>Oblačilo omogoča hkratno nošenje termo izolacijske plasti, zaščitne jakne, termo jopice in majice.</p> <p>Na sprednjem delu se zapenja s spiralno zadrgo (z dvema drsnikom), ki sega do vrha ovratnika. Na zadrgo je z notranje strani našita zadrga, ki opsijsko omogoča vpenjanje termo izolacijskega vložka.</p> <p>Ovratnik, visok stoječ (znotraj v črni barvi) z integrirano nepremočljivo ter po višini in širini nastavljivo kapuco (RAL 1016), ki se lahko zloži v ovratnik in zapre s pokrovom s pritisknimi gumbi. Po obodu in dolžini kapuce je vpeljana elastična vrvica, ki ima na obe strani plastičen regulator.</p> <p>Rokavi so neodstranljivi, na dolžini rokava sta »potegavček« in trak na ježka za uravnavanje širine rokava v zapestju. V tem predelu in na komolcih je blago v črni barvi, material pa zagotavlja povečano odpornost na obrabo (zapisano v točki 1.1.).</p> <p>Spredaj na prsih, desno in levo je »napoleon« žep, ki se zapira z zadrgo, dolžine ≈ 18 cm.</p> <p>Na levi strani prsi je žep za nošenje radijske postaje (za ročno radijsko postajo kot je Motorola R7 ali enakovredno). Nad žepom je trak za zapenjanje, s katerim se prepreči izpadanje radijske postaje ob sklanjanju. Ob ovratniku desno je zanka (širine vsaj 6 cm in višine 2 cm) v barvi oblačila za pripenjanje mikrofona radijske postaje ali detektorja ogljikovega monoksida.</p> <p>Spredaj spodaj, desno in levo je notranji žep (zunanji žep skrit v notranjost) z zadrgo dolžine ≈ 18 cm.</p> <p>V sredinskem delu in spodaj je vpeljana elastična vrvica, ki ima na obe strani plastičen regulator.</p> <p>V notranji strani vratnega izreza in v rokavih so pritiski gumbi in zadrga za pritrditev termo vložka v bundo (kapuca je lahko fiksna ali snemljiva).</p> <p>V vratni del sta všiti zanka za obešanje in velikostna številka. Etiketa z nazivom proizvajalca, načinom vzdrževanja, letnico izdelave in serijsko številko je našita na levi podlogi.</p>

		<p>Splošne zahteve za termo vložek</p> <p>Vložek je lahko odstranljiv ali fiksni in je obojstransko trapezno prešit.</p> <p>Kroj vložka je prilagojen za vpenjanje v bundo (z rokavi in brez njih).</p> <p>Z zadrgama je vpet med obrobnik in sprednjo zadrgo, ob vratnem izrezu in na dolžini rokavov je vpet s pritisknimi gumbi. Gumbi so na traku, izdelanem iz osnovne tkanine, zanka je elastična.</p> <p>Notranji del ovratnika je iz mehke in tople tkanine, dolžina rokav pa zaključena s patentom, dolgim ≈ 7 cm.</p> <p>V sredini vratnega izreza je v notranjosti všita velikostna številka, vzdrževalna etiketa pa v levi stranski šiv.</p>
1.2.1.5.	Priporočen material	<p>Material izpolnjuje sledeče splošne zahteve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robusten in lahek; - visoko barvno obstojen in stabilen; - odporen na trganje in obrabo; - prijeten na dotik in se hitro suši; - termostabilen. <p>Šivi so varjeni oz. lepljeni, ter nudijo vodotesnost. Zadrge so nepremočljive.</p> <p>Zunanji material (dvoslojni laminat) ali enakovredno:</p> <p>Zgornji sloj (tkanina): vsaj 30 % PES vsaj 25 % Lenzing FR vsaj 10 % Kermel vsaj 10 % Modacril vsaj 5 % Technora vsaj 2 % PA 6.6 vsaj 1 % Negastat</p> <p>Spodnji sloj (membrana): 100 % PU-Coating</p> <p>Izolacijski del (na notranji strani – dvoslojni) ali enakovredno:</p> <p>1. plast (zgornja stran izolacije): 100 % PA 6.6, vezava RIPSTOP Površinska masa: 55 g/m²</p> <p>2. plast (izolacijska vlakna): 100 % PES + 100 % PP (aluminizirana netkana bikomponentna tekstilija)</p> <p>Debelina: ≥ 19 mm Toplotna odpornost $R_{ct} \geq 0,32$ m²K/W Prešitje: trapezno</p>

1.2.2. Zaščitna jakna - letna



Slika 2: Skica jakne


Tabela 3: Specifikacije za jakno

1.2.2.1.	Barva	Visokovidna fluorescentna rdeča in visokovidna žveplenorumena barva (točna specifikacija barve v točki 1.1.1)
1.2.2.2.	Vidnost	<p>Upoštevanje standarda SIST EN ISO 20471 razred 2, skupaj z zaščitnimi delovnimi hlačami dosega razred 3.</p> <p>Odsevni trak naj poteka horizontalno čez prsni del in se nadaljuje čez hrbtni del. Trak naj se v isti višini (ko so roke ob telesu) nadaljuje na oba rokava.</p> <p>Odsevni trak naj poteka horizontalno 5 cm nad spodnjim robom in se nadaljuje čez hrbtni del. Trak naj se v isti višini (ko so roke ob telesu) nadaljuje na oba rokava.</p> <p>Odsevni trak naj vertikalno poteka po obeh rokavih ob strani od ramenskega dela do odsevnega traku spodaj, vendar ne čez embleme in našitke.</p>
1.2.2.3.	Zaščita (standard materiala)	<p>Verzija EME (Elastomultiester): SIST EN ISO 9237 - zagotavljanje zračnosti, ocena: 40 – 120 l/m²/s;</p> <p>SIST EN ISO 15496 - zagotavljanje odvajanja znoja od telesa (vpijanje znoja - hidrofilne lastnosti - na notranji strani, ocena ≥ 15.000 g/m²/24h)</p> <p><i>SIST EN 1149-5 – antistatičnost (opcijsko)</i></p>

		<p>Verzija Softshell:</p> <p>SIST EN 343 - zaščita materialov in šivov pred padavinami (npr. dež, snežinke), meglo in talno vlago in vetrom</p> <p>SIST EN ISO 11092 - odpornost tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje: Ret <20m2 Pa/W</p> <p>SIST EN ISO 4920 - vodoodbojnost: 3 (WR)</p> <p>SIST EN ISO 811 - vodni stolpec: ≥ 10.000 mm</p> <p><i>SIST EN 1149-5 - antistatičnost (opcijsko)</i></p>
1.2.2.4.	Tehnična izvedba	<p>Kroj zagotavlja udobno nošenje, neovirano gibljivost in je prilagojen delu na terenu.</p> <p>Oblačilo je prilagojeno nošenju pod zaščitno bundo.</p> <p>Na sprednjem delu se zapenja z zadrgo, ki sega do vrha ovratnika. Pod celotno dolžino zadrga je zaščitna letvica proti drgnjenju.</p> <p>Ovratnik, stoječ, z odpenjanjem prehaja v fazono (znotraj v črni barvi).</p> <p>Na levi strani prsi je žep za nošenje radijske postaje (za ročno radijsko postajo kot je Motorola R7 ali enakovredno). Nad žepom je trak za zapenjanje, s katerim se prepreči izpadanje radijske postaje ob sklanjanju. Ob ovratniku desno je zanka (širine vsaj 6 cm in višine 2 cm) v barvi oblačila za pripenjanje mikrofona radijske postaje ali detektorja ogljikovega monoksida.</p> <p>Rokavi so neodstranljivi, v predelu obeh pazduh sta prezračevalni odprtini z zadrgo in mrežico, na dolžini rokava pa sta »potegavček« in trak na ježek za uravnavanje širine rokava v zapestju. V tem predelu in na komolcih je blago v črni barvi, material pa zagotavlja povečano odpornost na obrabo (zapisano v točki 1.1.).</p> <p>Spredaj na prsih, desno in levo je »napoleon« žep, ki se zapira z zadrgo, dolžine ≈ 18 cm.</p> <p>Spredaj spodaj, desno in levo je notranji žep (zunanji žep skrit v notranjost) z zadrgo dolžine ≈ 18 cm.</p> <p>V vratni del sta všiti zanka za obešanje in velikostna številka. Etiketa z nazivom proizvajalca, načinom vzdrževanja, letnico izdelave in serijsko številko je našita na notranjo levo stran.</p>
1.2.2.5.	Priporočen material	<p><i>Material izpolnjuje sledeče splošne zahteve:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>trpežen, udoben za nošenje, lahek; raztegljiv;</i> - <i>visoko barvno obstojen in stabilen;</i> - <i>odporen na trganje in obrabo;</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>hidrofoben na zunanji strani in hidrofilen na notranji strani oblačila;</i> - <i>prijeten na dotik in se hitro suši;</i> - <i>termostabilen.</i> <p>Verzija EME: <i>Zunanji material 100 % EME oziroma 100 % T400, teža 215 - 235 g/m².</i></p> <p><i>Material zagotavlja raztegljivost za optimalno udobje ob gibanju (STX metoda: po osnovi 25 %, po votku 30 %);</i></p> <p><i>Vodoodbojen na zunanji strani (DWR nanos) oz. vodoodbojnost ocena: 5.</i></p> <p>Verzija Softshell: <i>sestava: vsaj 90 % recikliran POLIESTER / vsaj 5 % SPANDEX, PET MEMBRANA, 325 g/m² ±5 %</i></p>
--	--	---

1.2.3. Zaščitne hlače



Slika 3: Skica hlač

Tabela 4: Specifikacije za hlače

1.2.3.1.	Barva	Visokovidna fluorescentna rdeča in visokovidna žveplenorumena barva (točna specifikacija barve v točki 1.1.1)
1.2.3.2.	Vidljivost	<p>Ustreza standardu vidljivosti SIST EN 20471 razred 1 (v kombinaciji z delovno zaščitnim jopičem ali delovno zaščitno jakno razred 3 po SIST EN 20471)</p> <p>Na vsaki hlačnici spodaj (v celotnem obsegu hlačnice) so horizontalno nameščena dva odsevna trakova. Razmik med njima 6 cm. Na vsaki hlačnici ob strani vertikalno poteka odsevni trak, ki je nameščen na rumeni podlagi blaga (širine 6 cm), vendar ne gre čez stranski žep na levi in desni hlačnici.</p>
1.2.3.3.	Zaščita (standard materiala)	<p>SIST EN ISO 9237 - zagotavljanje zračnosti, ocena: 40 – 120 l/m²/s;</p> <p>SIST EN ISO 15496 - zagotavljanje odvajanja znoja od telesa (vpijanje znoja - hidrofilne lastnosti - na notranji strani, ocena ≥ 15.000 g/m²/24h)</p> <p><i>SIST EN 1149-5 – antistatičnost (opcijsko)</i></p>
1.2.3.4.	Tehnična izvedba	<p>Kroj zagotavlja udobno nošenje, neovirano gibljivost in je prilagojen delu na terenu.</p> <p>Široke in stabilne zanke za namestitev hlačnega pasu, opisanega v tej prilogi.</p>

		<p>Predel pasu je »elastičen« (nekoliko raztegljiv); zapenjanje v pasu z zadrگو in kovinsko zaponko. <i>Opcijsko je elastika pasu nastavljiva s trakom na ježka.</i></p> <p>Zgoraj spredaj 2x žep za roke (<i>opcijsko na zadrگو</i>), <i>opcijsko zgoraj zadaj 2x žep z zadrگو.</i></p> <p>Na levi hlačnici je ob strani žep v velikosti ≈ 21 cm višine in ≈ 19 cm širine. V žep se dostopa z zadrگو ali s trakom na ježka (kot npr. Velcro) (<i>če je zadrغا vodoravno zgoraj na žepu, dolga ≈ 17 cm</i>). Žep ima ob strani »zgubo« fluorescentno rumene barve, za večji volumen.</p> <p>Na desni hlačnici je ob strani žep v velikosti ≈ 21 cm višine in ≈ 19 cm širine. V žep se dostopa z zadrگو ali s trakom na ježka (kot npr. Velcro) (<i>če je zadrغا vodoravno zgoraj na žepu je dolga ≈ 17 cm</i>). Na žepu je našit dodaten žep širine ~ 5 cm in dolžine ~ 16 cm, črne barve (za pisalo). Žep ima ob strani »zgubo« fluorescentno rumene barve, za večji volumen.</p> <p>Za delo v klečečem položaju prirejen in ojačan kolenski predel (material zapisan v točki 1.1.) <i>Opcijsko v izvedbi žepa na zadrگو, namenjen vstavljanju dodatnih zaščitnih elementov za delo v klečečem položaju.</i></p> <p>Hlačnici sta spodaj, na notranji strani ojačani.</p> <p><i>Opcijsko se širini hlačnic regulira s trakom na ježka (kot npr. Velcro).</i></p> <p><i>Hlače so lahko tudi v zimski izvedbi.</i></p> <p>Hlače imajo všito velikostno številko. Etiketa z nazivom proizvajalca, načinom vzdrževanja, letnico izdelave in serijsko številko je našita na zadnjem notranjem delu.</p>
1.2.3.5.	Priporočen material	<p><i>Material izpolnjuje sledeče splošne zahteve:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>trpežen, udoben za nošenje, lahek; raztegljiv;</i> - <i>visoko barvno obstojen in stabilen;</i> - <i>odporen na trganje in obrabo;</i> - <i>hidrofoben na zunanji strani in hidrofilen na notranji strani oblačila;</i> - <i>prijeten na dotik in se hitro suši;</i> - <i>termostabilen.</i> <p><i>Zunanji material 100 % EME (Elastomultiester), teža 215 - 235 g/m².</i></p> <p><i>Material zagotavlja raztegljivost za optimalno udobje ob gibanju (STX metoda: po osnovi 25 %, po votku 30 %);</i></p> <p><i>Vodoodbojen na zunanji strani (DWR nanos) oz. vodoodbojnost ocena: 5.</i></p> <p><i>Zimske hlače se razlikujejo le po tipu materiala.</i></p>

1.2.4. Zaščitna obutev

Tabela 5: Specifikacije za zaščitno obutev

1.2.4.1.	Barva	Črna.
1.2.4.2.	Zaščita	<p>SIST EN ISO 20345, kategorija S3 tip C HRO-HI-CI-WR-SRC HRO – odpornost podplata na kontaktno toploto (+300°C/min); HI – toplotna izolacija; CI – izolacija pred mrazom; WR – vodotesnost celotnega čevlja; SRC – protizdrsnost (SRA – na tleh iz keramičnih ploščic (voda + detergent) + SRB – na jeklenih tleh z mazivom (glicerin).</p> <p>SIST EN IEC 61340 - antistatičnost</p> <p>Obutev je izdelana z zaščitno kapico in vmesnim podplatom ter ima vodoodbojen zgornji del.</p>
1.2.4.3.	Osnovna funkcionalnost	<p>Hitro obuvanje/sezuvanje (kot npr. Rescue Zip ali enakovredno).</p> <p>Individualno uravnavanje prilaganja obuvala k nogi.</p> <p>Prilagoditev obuvala posamezni obliki stopala z izbiro med različnimi, ergonomsko oblikovanimi vložki.</p> <p>Dolgotrajno nošenje (deli, ki so v neposrednem stiku z nogo so iz nogi prijaznega materiala, ki omogoča zračenje, dobro vpija in izpareva vlago ter se hitro suši).</p> <p>Odpornost proti krvi in telesnim tekočinam, preprečuje prodor virusom in bakterijam.</p> <p>Zaščitne kapice ne izvajajo nesprejemljivega pritiska na stopalo, npr. pri klečanju.</p>
1.2.4.4.	Splošne zahteve	<p>Notranja struktura: mrežasta pena obložena z visoko prožno distančno tkanino.</p> <p>Zamenljiv in pralen vložek (dobavljen tudi kot artikel za nego in vzdrževanje).</p> <p>Anatomsko oblikovan notranji podplat.</p> <p>Zunanji podplat odporen proti obrabi, ne pušča sledi in je profiliran v globini $\geq 2,5$ mm.</p> <p>Za lažje obuvanje je zadaj nameščena zanka.</p> <p>Višina nad 15 cm.</p> <p>Nizka teža.</p>

1.2.4.5.	Tehnična izvedba	Vodoodporen, odporen na udarce, preprečuje vdor kemikalij in drugih tekočin, protizdrsna guma na podplatu, zaščita pred soncem, da se noga ne pregreva, omogoča izhlapevanje vlage. Povišana obutev za zaščito gležnja.
----------	------------------	---

1.2.5. Rokavice za tehnično reševanje

Tabela 6: Specifikacije za rokavice za tehnično reševanje

1.2.5.1.	Zaščita	<p>Ustreza vsaj enemu od standardov:</p> <p>SIST EN 388 - zaščita pred mehanskimi tveganji zaradi obrabe, urezninami, raztrganine, predrtje in če je primerno, udarcev.</p> <p>SIST EN ISO 13997 - zaščita pred predmeti z ostrim robom med enim samim stikom pod različno silo.</p> <p>SIST EN ISO 374-1 - zaščita pred kemikalijami in mikroorganizmi</p>
1.2.5.2.	Osnovna funkcionalnost	Zaščito pred mehanskimi nevarnostmi. Zaščito pred kontaktno toploto. Odpornost na goriva in olja. Dobro prileganje. Dober oprijem. Dober otipni občutek. Enostavno nameščanje/snemanje (tudi ob sočasni uporabi rokavic za zaščito pred okužbami).
1.2.5.3.	Tehnična izvedba	<p>So lahke in zračne. Dodatne aplikacije na členkih in hrbtišču za zaščito pred udarci. Manšeta za zaščito pred drobci stekla in umazanijo. Kazalec prilagojen za delo z zaslonom na dotik. Notranja zanka z D-obročkom za karabin za pritrditev rokavic na pas za zaščitne hlače.</p> <p>Visokozmogljive rokavice z zaščito pred udarci, rezanjem, imajo taktilni občutek in oprijem. So brezšivne pletene rokavice izdelane iz visoko zmogljive kombinacije HPPE, fiberglasa, najlona in spandexa. Dlan je sestavljen iz rdečega nitrila z izrednim oprijemom, hrbtni del roke in prsti so opremljeni z ščitniki pred udarci</p> <p>Opcijsko na trakcu za prilagajanje širine logotip NMP Slovenija in napis NMP Slovenija.</p>

1.2.6. Zaščitna čelada s svetilko in vizirjem

Tabela 7: Specifikacije za čelado s svetilko in vizirjem

1.2.6.1.	Barva	Fotoluminescentna rumena.
1.2.6.2.	Zaščita	<p>SIST EN 16473 (technical rescue Type A) - zaščita pred mehanskimi udarci in preboji, ognjem, toploto ter električnimi in kemičnimi nevarnostmi</p> <p>SIST EN 12492 - zaščita pred udarci (absorbicija šoka), preboji, zagotavlja zadostno pokritost glave, široko vidno polje ter ustrezen sistem za pritrdjevanje</p>

1.2.6.3.	Osnovna funkcionalnost	Ustreza zahtevam za zaščito pred tveganji v različnih intervencijskih situacijah. Zasnovana za čim več udobja ob nošenju (tudi dolgotrajnem). Kompaktna, lahka, opsijsko prezračevana in hitro individualno prilagodljiva. Vsi deli čelade, ki lahko pridejo v stik s kožo, so iz zdravju neškodljivih in za kožo ne dražljivih materialov. Posamezni deli čelade so v primeru poškodbe enostavno zamenljivi.
1.2.6.4.	Splošne zahteve	Zunanja lupina je oblikovana tako, da ščiti glavo. Noben del čelade, ki pride v stik z glavo, ne sme imeti ostrih robov ali delov, ki bi lahko povzročali nelagodje ali celo poškodbe. Notranja košara, hitro nastavljiva po obsegu (od zunaj z vrtljivim gumbom) in višini ter oblazinjena z mehko prevleko za optimalno blaženje udarcev. Integriran vizir, najmanj za zaščito oči, nastavljiv po višini in globini, ki se ne rosi, je odporen na praske in z UV filtrom. Tritočkovni, po dolžini nastavljiv podbradni trak z zaskočno sponko, ki omogoča hitro sprostitev. Integrirana svetilka s kratkim in dolgim snopom in skupno močjo svetlobe ≈ 250 lumnov ali več, več urno svetilnostjo pri srednji svetilnosti in zaščito IP67. Teža čelade z dodatki: $\approx 1,5$ kg ali manj. Modularna izvedba omogoča integracijo druge dodatne opreme, npr. sistema za prostoročno komunikacijo. Priložena zaščitna tekstilna vreča za shranjevanje.
1.2.6.5.	Tehnična izvedba	Visokokakovostni vizir za zaščito oči 100-odstotno ultravijolična stabilna termoplastična školjka
1.2.6.6.	Oznake	Na čeladi logotip NMP Slovenija in napis enote/zavoda.

1.3. Delovna oprema

1.3.1. Jopica




Slika 4: Skica jopice

Tabela 8: Specifikacije za jopico

1.3.1.1.	Barva	Visokovidna fluorescentna rdeča in visokovidna žveplenorumena barva (točna specifikacija barve v točki 1.1.1)
1.3.1.2.	Tehnična izvedba	<p>Povečano vidnost. Primerno odpornost pred vremenskimi vplivi (zaščita pred mrazom). Primerno sproščanje/odvajanje vlage. Antistatičnost.</p> <p><i>Zaščito pred UV sončnim sevanjem (opcija). Obstoynost na kemikalije (opcija). Zaščito pred bakterijami, virusi in kontaminacijo s krvjo in drugimi telesnimi tekočinami/izločki (opcija).</i></p> <p>Kroj zagotavlja udobno nošenje, neovirano gibljivost in je prilagojen delu na terenu.</p> <p>Oblačilo je prilagojeno nošenju pod zaščitno jakno (letno ali zimsko).</p> <p>Na sprednjem delu se zapira z zadrgo, ki sega do vrha ovratnika.</p> <p>Ovratnik, stoječ, z odpenjanjem prehaja v fazono (znotraj v črni barvi).</p> <p>Rokavi so neodstranljivi, v predelu zapestja je blago v črni barvi (zapisano v točki 1.1.), lahko tudi v izvedbi elastične manšete.</p> <p>Spredaj na prsih, vsaj en »napoleon« žep, ki se zapira z zadrgo.</p>

		<p>Spredaj spodaj, desno in levo je notranji žep (zunanji žep skrit v notranjost) z zadrgo, v notranjosti črne barve.</p> <p>V vratni del sta všiti zanka za obešanje in velikostna številka. Etiketa z nazivom proizvajalca, načinom vzdrževanja, letnico izdelave in serijsko številko je všita v levem sestavnem šivu.</p>
1.3.1.3.	<i>Priporočen material</i>	<p><i>Material izpolnjuje sledeče splošne zahteve: trpežen, udoben za nošenje, lahek, raztegljiv; visoko barvno obstojen in stabilen; odporen na trganje in obrabo; hidrofilen na notranji strani oblačila; prijeten na dotik in se hitro suši; termostabilen.</i></p> <p><i>Sestava: mešanica poliestra in elastana (vsaj 90 % poliester in vsaj 2 % elastan)</i></p> <p><i>Teža: 300 – 320 g/m²</i></p>

1.3.2. Taktični brezrokavnik

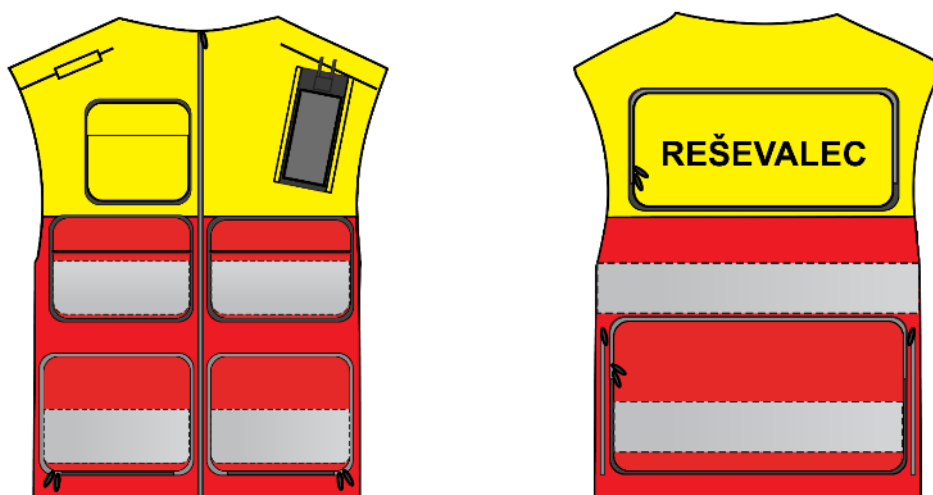


Slika 5: Skica taktičnega telovnika

Tabela 9: Specifikacije za taktični brezrokavnik

1.3.2.1.	Barva	Visokovidna fluorescentna rdeča in visokovidna žveplenorumena barva (točna specifikacija barve v točki 1.1.1)
1.3.2.2.	Vidnost	Upoštevanje standarda SIST EN ISO 20471 razred 1, skupaj z zaščitnimi delovnimi hlačami dosega razred 2.
1.3.2.3.	Zaščita (standard materiala)	<p>SIST EN ISO 9237 - zagotavljanje zračnosti, ocena: 40 – 120 l/m²/s;</p> <p>SIST EN ISO 15496 - zagotavljanje odvajanja znoja od telesa (vpijanje znoja - hidrofilne lastnosti - na notranji strani, ocena ≥ 15.000 g/m²/24h)</p> <p><i>SIST EN 1149-5 – antistatičnost (opcijsko)</i></p>

1.3.2.4.	Tehnična izvedba	<p>Prilagojena delu na terenu ter omogoča udobno nošenje in gibanje.</p> <p>Spredaj ima pet žepov za skladiščenje materiala.</p> <p>Na levi strani prsi je žep za nošenje radijske postaje (za ročno radijsko postajo kot je Motorola R7 ali enakovredno). Nad žepom je trak za zapenjanje, s katerim se prepreči izpadanje radijske postaje ob sklanjanju. Ob ovratniku desno je zanka (širine vsaj 6 cm in višine 2 cm) v barvi oblačila za pripenjanje mikrofona radijske postaje ali detektorja ogljikovega monoksida.</p> <p>Hrbtina stran ima spodaj večji žep za skladiščenje materiala ter žep pod spodnjim žepom, zgoraj manjši žep.</p> <p>V vratni del sta všiti zanka za obešanje in velikostna številka. Etiketka z nazivom proizvajalca, načinom vzdrževanja, letnico izdelave in serijsko številko je našita na levi notranji strani.</p>
1.3.2.5.	Priporočen material	<p>Zunanji material 100 % EME, teža 215 - 235 g/m².</p> <p>Material zagotavlja raztegljivost za optimalno udobje ob gibanju (STX metoda: po osnovi 25 %, po votku 30 %);</p> <p>Vodoodbojen (hidrofoben) na zunanji strani (DWR nanos) oz. vodoodbojnost ocena: 5.</p>

1.3.3. Majica s kratkimi ali dolgimi rokavi



Slika 6: Skica bele T-shirt majice za izvajanje službe NMP

Tabela 10: Specifikacije za majico

1.3.3.1.	Barva	Bela barva (točna specifikacija barve v točki 1.1.1)
----------	-------	--

1.3.3.2.	Zaščita/higiena	Odstotek zmanjšanja bakterij po 50 pranjih: najmanj 95 %
1.3.3.3.	Tehnična izvedba	Kroj omogoča neovirano gibljivost in je prilagojen delu na terenu. Podaljšan kraj (sega čez bok uporabnika) zaradi urejenosti ter omogočati nošenje majice v hlačah. Kratka majica: rokavi naj bodo pribl. četrtnine dolgih rokavov. Dolga majica: Rokavi ne smejo ovirati dela. Različnih velikosti (standardne ali unisex).
1.3.3.4.	Priporočen material	<i>Material izpolnjuje sledeče splošne zahteve: trpežen, udoben za nošenje, lahek, raztegljiv, visoko barvno obstojen in stabilen, odporen na trganje in obrabo, termostabilen, neprosojen.</i> <i>Kratka majica: sestava: 95% bombaž (± 5 %) in 5 % elastan (±5 %) gostota tkanja 180 g/m² (± 5 %).</i> <i>Dolga majica: sestava: 95% bombaža (± 5 %) in 5 % elastana (±5 %) gostota tkanja 210 - 220 g/m² (± 5 %).</i>

1.3.5. Kapa - letna

Slika 8: Skica letne kape



Tabela 12: Specifikacije za letno kapo

1.3.5.1.	Barva	Črna barva
1.3.5.2.	Tehnična izvedba	Klasična kapa lahko na prepogljiv šilt, šivi izvedeni tako, da zdržijo normalna natezanja, zaključki šivov so čvrsto izdelani, notranji šivi takšni, da ne povzročajo osipanja tkanine, univerzalna velikost z možnostjo nastavitve.

1.3.5.3.	Oznake	Logotip NMP na sprednjem sredinskem delu kape, ime in priimek na levi strani, ime enote/zavoda na desni strani. Napisi višine 0.6 do 0.8 cm.
1.3.5.4.	<i>Priporočen material</i>	<i>sestava: 100 % EME</i> <i>površinska masa: 215 – 235 g/m ±5 %</i>

1.3.6. Kapa - zimska



Slika 9: Skica zimske kape

Tabela 13: Specifikacije za zimsko kapo

1.3.6.1.	Barva	črna
1.3.6.2.	Tehnična izvedba	Klasična kapa, šivi so izvedeni tako, da zdržijo normalna natezanja, zaključki šivov so čvrsto izdelani, kapa je na voljo v več velikostih. Kapa je podložena s termo velur tkanino črne barve.
1.3.6.3.	Oznake	Logotip NMP na sprednjem sredinskem delu kape, ime in priimek na levi strani, ime enote/zavoda na desni strani. Napisi višine 0.6 do 0.8 cm.
1.3.6.4.	<i>Priporočen material</i>	<i>sestava: vsaj 60 % AKRIL / vsaj 30 % POLIESTER ali podobno. Opcijsko so del tkanine reflektivna vlakna.</i>

1.3.7. Pas

Tabela 14: Specifikacije za pas

1.3.7.1.	Barva	Črna barva
1.3.7.2.	Material	Sestava: 100 % poliester ali najlon
1.3.7.3.	Tehnična izvedba	Pas je sestavljen iz dveh delov: <ul style="list-style-type: none"> - prvi del je spodnji pas katerega si uporabnik namesti skozi zanke na hlačah. Je brezstopenjsko nastavljen po obsegu in se pritrdi z velcro trakom.


		<p>- drugi del je zgornji pas se na spodnjega pritrdi z metodo sprimnega traku (velcro). Drugi del pasu ima plastično varnostno zaponko ter več zank za pritrdjevanje opreme (svetilka...).</p> <p>Zgornji in spodnji pas je individualno (brezstopenjsko) nastavljen po dolžini.</p> <p>Pas ima približno 50 mm širok, pas je na voljo v različnih velikostih.</p>
--	--	---

1.3.8. Oznake imena in priimkov

Primer označevanja na zgornjih oblačilih (označevanje imena in naziva zdravstvenih delavcev v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice - glej točko 1.1.2. v tej prilogi).



Primer označevanja na spodnjih oblačilih (označevanje se lahko izvede na všitku znotraj hlač):



Na majice dovoljen tisk oznak.

1.3.9. Oprema za izredne razmere

1.3.9.1.	Barva	<p>Z brezrokavniki rumene barve (RAL 1016 ali primerljivo) so označeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodja intervencije NMP, - vodja primarne triaže, ki ima na sprednjem in zadnjem delu brezrokavnika še kvadratke temnejšega odtenka in - vodja mesta zdravstvene oskrbe, ki ima na sprednjem in zadnjem delu brezrokavnika še kvadratke svetlejšega odtenka. <p>Z brezrokavnikom zelene barve (RAL 6032 ali primerljivo) je označen koordinator prevozov.</p> <p>Z brezrokavnikom zelene barve (RAL 6032 ali primerljivo), ki ima na sprednjem in zadnjem delu še kvadratke svetlejšega odtenka, je označen prometnik.</p> <p>Z brezrokavniki sive barve (RAL 7010 ali primerljivo) so označeni vodje sektorjev.</p> <p>Odsevni trakovi so v srebrnozeleni kombinaciji (opcijsko).</p>
----------	-------	---

1.3.9.2.	Oznake	Opis funkcije spredaj manjše in na hrbtu večje. Napisi so lahko snemljivi (npr. na način Velcro pritrjevanja). Napisi sledijo poimenovanjem v aktualnih smernicah za delovanje sistema NMP v množičnih nesrečah.
----------	--------	--

1.4. Balistična zaščita

1.4.1. Nosilec balistične zaščite

Tabela 15: Specifikacije za nosilec balistične zaščite

1.4.1.1.	Barva	Črna.
1.4.1.2.	Tehnična izvedba	<p>Nosilec balistične zaščite se izdeluje v različnih standardnih velikostih.</p> <p>Unisex (primeren za uporabo s strani žensk in moških).</p> <p>Na notranji strani nosilca balistične zaščite je všita etiketa oziroma več etiket, iz katerih bodo razvidni sledeči podatki:</p> <ul style="list-style-type: none">- proizvajalec,- ime/model izdelka,- velikost,- letnica proizvodnje (mesec/leto izdelave),- surovinski sestav materiala,- način in navodilo o vzdrževanju (piktogrami) ter- morebitni drugi podatki in opozorila proizvajalca. <p>Nosilec balistične zaščite je sestavljen iz sprednjega in zadnjega dela, ki sta povezana skupaj z ježki ali primerljivim sistemom. Tako sprednji in zadnji del omogoča odstranjevanje balističnega vložka in pranje.</p> <p>Jopič ima en žep spredaj in enega zadaj, ki se zapirata z zadrgo ali ježki in služita za vstavitve balističnih plošč (dimenzija 25x30 cm).</p> <p>Omogoča dodajanje trdih oklepnih plošč spredaj in zadaj.</p> <p>Je prožen, tanek ($\approx 7\text{mm}$) in ga je možno dobro prilagajati različnim telesnim konstitucijam.</p> <p>Primeren za dolgotrajno nošenje.</p> <p>Odporen na vodo in znoj.</p> <p>Termodinamičen.</p>
1.4.1.3.	Oznake	Velcro: spredaj in zadaj (za pritrditev reflektivnih trakov in reflektivnega napis NMP ali logotip NMP)

1.4.2. Mehka in trda balistična zaščita

Tabela 16: Specifikacije za balistično ploščo

1.4.2.1.	Zaščita	<p>Mehka balistična zaščita</p> <p>Balistična zaščita (TR SK-1 (3/2008 z dopolnitvami 10/2008 in 09/2009)):</p> <ul style="list-style-type: none">- z dovoljeno travmo (Blunt Trauma) do 44 mm- <i>priporočeno z dodatno zaščito pred izstrelki kalibra 7,62 x 25 mm Tokarev; krogla FMJ, hitrost 450m/s (+/-10 m/s)*</i>
----------	---------	---

		<p>ali standard NIJ IIIA 0101.04 ali standard NIJ IIIA 0101.06.</p> <p>Zaščita pred vbodi (NIJ 0115.00):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nož P1 - E1=9 J, do 10 mm penetracije - E2=18 J, do 20 mm penetracije <p>ali po standardu HOSDB 2017 KR1+SP1 ali primerljivo.</p> <p>Trda balistična zaščita*</p> <p>Balistična zaščita (NIJ 0101.06 III ICW ali NIJ 0101.04 level III (3)):</p> <ul style="list-style-type: none"> - stopnja zaščite je namenjena zaustavljanju neoklepnih puškinih streliv, kot je 7,62 x 51 mm NATO FMJ (Full Metal Jacket), s hitrostjo približno 847 m/s - ICW (in conjunction with) - označuje, da ta balistična plošča ni samostojno učinkovita in je uporabljena v kombinaciji z mehkim balističnim vložkom, kar omogoča fleksibilno in lažjo zaščito - SA (stand alone)
1.4.2.2.	Tehnična izvedba	<p>Mehka balistična zaščita</p> <p>Zaščitni vložek ob uporabnikovem gibanju (sedenje, hoja, tek, vstajanje, vožnja itd.) ostane na svojem mestu in ohrani svojo obliko. Zaščitni vložki se izdelujejo po individualnih merah nosilcev balističnih plošč, znotraj standardnih velikosti. Sestavljena je iz prsnega in hrbtne deli. Prilagojen je tako, da se prilaga površini notranjega dela nosilca balistične zaščite.</p> <p>Tanke zasnove, debelina ne sme presegati 8,5 mm +10 %, lahka. Zaščiten pred tekočinami, kot sta voda in olje. Odporna na mraz in vročino.</p> <p>Trda balistična zaščita*</p> <p>Uporaba v kombinaciji z mehko balistiko (ICW). Lahek za nošenje.</p>

*uporaba je opcиска, a omogoča boljšo zaščito

1.4.3. Čelada z balistično zaščito

Tabela 17: Specifikacije za čelado z balistično zaščito

1.4.3.1.	Barva	Črna.
1.4.3.2.	Zaščita	NIJ 0106.01 z grožnjami IIIA 0101.06: .44 magnum in .357 SIG ali enakovredno; NIJ 0106.01 z grožnjami IIIA 0108.01: .44 magnum in 9 mm FMJ ali enakovredno; V50 STANAG 2920: 660 m/s.
1.4.3.3.	Tehnična izvedba	Zagotavlja 50 % zmanjšanje deformacije hrbtne strani (BFD) proti kalibru 9 mm (HPW-TP-0401.01B IIIA).

		<p>Izdelana iz visoko zmogljivih kevlar aramidnih vlaken.</p> <p>Model z visokim izrezom.</p> <p>Notranje oblazinjenje (za zmanjšanje učinka travme zaradi topih udarcev in boljše udobje) je iz spominske pene, z možnostjo prilagajanja.</p> <p>Zapenjanje in nastavitev s sistemom BOA-FIT.</p> <p>Na sprednji strani nosilec združljiv z nosilci Wilcox G24, na straneh tirnice združljive s 3m Peltor, Sordin, Ops-core AMP arms, Earmor in Unity Tactical rail adapterji.</p> <p>Majhna teža: ≤ 1,45 kg.</p> <p>Odporna na temperaturo.</p> <p>Odporna na tekočine in olja.</p> <p>Odporna na padce.</p>
1.4.3.4.	Splošne zahteve	Velikosti: M, L, XL

1.5. Zaščitna oprema za potrebe reševalca motorista

1.5.1. Jakna

Tabela 18: Specifikacije za motoristično jakno

1.5.1.1.	Priporočena barva*	<i>Priporočena visokovidna fluorescentna rdeča in visokovidna žveplenorumena barva (točna specifikacija barve v točki 1.1.1). Barva glede na dobavljivost.</i>
1.5.1.2.	Vidnost	Upoštevanje standarda SIST EN ISO 20471 razred 2, skupaj z zaščitnimi delovnimi hlačami dosega razred 3. Priporočena uporaba visokovidnih barv in odsevnih trakov.
1.5.1.3.	Zaščita	SIST EN 13595-1 - ključne zahteve standarda so naslednje: Mehanska zaščita: Oblačila zagotavljajo ustrezno odpornost na obrabo in poškodbe pri drsenju po cestišču, da zmanjšajo tveganje za odrgnine in poškodbe kože. Oblačila so izdelana iz materialov, ki so odporni proti obrabi, trganju in predrtju. Zaščita pred udarci: Oblačila vključujejo zaščitne elemente, ki varujejo ključne dele telesa, kot so ramena, komolci, kolki in kolena, pred udarci med padcem. Termalna odpornost: Materiali, iz katerih so oblačila izdelana, prenašajo toplotni šok ali trenje brez taljenja ali vnetja, kar je pomembno, če pride do daljšega drsenja po cesti. Udobje in ergonomija: Oblačila so zasnovana tako, da ne omejujejo gibanja uporabnika, kar je bistveno za varno upravljanje motornega vozila. Prav tako omogočajo ustrezno prezračevanje. Vidnost: Za službe, ki delujejo v nujnih primerih, so pomembni odsevni in signalni elementi na oblačilih, da so vozniki motorjev boljše vidni drugim udeležencem v prometu.
1.5.1.4.	Osnovna funkcionalnost	Dobro vidnost. Zaščito pred vremenskimi vplivi (dež/sneg, veter, mraz – v kombinaciji z vložkom/jopico). Dobro sproščanje/odvajanje vlage in toplote (zračnost). Antistatičnost. Zaščito pred UV sončnim sevanjem (opcija). Obstoynost na kemikalije (opcija). Zaščito pred bakterijami, virusi in kontaminacijo s krvjo in drugimi telesnimi tekočinami/izločki (opcija).
1.5.1.5.	Tehnična izvedba	Oprema vključuje zaščito ključnih delov telesa (ramena, komolci), odporna proti udarcem. Oblačila zagotavljajo visoko vidljivost s signalnimi in odsevnimi elementi. Upoštevati je treba udobje uporabnikov za nemoteno opravljanje nalog.

		Kombinezon je izdelan tako, da je pri močnem dežju najmanj eno uro popolnoma vodotesen. Testna metoda: 1-urna simulacija dežja od zgoraj (12 l/min) in od strani (2x4 l/min). Kombinezon je vodotesen tudi po 10 pranjih. Na vsakem izdelku (jopič in hlače) je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka.
1.5.1.6.	Priporočen material	<p>Material izpolnjuje sledeče splošne zahteve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robusten in lahek; - visoko barvno obstojen in stabilen; - odporen na trganje in obrabo; - prijeten na dotik in se hitro suši; - termostabilen. <p>Šivi so varjeni oz. lepljeni, ter nudijo vodotesnost. Zadrge so nepremočljive.</p> <p>Sestava vrhnjega dela materiala je Cordura 500 ali enakovredno.</p>

1.5.2. Hlače

Tabela 19: Specifikacije za motoristične hlače

1.5.2.1.	Priporočena barva*	Priporočena visokovidna fluorescentna rdeča in visokovidna žveplenorumenena barva (točna specifikacija barve v točki 1.1.1). Barva glede na dobavljivost.
1.5.2.2.	Vidnost	Upoštevanje standarda SIST EN ISO 20471 razred 2, skupaj z zaščitnimi delovnimi hlačami dosega razred 3. Priporočena uporaba visokovidnih barv in odsevnih trakov.
1.5.2.3.	Zaščita	SIST EN 13595-1 (enako kot v zgornji točki)
1.5.2.4.	Osnovna funkcionalnost	Dobra vidnost. Zaščita pred vremenskimi vplivi (dež/sneg, veter, mraz – v kombinaciji z vložkom/jopico). Dobro sproščanje/odvajanje vlage in toplote (zračnost). Antistatičnost. Zaščita pred UV sončnim sevanjem (opcija). Obstojnost na kemikalije (opcija). Zaščito pred bakterijami, virusi in kontaminacijo s krvjo in drugimi telesnimi tekočinami/izločki (opcija).
1.5.2.5.	Tehnična izvedba	Hlače se na jopič pripnejo z zadrgo. Na hlačah so ojačitve na zadnjici, bokih, kolenih in delno na dolžini. Kombinezon je podložen s termo podlogo, ki je v model vpeta z deljivo zadrgo. Podlaga je snemljiva. Kombinezon ima vdelane zračnike izvedene z zadrkami. Zaščitne obloge lahko pri čiščenju odstranimo iz kombinezona. Na kombinezon so našiti srebrni odsevni trakovi.

1.5.3. Telovnik

Tabela 20: Specifikacije za motoristični telovnik

1.5.3.1.	Barva	Visokovidna žveplenorumena barva (točna specifikacija barve v točki 1.1.1)
1.5.3.2.	Ostalo	Enako kot telovnik v točki 1.3.2
1.5.3.3.	Varnost	Varnostni Airbag jopič za zunanjo uporabo (oblečen nad motoristično jakno) in črne barve za notranjo uporabo (oblečen pod jakno) z brezžično-bluetooth povezavo in aktivacijo pri padcu z motornega kolesa.

1.5.4. Majica

Specifikacije enake kot točka 1.3.3. v tej prilogi.

1.5.5. Obutev

Tabela 21: Specifikacije za motoristično obutev

1.5.5.1.	Barva	Črna
1.5.5.2.	Tehnična izvedba	Visok ali polpovišan model, z vodoodporno membrano Gore Tex, podplat za turni in off-road teren z dobrim oprijemom, ojačitve na goleni, gležnju, prstih in peti.

1.5.6. Podkapa

Tabela 22: Specifikacije za motoristično podkapo

1.5.6.1.	Barva	Črna
1.5.6.2.	Tehnična izvedba	Letna: antibakterijska tkanina, ki zagotavlja ohranjanje optimalne telesne temperature in odvajanje vlage. Brezšivna zasnova za udobno nošenje. Zimska: Podkapa z protivetrovno membrano z visoko zaščito pred vetrom in mrazom, ki omogoča uravnavanje temperature in odvajanje vlage. Zgornji del podkape izdelan iz elastičnega zračnega materiala in proti vetru odporen material na predelu vratu in zgornjega dela prsi.

1.5.7. Motoristična čelada

Tabela 23: Specifikacije za motoristično čelado

1.5.7.1.	Barva	Visokovidna žveplenorumena barva ali približek.
1.5.7.2.	Zaščita	ECE R 22/05 - ključne zahteve in lastnosti: Udarne lastnosti: Čelada prenese teste, ki simulirajo udarce v različnih točkah na površini čelade (spredaj, zadaj, zgoraj in na straneh), pri čemer čelada absorbira dovolj energije, da zmanjša tveganje za poškodbo glave. Ta test zagotavlja, da čelada ščiti glavo pred hudimi poškodbami v primeru nesreče. Test predrtja: Čelada je odporna na ostre predmete, da prepreči predrtje. To je ključna lastnost, saj v primeru padca ali nesreče glava ne sme biti izpostavljena ostrim predmetom.

		<p>Sistem za pritrjevanje: Sistem za pritrjevanje (običajno pašček pod brado) je zasnovan tako, da zadrži čelado na mestu tudi ob močnem udarcu ali nenadnem premiku. Testi preizkušajo trdnost in zanesljivost tega sistema.</p> <p>Vidno polje: Čelada zagotavlja dovolj širok zorni kot, da uporabniku omogočajo dober periferni vid. Ozek vidni kot bi lahko zmanjšal sposobnost opazovanja nevarnosti.</p> <p>Vizirji (zaščita oči): Če čelada vključuje vizir, je ta izdelan iz materiala, odpornega proti praskam in udarcem, da ščiti oči pred prahom, insekti ali majhnimi delci. Vizir zagotavlja jasen vid brez popačenja in zaščito pred UV žarki.</p> <p>Udobje in teža: ECE R 22/05 standard določa tudi zahteve glede udobja in teže čelade, da se zagotovi dolgotrajno nošenje brez nepotrebne pritiska na vrat ali glavo.</p> <p>Preizkus trpežnosti pri različnih temperaturah: Čelada ohranja zaščitne lastnosti pri visokih in nizkih temperaturah ter v vlažnih razmerah, da so učinkovite v vseh vremenskih pogojih.</p> <p>Označevanje: Čelada, ki ustreza standardu ECE R 22/05, je označena z uradnim znakom in dodatnimi informacijami, kot so velikost, tip čelade, certifikat, datum izdelave itd.</p>
1.5.7.3.	Komunikacija	Bluetooth in/ali radijsko povezavo z povezovalnim kablom.

1.5.8. Motoristične rokavice

Tabela 24: Specifikacije za motoristične rokavice

1.5.8.1.	Zaščita	SIST EN 13594 - za zaščito členkov
1.5.8.2.	Tehnična izvedba	<p>Letna podkapa: antibakterijska tkanina, ki zagotavlja ohranjanje optimalne telesne temperature in odvajanje vlage. Brezšivna zasnova za udobno nošenje.</p> <p>Podkapa z protivetrovno membrano z visoko zaščito pred vetrom in mrazom, ki omogoča uravnavanje temperature in odvajanje vlage. Zgornji del podkape izdelan iz elastičnega zračnega materiala in proti vetru odporen material na predelu vratu in zgornjega dela prsi.</p>

1.6. Seznam, količina ter menjava delovne in zaščitne opreme za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

Tabela 25: Seznam, količina in menjava opreme

Oprema člana MoE NRV, VUZ			
št.	zaščitna oprema	število kosov	menjava v letih
1.	Majica s kratki rokavi	4	1*
2.	Majica z dolgimi rokavi	2	1*
3.	Zaščitne hlače - letne	4	2*
4.	Zaščitna jakna - zimska	1	6*
5.	Zaščitna jakna - letna	1	4*
6.	Termo jopica	1	4*
7.	Dvojni pas za delovne hlače	1	6*
8.	Taktični brezrokavnik	1**	6**
9.	Letna kapa	1	6*
10.	Zimska kapa	1	6*
11.	Rokavice za tehnično reševanje	1	6*
12.	Zaščitna obutev	1	4*
13.	Sredstva za čiščenje in vzdrževanje obutve	1	1
Dodatna oprema za motorista reševalca:			
št.	zaščitna oprema	število kosov	menjava v letih
1.	Motoristična čelada	1	4*
2.	Motoristične hlače	1	2*
3.	Motoristična jakna	1	4*
4.	Motoristični škornji	1	4*
5.	Majica proti potenju	4	2*
6.	Zaščitni brezrokavnik (airbag)	1	4*
7.	Motoristične rokavice letne	2	4*
8.	Motoristične rokavice zimske	1	4*
9.	Podkapa	2	2*

Ostalo			
št.	zaščitna oprema	število kosov	menjava v letih
1.	Zaščitna čelada	2 **	10**
2.	Balistična zaščita	M, L, XL, XXL ***	10***

Dodatna obrazložitev:

- *predčasna menjava ob obrabi **vezano na vozilo ali na posameznika
- ***Balistična zaščitna oprema se lahko shranjuje v prostorih zavoda
- Navedena je minimalna vsebina, enote lahko po lastni presoji vsebino razširijo.

Tabela prikazuje standardno količino opreme na zaposlenega ter priporočene intervale menjave. Oprema se zamenja tudi pred navedenim rokom, kadar je zaradi obrabe, poškodb ali drugih vzrokov njena funkcionalnost zmanjšana.

Pogoji za zdravstvene delavce, ki se vključujejo v sekundarne prevoze pacientov:

1. zaščitna obutev kot navaja točka 1.2.4 (višina je lahko manj kot 15 cm)
2. zaščitne hlače kot navaja točka 1.2.3
3. letna zaščitna jakna kot navaja točka 1.2.2
4. službena majica

1.6.1. Oblačilo se smatra za obrabljeno, ko so prisotni naslednji znaki:

Tabela 26: Obrabljeno oblačilo

1.6.1.1.	Luknje in raztrganine	Vidne luknje ali raztrganine, ki vplivajo na celovitost oblačila in jih ni mogoče enostavno popraviti.
1.6.1.2.	Izguba barve	Barva oblačila je opazno zbledela zaradi pranja, izpostavljenosti sončni svetlobi ali starosti.
1.6.1.3.	Izguba oblike	Oblačilo je izgubilo svojo prvotno obliko, material je raztegnjen ali deformiran, kar vpliva na prileganje.
1.6.1.4.	Muckanje	Na površini tkanine so nastale majhne kroglice ali vozlički, še posebej na mestih, kjer je več trenja (npr. pod pazduhami, na komolcih).
1.6.1.5.	Izrabljeni šivi	Šivi so popustili, niti so se začele cefrati ali trgati, kar vpliva na strukturo oblačila.
1.6.1.6.	Zadrge in gumbi	Zadrge so pokvarjene, gumbi manjkajo ali so se zrahljali in niso več funkcionalni.
1.6.1.7.	Trenjem poškodovane površine	Na določenih mestih je material iztrošen in tanek zaradi stalnega trenja (npr. na kolenih, komolcih, robovih žepov).
1.6.1.8.	Neprijeten vonj	Oblačilo ohranja neprijeten vonj, kljub ponavljajočemu pranju.
1.6.1.9.	Madeži	Trdovratni madeži, ki jih ni mogoče odstraniti, tudi po večkratnem pranju.

Dodatna obrazložitev:

Ko oblačilo kaže dva ali več teh znakov, se šteje za obrabljeno in je potrebna predčasna zamenjava;

1.6.2. Obutev se smatra za obrabljeno, ko kaže naslednje znake obrabe

Tabela 27: Obrabljeno obutve

1.6.2.1.	Izrabljeni podplati	Podplati so zlizani, gladki ali poškodovani, kar zmanjšuje oprijem in lahko povzroči zdrs.
1.6.2.2.	Izrabljene zunanje plasti materiala	Izrabljene zunanje plasti materiala čevlja se nanašajo na poškodbe ali obrabo zunanjega dela čevlja. Znaki obrabe so: Razpoke in luknje: Najbolj očiten znak, ki kaže na potrebno zamenjavo ali popravilo čevlja. Izguba barve: Barva na zunanji plasti blede ali se lušči. Odlepljanje: Material se ločuje od podlage, kar je pogosto pri čevljih z lepjenimi deli. Zmečkanine in gube: Usnje ali drugi materiali se lahko sčasoma deformirajo. Redčenje materiala: Zmanjšanje debeline zunanje plasti zaradi dolgotrajne uporabe.
1.6.2.3.	Razpoke in luknje	Vidne razpoke, luknje ali pretrganine v zgornjem delu čevlja zmanjšujejo zaščito stopal.
1.6.2.4.	Izguba oblazinjenja	Notranje oblazinjenje je stanjšano ali deformirano, kar zmanjšuje udobje in podporo stopal.
1.6.2.5.	Deformacija oblike	Čevlji so izgubili svojo prvotno obliko, kar vpliva na prileganje in podporo stopal.
1.6.2.6.	Sprostitev šivov	Šivi so popustili ali se trgajo, kar lahko vodi do ločitve delov čevlja.
1.6.2.7.	Poškodovana petna kapica	Petna kapica je obrabljena, deformirana ali razpokana, kar vpliva na prileganje in stabilnost.
1.6.2.8.	Zlomljeni ali poškodovani deli:	Pokvarjeni ali manjkajoči deli, kot so zadrge, vezalke, zaponke ali ježki, vplivajo na funkcionalnost obutve.
1.6.2.9.	Izrabljena notranja obloga	Notranja obloga je stanjšana, raztrgana ali neudobna
1.6.2.10.	Neprijeten vonj	Stalen neprijeten vonj, ki se ga ne da odstraniti kljub čiščenju in prezračevanju.
1.6.2.11.	Neskladna velikost:	Čevlji se ne prilegajo več pravilno, kar povzroča nelagodje ali bolečine pri hoji.

Dodatna obrazložitev:

Ko obutev kaže dva ali več teh znakov, se šteje za obrabljeno in je potrebna predčasna zamenjava.

Priloga 4: Seznam zdravil, opreme in medicinskih pripomočkov za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP in izvajanje prevozov pacientov

Navedena je minimalna vsebina, izvajalec lahko po lastni presoji vsebino razširi.

Legenda:

¹MoE NRV = mobilna enota nujnega reševalnega vozila

²MoE VUZ = mobilna enota vozila urgentnega zdravnika

³MoE RM = mobilna enota reševalec motorist

⁴MoE VDZ = mobilna enota vozila dežurnega zdravnika

⁵RV = reševalno vozilo (nenujno reševalno vozilo)

1. Seznam medicinske opreme in pripomočkov

ZAP. ŠT.	OPREMA IN PRIPOMOČKI	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA
		MoE NRV ¹	MoE VUZ ²	MoE RM ³	MoE VDZ ⁴	RV ⁵
1.	atravmatska igla za torakocentezo	1	1	1		
2.	avtomatski zunanji defibrilator (AED)					1
3.	avtomatski zunanji defibrilator (AED) s prikazom EKG ritma			1		
4.	balistična zaščitna oprema	(1)	(1)			
5.	digitalni ušesni termometer	1	1	1	1	1
6.	dokumentacija v skladu z aktualnim Pravilnikom o službi NMP	1	1	1	1	1
7.	dvostranska metalizirana folija	2	2	1	2	2
8.	električni aspirator z aspiracijskimi cevkami	1	1		1	
9.	fonendoskop	1	1	1	1	
10.	glukometer	1	1	1	1	1
11.	grelna odeja za enkratno uporabo	2	2			
12.	hladilna obloga	4	4			
13.	kompleti za vodilne funkcije v primeru množičnih nesreč	1	1			
14.	magnet za ICD/PM		1			
15.	manšeta za forsirano infundiranje raztopin	2	1	1		
16.	mehanska naprava za izvajanje stisov prsnega koša		1			
17.	monitor/defibrilator s sodobnimi moduli	1	1		1	

18.	nahrbtnik z naborom opreme, pripomočkov in materiala za oskrbo/oživljanje	1	1		1	1
19.	nastavek z masko za inhalacijsko aplikacijo zdravil odraslim in otrokom	2	2		2	
20.	obvezilni in sanitetni material, hemostatični povoj/blazinica	večja	večja	večja	večja	večja
21.	opeklinška odeja in opeklinške obloge različnih dimenzij	1	1			
22.	osebna zaščitna oprema (podaljšane nitrilne rokavice, maske za obraz tip IIR in FFP2/3, vizir/očala, plašč/kombinezon)	2	2	1	2	2
23.	otoskop z nastavki različnih velikosti				1	
24.	pediatrični barvni trak	1	1	1		
25.	perfuzor z brizgo in sistemom	1	1			
26.	prenosni ultrazvok		1		1	
27.	prenosni ventilator (z možnostjo neinvazivne ventilacije - NIV) in maske za NIV	1				
28.	prenosni videolaringoskop		1			
29.	pripomoček z rezilom za hitro rezanje oblačil ali taktične škarje	1	1	1		
30.	pripomoček za intranazalno aplikacijo zdravil	2	2	2		
31.	pripomoček za transport otrok	1				
32.	pripomoček za zaustavljanje krvavitev (kot CAT)	2	2	2	2	2
33.	pripomočki za aplikacijo zdravil intravensko, intramuskularno in subkutano	večja	večja	večja	večja	večja
34.	pripomočki za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo za vse starostne skupine pacientov	večja	večja	večja	večja	večja

35.	pripomočki za vzpostavitev intraosalne poti za vse starostne skupine pacientov	1	1	1		
36.	pripomočki za vzpostavitev intravenske poti (IVK 14 G – 24 G)	večja	večja	večja	večja	večja
37.	pulzni oksimeter			1		1
38.	ročni aspirator z aspiracijskimi cevkami			1		1
39.	ročni merilec krvnega tlaka z manšetami različnih obsegov	1	1	1	1	1
40.	set za hipodermoklizo		1		1	
41.	set za nazogastrično sondo	(1)	(1)		1	
42.	set za nosno tamponado	2	2		2	
43.	set za podkožno vensko valvulo				1	
44.	set za porod	1	1			
45.	set za oskrbo novorojenčka	1	1			
46.	set za urinsko kateterizacijo	(1)	(1)		1	
47.	torba s prenosnim kisikom in pripomočki za aplikacijo kisika (lahko v sklopu zap. št. 18.)	1	1		1	
48.	torba z opremo in pripomočki za zdravstveno oskrbo otrok (lahko v sklopu zap. št. 18.)	1	1			

Dodatna obrazložitev:

- a. Količina opreme in pripomočkov je zapisana po kosih (kos);
- b. Pripomočki za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo:
 - laringoskop z lopaticami za odrasle in otroke
 - magillove prijemalke različnih velikosti
 - endotrahealni tubusi različnih velikosti
 - vodila za tubus različnih velikosti
 - vodilo za tubus z gibljivo konico (lahko zgolj v VUZ)
 - pripomoček za fiksacijo tubusa
 - dihalni baloni različnih velikosti
 - obrazne maske različnih velikosti
 - bakterijski filtri različnih velikosti
 - ustnožrelni tubusi različnih velikosti
 - supraglotični pripomočki različnih velikosti
 - set za konikotomijo (lahko zgolj v VUZ)
 - lidokain pršilo
 - skalpel

- c. Prenosni kisik vsebuje vsaj 2 litrsko kisikovo jeklenko z reducirnim ventilom in ventilom za uravnavanje pretoka kisika ter s pripadajočimi pripomočki za aplikacijo kisika;
- č. Pripomočki za aplikacijo kisika:
 - kisikova maska z rezervoarjem za odrasle
 - kisikova maska z rezervoarjem za otroke
 - venturi maska z nastavki za odrasle
 - venturi maska z nastavki za otroke
 - dvorogi nosni kateter za odrasle
 - dvorogi nosni kateter za otroke
 - inhalacijska maska za odrasle
 - inhalacijska maska za otroke
 - pripomoček za aplikacijo kisika preko trahealne kanile
- d. Moduli v monitorju/defibrilatorju:
 - meritve neinvazivnega krvnega tlaka z vsaj štirimi različnimi obsegi manšet (za dojenčke, mali/velik otrok, odrasli in večji odrasli)
 - meritve pulzne oksimetrije (SpO₂) s senzorji za vse starostne skupine pacientov
 - meritve pulzne karboksimetrije (SpCO) – v VUZ je dovoljen posebej pulzni karboksioksimeter (v VDZ ni potreben)
 - meritve valovne kapnografije (EtCO₂) s tubusnim in dvorogim nosnim senzorjem
 - snemanje 12-kanalnega EKG
 - izvedba sinhrona kardioverzije in zunanje elektrostimulacije srca
 - meritve kontinuirane temperature z ezofagealno/rektalno sondo (v VDZ ni potreben)
 - na zunanji strani monitorja/defibrilatorja je nameščen detektor ogljikovega monoksida (CO)
- e. Set za oskrbo novorojenčka vsebuje nabor pripomočkov po aktualnem dokumentu RC UK: *Minimum equipment for newborn resuscitation and the support of transition of infants at birth in the pre-hospital setting*;
- f. Kompleti za vodilne funkcije v primeru množičnih nesreč ustrezajo aktualnim Smernicam za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah (odsevni telovniki z oznakami vlog: Vodja intervencije NMP, Vodja primarne triaže, Koordinator prevozov in Vodja mesta zdravstvene obravnave po Prilogi 3 tega pravilnika);
- g. Balistično zaščitno opremo, set za urinsko kateterizacijo in set za nasogastrično sondo (1) lahko izvajalec službe NMP shranjuje v prostorih zavoda ter jo uporablja takrat, ko bodo ekipe posredovale na intervencijah, kjer bo potrebna tovrstna oprema;
- h. Izvajalec službe NMP ima znotraj mobilnih enot (MoE NRV, MoE VUZ) poenoteno medicinsko opremo, kot so monitor/defibrilator, ele. aspirator, prenosni ventilator, perfuzor, itd.;
- i. Medicinska oprema je ustrezno nameščena oziroma pritrjena v vozila. Medicinsko opremo in pripomočke se redno pregleduje, vzdržuje in servisira.

2. Seznam imobilizacijskih pripomočkov

ZAP. ŠT.	PRIPOMOČEK	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA
		MoE NRV ¹	MoE VUZ ²	MoE RM ³	MoE VDZ ⁴	RV ⁵
1.	enodelni pas s kovinsko zaponko	5				5
2.	komplet vakuumskih opornic	1				1
3.	oblazinjena aluminijasta opornica (tanko jedro iz aluminija, obdano z mehko peno)	3	3		3	3
4.	pas za imobilizacijo medenice na vzmet za odrasle in otroke (priporočena velikost L in S)	2	2	2		
5.	pripomoček za imobilizacijo dojenčkov	1				
6.	pripomoček za imobilizacijo malih otrok	1				
7.	pripomoček za imobilizacijo sedečega poškodovanca	1				
8.	trikotna ruta in ostali material za enkratno uporabo	večja	večja	večja	večja	večja
9.	univerzalna opora za glavo	1				1
10.	univerzalna vratna opornica za odrasle	2	1	1		2
11.	univerzalna vratna opornica za otroke	1	1	1		1
12.	zajemalna nosila	1				1

Dodatna obrazložitev:

- Količina pripomočkov je zapisana po kosih (kos);
- Imobilizacijske pripomočke se redno pregleduje, vzdržuje in servisira;
- Pripomoček za imobilizacijo dojenčkov in malih otrok je lahko univerzalen, če je na tržišču dobavljiv primeren univerzalen pripomoček.

3. Seznam infuzijskih raztopin

ZAP. ŠT.	RAZTOPINA	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA	OPOMBA
		MoE NRV ¹	MoE VUZ ²	MoE RM ³	MoE VDZ ⁴	RV ⁵	
1.	0,9 % NaCl 10 ali 20 ml	4	2	2	2		
2.	0,9 % NaCl 100 ml	2	1	1	1	1	
3.	0,9 % NaCl 500 ml	2	1	1	1	1	
4.	10 % glukoza 500 ml	1	1		1		500 ml ali manj
5.	5 % glukoza 100 ml	1	1		1		
6.	balansiran kristaloid 500 ml	2	2				
7.	Ringer raztopina 500 ml	2	1				

Dodatna obrazložitev:

- a. Količina raztopin je zapisana po kosih (kos);
- b. Infuzijske raztopine se smiselno razporedijo po vozilu oziroma reševalnem motorju (v predalih, nahrbtnikih ali torbah).

4. Seznam zdravil

ZAP. ŠT.	UČINKOVINA	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA	KOLIČINA	OPOMBA
		MoE NRV ¹	MoE VUZ ²	MoE RM ³	MoE VDZ ⁴	RV ⁵	
1.	acetilsalicilna kislina		500 mg				
2.	acetilsalicilna kislina	1000 mg	1000 mg		1000 mg		tableta
3.	adenozin	36 mg	36 mg		36 mg		
4.	adrenalin	10 mg	10 mg	3 mg	6 mg	10 mg	
5.	amidaron	450 mg	450 mg	450 mg	450 mg	450 mg	
6.	atropin	3 mg	3 mg		3 mg		
7.	bisoprolol ali paralela				10 mg		tableta
8.	bromazepam ali paralela				15 mg		tableta
9.	butilskopolamin		20 mg		20 mg		
10.	ceftriakson ali paralela		2000 mg		2000 mg		
11.	deksametazon	8 mg	8 mg		8 mg		
12.	diazepam	20 mg	20 mg	10 mg	20 mg		
13.	diazepam	15 mg	15 mg	15 mg	15 mg		rektiola
14.	diazepam		20 mg		20 mg		tableta
15.	diklofenak	25 mg	25 mg		25 mg		supozitorij
16.	dobutamin		250 mg				
17.	esketamin	200 mg	400 mg	200 mg			
18.	etomidat		40 mg				
19.	fenilefrin	10 mg	10 mg				
20.	fenoterol in ipratropijev bromid	20 ml	20 ml		20 ml		inhalacija
21.	fenoterol in ipratropijev bromid	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml		pršilnik
22.	fentanil		0,3 mg		0,3 mg		
23.	flumazenil	1 mg	1 mg	1 mg			
24.	furosemid	40 mg	40 mg		40 mg		
25.	glicerintrinitrat	13200 mg	13200 mg	13200 mg	13200 mg		pršilo
26.	glukagon	2 mg	2 mg	1 mg	2 mg	1 mg	
27.	glukoza (vsaj 40 %)	60 ml	60 ml	40 ml	60 ml	60 ml	
28.	haloperidol	10 mg	10 mg		10 mg		
29.	heparin		25.000 i.e.				
30.	hidrokortizon	200 mg	200 mg	200 mg	200 mg		
31.	humani insulin (hitro delujoči)		1000 i.e.		1000 i.e.		
32.	kalcijev glukonat ali paralela	30 ml	30 ml				

33.	kaptopril ali paralela	25 mg	25 mg		25 mg		tableta
34.	ketoprofen	100 mg	100 mg		100 mg		
35.	klemastin	4 mg	4 mg	4 mg	4 mg		
36.	levetiracetam	4500 mg	4500 mg				
37.	lidokain 2 %	10 ml	10 ml				
38.	loratadin ali paralela		20 mg		20 mg		tableta
39.	lorazepam		8 mg				
40.	magnezijev sulfat 25 %	20 ml	20 ml				
41.	metamizol	2500 mg	2500 mg	2500 mg	2500 mg	2500 mg	
42.	metilprednizolon	80 mg	80 mg	80 mg	80 mg		
43.	metilprednizolon		64 mg		64 mg		tableta
44.	metoklopramid	10 mg	10 mg		10 mg		
45.	metoksifluran 99,9 %	3 ml	3 ml	3 ml			inhalator
46.	esmolol ali paralela		500 mg				
47.	midazolam	50 mg	50 mg	50 mg	10 mg	10 mg	
48.	morfin		20 mg		20 mg		
49.	nalokson	2 mg	2 mg	2 mg	2 mg		
50.	noradrenalin		20 mg				
51.	oksitocin	10 i.e.	10 i.e.				
52.	ondansetron	4 mg	4 mg	4 mg	4 mg		
53.	pantoprazol ali paralela	80 mg	80 mg		80 mg		
54.	paracetamol	1000 mg	1000 mg	1000 mg	1000 mg	1000 mg	
55.	paracetamol	1000 mg	1000 mg		1000 mg		tableta
56.	paracetamol	1000 mg	1000 mg		1000 mg		supozitorij
57.	piritramid	30 mg	30 mg	15 mg	15 mg		
	propofol		1000 mg				
58.	rokuronijev bromid		200 mg				
59.	salbutamol	20 ml	20 ml		20 ml		inhalacija
60.	salbutamol	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml		pršilnik
	somatostatin ali paralela	3 mg	3 mg				
61.	suksametonij		200 mg				
62.	tietilperazin	6,5 mg	6,5 mg	6,5 mg	6,5 mg	6,5 mg	
63.	tiopental		1000 mg				
64.	tramadol	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg		
65.	traneksaminska kislina	1000 mg	1000 mg	1000 mg			
66.	urapidil ali paralela		25 mg				

Dodatna obrazložitev:

- Količina učinkovin/raztopin je zapisana v mg, ml, mednarodnih enotah ali kosih (kos);
- Če v opombah ni zapisano drugače, so zdravila namenjena za parenteralno uporabo;

- c. Pri določenih skupinah zdravil se lahko uporablja paralelna učinkovina (npr. pri zaviralcih adrenergičnih beta-receptorjev, zaviralcih protonske črpalke, kalcijevem glukonatu itd.);
- č. Priporočeno je, da se zdravila, določena za VUZ, umestijo v prenosni ampularij;
- d. Določena zdravila, zapisana v stolpcu VUZ, se lahko umestijo tudi ali zgolj v NRV, če izvajalec presodi, da je to zanj bolj praktično (npr. zdravila na perfuzor).

5. Seznam opreme, medicinskih pripomočkov in materiala v prikolici za množične nesreče

ZAP. ŠT.	OPREMA, PRIPOMOČKI IN MATERIAL	KOLIČINA	BARVA ZABOJNIKA	ŠT. ZABOJNIKA	OPOMBA
1.	univerzalna vratna opornica za odrasle poškodovance	10		1	
2.	univerzalna vratna opornica za pediatrične poškodovance	5		1	
3.	kisikova maska z rezervoarjem za odrasle	8		1	
4.	kisikova maska z rezervoarjem za otroke	6		1	
5.	laringoskop s pripadajočimi lopaticami in rezervnimi baterijami	2		1	
6.	set za razbremenilno punkcijo prsnega koša	4		1	
7.	komplet opeklinških oblog	4		1	
8.	opeklinske odeje	4		1	
9.	stetoskop	2		1	
10.	ročni merilec krvnega tlaka ali elektronski z rezervnimi baterijami	2		1	
11.	taktične škarje	5		1	
12.	nitrilne rokavice velikosti S, M in L	2		1	
13.	set ustnožrelnih tubusov	1		2	
14.	magillove prijemalke odrasle	3		2	
15.	magillove prijemalke otroške	2		2	
16.	bakterijski filter za dihalni balon/ventilator	5		2	
17.	vodila za tubus za ETT vel. 6,5 – 10	po 2		2	
18.	vodila za tubus za ETT vel. 2,5 – 4,0	po 1		2	
19.	vodila za tubus za ETT vel. 4,0 – 6,5	po 1		2	
20.	endotrahealni tubusi vel. 4,0 – 9,0	po 2		2	
21.	fiksater za tubus	7		2	
22.	i-gel vel. 1 – 5	po 2		2	
23.	set za konikotomijo	2		2	
24.	zaščitne obrazne maske tip IIR	50		2	
25.	zaščitna očala	10		2	
26.	povoj samooprijemljiv in elastičen	6		3	
27.	gaze cca 0,2 m ²	25		3	
28.	gaze cca 0,4 m ²	25		3	
29.	gaze cca 0,8 m ²	25		3	
30.	povoji širine 5 cm	35		3	
31.	povoji širine 10 cm	20		3	
32.	trikotne rute	10		3	
33.	mikropor širine 5 cm	5		3	
34.	mikropor širine 2,5 cm	5		3	
35.	vrečke za bruhanje	20		3	
36.	razkužilo za roke 500 ml	2		3	
37.	kombiniran dihalni balon z obraznimi maskami vel. 1, 3, 5	3		12	
38.	brizga 2 ml	30		12	
39.	brizga 5 ml	30		12	
40.	brizga 10 ml	30		12	
41.	brizga 20 ml	15		12	

42.	igle aspiracijske	50		12	
43.	igle za s.c. uporabo	30		12	
44.	igle za i.m. uporabo	30		12	
45.	eshmarchova preveza	10		12	
46.	alkoholni zloženci	200		12	
47.	kanile i.v. 14 G	30		12	
48.	kanile i.v. 18 G	50		12	
49.	kanile i.v. 22 G	30		12	
50.	fiksacijski obliž za i.v. kanile	100		12	
51.	aspirator na mehanski pogon	2		12	
52.	kontejner za ostre predmete	5		12	
53.	pripomoček za vzpostavitev intraosalne poti (kot NIO odrasli in otroški)	po 2		12	
54.	infuzijski sistemi	50		12	
55.	univerzalna vratna opornica za odrasle poškodovance	5		4	
56.	univerzalna vratna opornica za pediatrične poškodovance	3		4	
57.	kisikova maska z rezervoarjem za odrasle	5		4	
58.	kisikova maska z rezervoarjem za otroke	5		4	
59.	set ustnožrelnih tubusov	1		4	
60.	kombiniran dihalni balon z obraznimi maskami vel. 1, 3, 5	2		4	
61.	bakterijski filter za dihalni balon/ventilator	5		4	
62.	magillove prijemalke odrasle	1		4	
63.	magillove prijemalke otroške	1		4	
64.	vodilo za tubus za ETT vel. 6,5 – 10,0	po 1		4	
65.	endotrahealni tubusi vel. 4,0 – 9,0	po 2		4	
66.	laringoskop s pripadajočimi lopaticami in rezervnimi baterijami	1		4	
67.	fiksater za tubus	5		4	
68.	aspirator na mehanski pogon	1		4	
69.	set za razbremenilno punkcijo prsnega koša	2		4	
70.	brizga 2 ml	30		4	
71.	brizga 5 ml	30		4	
72.	brizga 10 ml	30		4	
73.	igle aspiracijske	50		4	
74.	Igla za s.c. uporabo	30		4	
75.	Igla za i.m. uporabo	30		4	
76.	kontejner za ostre predmete	4		4	
77.	povoj samooprijemljiv in elastičen	4		4	
78.	komplet opeklinskih oblog	1		4	
79.	taktične škarje	2		4	
80.	stetoskop	1		4	
81.	ročni merilec krvnega tlaka ali elektronski z rezervnimi baterijami	1		4	
82.	esmarchova preveza	6		5	
83.	alkoholni zloženci	200		5	
84.	kanile i.v. 14 G	20		5	
85.	kanile i.v. 18 G	20		5	
86.	kanile i.v. 20 G	20		5	
87.	kanile i.v. 22 G	20		5	

88.	fiksacijski obliž za i.v. kanile	100		5	
89.	Infuzijski sistemi	50		5	
90.	gaze cca 0,2 m ²	25		6	
91.	gaze cca 0,4 m ²	25		6	
92.	gaze cca 0,8 m ²	25		6	
93.	povoji širine cca 5 cm	15		6	
94.	povoji širine cca 10 cm	20		6	
95.	trikotne rute	10		6	
96.	mikropor širine 5 cm	5		6	
97.	mikropor 2,5 cm	5		6	
98.	nitrilne rokavice vel. S, M in L	2		6	
99.	vrečke za bruhanje	20		6	
100.	razkužilo za roke	1		6	
101.	univerzalna vratna opornica za odrasle poškodovance	5		7	
102.	univerzalna vratna opornica za pediatrične poškodovance	2		7	
103.	kisikova maska z rezervoarjem za odrasle	3		7	
104.	kisikova maska z rezervoarjem za otroke	3		7	
105.	brizga 2 ml	20		7	
106.	brizga 5 ml	20		7	
107.	brizga 10 ml	15		7	
108.	igle aspiracijske	20		7	
109.	igle za s.c. uporabo	10		7	
110.	igle za i.m. uporabo	20		7	
111.	esmarchova preveza	3		7	
112.	alkoholni zloženci	100		7	
113.	kanile i.v. 14 G	10		7	
114.	kanile i.v. 18 G	10		7	
115.	kanile i.v. 20 G	10		7	
116.	kanile i.v. 22 G	10		7	
117.	fiksacijski obliž za i.v. kanile	50		7	
118.	kontejner za ostre predmete	1		7	
119.	infuzijski sistemi	10		7	
120.	gaze cca 0,2 m ²	25		8	
121.	gaze cca 0,4 m ²	10		8	
122.	mikropor širine 5 cm	5		8	
123.	mikropor širine 2.5 cm	5		8	
124.	nitrilne rokavice vel. S, M in L	2		8	
125.	vrečke za bruhanje	10		8	
126.	razkužilo za roke	1		8	
127.	seznam opreme, pripomočkov in materiala	1		9	pisarniški
128.	seznam režim pregleda	1		9	pisarniški
129.	triažni kartoni	50		9	pisarniški
130.	dokumentacija koordinatorja prevozov	1		9	pisarniški
131.	dokumentacija vodje logistike	1		9	pisarniški
132.	dokumentacija vodje zdravstvene obravnave	1		9	pisarniški
133.	brezčrtni blok A4 in pisalo	1		9	pisarniški
134.	pisalna podloga A4	5		9	pisarniški
135.	odsevni telovniki z oznakami vlog (Vodja intervencije NMP, Vodja primarne triaže, Koordinator prevozov, Vodja mesta	po 1		9	pisarniški

	zdravstvene obravnave, Vodja RD, RU, ZE sektorja, Prometnik, itd.) po Prilogi 3 tega pravilnika				
136.	prenosna kisikova jeklenka 3 litre z reducirnim ventilom	9		11	kisik
137.	infuzijsko stojalo s priključkom na nosila	10		14	inf. stojala
138.	prenosna kisikova jeklenka 3 litre z reducirnim ventilom	1		14	inf. stojala

Dodatna obrazložitev:

- a. Količina opreme, pripomočkov in materiala je zapisana po kosih (kos);
- b. Skrbnik medicinske opreme, pripomočkov, materiala in zdravil v prikolici za množične nesreče (v nadaljevanju besedila: MN) je izvajalec službe NMP, ki ima z Ministrstvom za zdravje sklenjeno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec službe NMP – skrbnik prikolice za MN);
- c. Oprema v prikolici je nameščena v predalnikih oziroma aluminijastih zabojih;
- č. Ves drobn material se namesti v zaboje s količinsko ustrezno vsebino (minimalno število posameznih kosov je navedeno v seznamu, lahko pa je tudi več);
- d. Za prikolico mora izvajalec službe NMP – skrbnik prikolice za MN določiti skrbnika, ki redno pregleduje vsebino prikolice, skrbi za neoporečnost materiala in zagotavlja pravočasno zamenjavo potrošnega materiala;
- e. Da se izognemo neracionalnemu propadu materiala zaradi poteka roka trajanja, je potrebno pripraviti sezname opreme s predvidenim datumom pregleda in zamenjave materiala;
- f. Vsi izvajalci službe NMP morajo znotraj regij zagotavljati tudi ekipe, ki so seznanjene z vsebino prikolice ter usposobljene za njeno uporabo in ravnanje z njo;
- g. Izvajalec službe NMP – skrbnik prikolice za MN pripravi in uskladi protokol aktivacije ter uporabe prikolice. S protokolom so seznanjeni vsi izvajalci službe NMP znotraj regije.

6. Seznam zdravil in infuzijskih raztopin za potrebe množičnih nesreč

ZAP. ŠT.	UČINKOVINA	KOLIČINA	BARVA ZABOJNIKA	ŠT. ZABOJNIKA	OPOMBA
1.	0,9 % NaCl 10 ali 20 ml	20		17	
2.	0,9 % NaCl 100 ml	5		17	
3.	0,9 % NaCl 500 ml	20		17	
4.	adrenalin	6 mg		17	
5.	amiodaron	750 mg		17	
6.	atropin	20 mg		17	
7.	balansiran kristaloid	10		17	
8.	ceftriakson ali paralela	10000 mg		17	
9.	diazepam	50 mg		17	
10.	esketamin	1000 mg		17	
11.	etomidat	400 mg		17	
12.	fenilefrin	100 mg		17	
13.	fenoterol in ipratropijev bromid	20 ml		17	inhalacije
14.	fentanil	1 mg		17	
15.	flumazenil	2.5 mg		17	
16.	glicerintrinitrat	13200 mg		17	pršilo
17.	glukoza (vsaj 40 %)	100 ml		17	
18.	hidrokortizon	500 mg		17	
19.	klemastin	10 mg		17	
20.	lidokain 2 %	60 ml		17	
21.	metoksifluran 99,9 %	30 ml		17	inhalator
22.	midazolam	200 mg		17	
23.	morfin	200 mg		17	
24.	nalokson	4 mg		17	
25.	noradrenalin	50 mg		17	
26.	paracetamol	10000 mg		17	
27.	piritramid	150 mg		17	
28.	propofol	2000 mg		17	
29.	ringer raztopina	10			
30.	rokuronijev bromid	1000 mg		17	
31.	salbutamol	20 ml		17	inhalacije
32.	suksametonij	1000 mg		17	
33.	tietilperazin	130 mg		17	
34.	traneksaminska kislina	20000 mg		17	

Dodatna obrazložitev:

- a. Količina učinkovin/raztopin je zapisana v mg, ml ali kosih (kos);
- b. Če v opombah ni zapisano drugače, so zdravila namenjena za parenteralno uporabo;
- c. Vsa zdravila za uporabo v MN oziroma velike nesreče so zbrana v ustrezni prenosni torbi, primerno varovana (npr. v zaklenjeni omari) in se hranijo pri izvajalcu službe NMP – skrbniku priklovice za MN. V primeru MN oziroma velike nesreče se pripeljejo na kraj dogodka;
- č. Zaradi skrbnega gospodarjenja se zdravila pravočasno pred potekom roka uporabe zamenjajo za nova, obstoječa pa se uporabijo pri delu izvajalca službe NMP ali drugih izvajalcev.

7. Seznam opreme in medicinskih pripomočkov za izvajanje službe NMP v UC, SUC in DM

Legenda:

¹UC = urgentni center

²SUC = satelitski urgentni center

³DM = dežurno mesto

ZAP. ŠT.	MEDICINSKA OPREMA IN PRIPOMOČKI	UC ¹	SUC ²	DM ³	OPOMBA
1.	centralna nadzorna monitorska postaja	X	X		
2.	CT aparat	X			vsaj v sklopu bolnišnice
3.	EKG aparat	X	X	X	
4.	električni aspirator	X	X	X	
5.	fiksna radijska postaja	X	X		
6.	grelnik infuzijskih raztopin	X	X		prenosni ali stacionarni
7.	infuzijska črpalka	X	X		
8.	klinični laboratorij	X	(X)		
9.	mehanska naprava za izvajanje stisov prsnega koša	X	X		
10.	monitor/defibrilator	X	X	X	s sodobnimi moduli
11.	monitor za merjenje in nadzor vitalnih funkcij, ki omogoča vsaj: <ul style="list-style-type: none"> - spremljanje srčnega ritma, - meritve neinvazivnega krvnega tlaka, - meritve invazivnega krvnega tlaka (za UC), - meritve pulzne oksimetrije. 	X	X		klasični ali na prevoznem stojalu
12.	obposteljni laboratorij		X	X	
13.	perfuzor	X	X		
14.	pregledna luč	X	X	X	na kolesih
15.	prenosni ventilator	X	X		s sodobnimi moduli
16.	pulzni karboksioksimeter	X	X	X	s senzorji različnih velikosti
17.	RTG aparat	X	(X)		
18.	sistem za dovajanje kisika	X	X		
19.	transportna torba		X	X	z izolacijo za transport kužnin
20.	ultrazvok	X	X	X	prenosni ali na transportnem vozičku/kolesih
21.	videolaringoskop	X	X		s standardnim naborom lopatic
22.	voziček – dnevna postelja za opazovalnico	X	X		
23.	voziček – kirurško oskrbo	X	X		
24.	voziček – ležeči za pregled pacienta	X	X	X	
25.	voziček – sedeči	X	X	X	
26.	voziček – za nego pacientov	X	X		

27.	voziček – za pripomočke, material in zdravila	X	X		
28.	voziček – za reanimacijsko opremo, pripomočke in material	X	X	X	

Dodatna obrazložitev:

- a. Navedena oprema oziroma pripomočki ter z njimi povezana dejavnost so na razpolago 24 ur na dan, vse dni v letu. Za posamezne SUC pa je dostopnost preiskav kliničnega laboratorija in RTG diagnostike odvisna od obsega dela, ki bo določen v Uredbi – (X).
- b. Količina posamezne medicinske opreme in pripomočkov se prilagodi glede na potrebe posameznega izvajalca;
- c. Minimalen nabor obposteljnih preiskav za SUC:
 - analiza urina,
 - B-hCG,
 - brisi na respiratorne viruse in angino,
 - CRP,
 - d-dimer,
 - elektroliti (vsaj Na⁺, K⁺, Ca⁺, Cl⁺),
 - glukoza,
 - hemogram,
 - kreatinin,
 - laktat,
 - plinska analiza krvi,
 - test na okultno kri,
 - troponin.
- č. Minimalen nabor obposteljnih preiskav za DM:
 - analiza urina,
 - brisi na respiratorne viruse in angino,
 - CRP,
 - d-dimer,
 - glukoza,
 - test na okultno kri,
 - troponin.

Priloga 5: Oznake službe NMP in prevozov pacientov

1. Namen in področje uporabe

Priloga določa znake, ki se uporabljajo v sistemu nujne medicinske pomoči ter pri prevozih pacientov v Republiki Sloveniji. Opredeljuje grafične značilnosti, barvne standarde in pravila uporabe za znak NMP, znak klicne številke 112 in znak Prevoz pacientov.

Oznake se uporabljajo na vozilih, delovni in zaščitni obleki, opremi, dokumentih in drugih pripomočkih, povezanih z delovanjem službe NMP in organizirano službo prevozov pacientov. Priloga natančno opredeljuje tudi pogoje, pod katerimi je uporaba teh oznak dovoljena, in prepoveduje njihovo uporabo na osebnih vozilih ali v privatne namene brez soglasja ministrstva.

Oznake so del celostne podobe sistema NMP in prispevajo k prepoznavnosti, verodostojnosti in varnosti zdravstvenih ekip na terenu. Njihova uporaba je usklajena z določili tega pravilnika ter tehničnimi in oblikovnimi standardi, ki so določeni v tej prilogi.


Oznake NMP so znak Nujne medicinske pomoči, Klicna številka 112 in Prevoz pacientov. Oznake se lahko uporabljajo kot vezeni ali tkani našitki, nalepke, kovinske značke, plakete in spominske značke v različnih grafičnih izvedbah.

Prepovedana je uporaba znaka NMP in znaka klicne številke 112 na vozilih, opremi ali uniformah enot, ki izvajajo izključno nenujne in sanitetne reševalne prevoze ali izvajajo zdravstveno varstvo na prireditvah, prav tako se znaka ne sme uporabljati na osebnih vozilih fizičnih oseb ali v drugih privatnih primerih.

Znak Prevoz pacientov se lahko uporablja izključno na vozilih, opremi in uniformah v enotah, ki so vključene v službo za prevoz pacientov. Znak se lahko uporablja na vozilih, opremi ali uniformah enot, ki izvajajo nenujne reševalne prevoze in sanitetne prevoze. Znaka se ne sme uporabljati na osebnih vozilih fizičnih oseb ali v drugih privatnih primerih.

1.1 Znak Nujna medicinska pomoč Slovenija (NMP)

Vsi izvajalci vključeni v sistem NMP na svojih oblačilih, vozilih in opremi uporabljajo znak NMP Slovenije.



Znak NMP Slovenije je modra (RAL 5017) šest kraka zvezda življenja («star of life»), ki ima en krak vertikalni, drugi štiri pa so enakomerno razporejeni, dva na levi in dva na desni strani. Vsi kraki so enake širine in dolžine glede na središče zvezde. Na spodnjem delu vertikalnega modrega kraka je narisana bela igla, okoli katere je ovita bela kača. Modra zvezda je horizontalno razpočena v obliki Triglava tako, da razpočna linija sledi zgornjemu robu levega in desnega spodnjega kraka, ki ni vzporeden s spodnjim robom krakov, temveč je kot linij proti središču zvezde višji. Modra zvezda leži v belem polju, ki ga z vseh strani krakov zvezde enakomerno oddaljena omejuje rdeča krožnica (RAL 3024). V rdeči krožnici je napis zgoraj in spodaj, enakomerno razporejen levo in desno, glede na središčno vertikalno linijo. Uporabljajo se velike črke pisave »Arial« v beli barvi in so enakomerno oddaljene od notranjega in zunanjega roba krožnice. Zgoraj na krožnici je napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ, spodaj SLOVENIJA. Znaku ni dovoljeno spreminjati oblike in besedila napisa.

Barvna shema:




RAL 3024



RAL 5017

1.2 Znak Klicne številke 112

Znak Klicne številke 112 ima na levi strani grafiko telefona z odmevom, sledi napis 112 s pisavo Arial Black. Elementi si sledijo v enakem razmerju. Znak 112 je v reflektivni rdeči barvi RAL 3024 ali beli na zatemnjenem steklu.



Znak NMP in klicna številka 112 se lahko uporablja izključno na vozilih, opremi in uniformah v enotah, ki so vključene v službo nujne medicinske pomoči.

1.3 Znak Prevoz pacientov

Znak Prevoz pacientov je modra (RAL 5017) šest kraka zvezda življenja («star of life»), ki ima en krak vertikalni, drugi štirje pa so enakomerno razporejeni, dva na levi in dva na desni strani. Vsi kraki so enake širine in dolžine glede na središče zvezde. Na spodnjem delu vertikalnega modrega kraka je narisana bela igla, okoli katere je ovita bela kača. Modra zvezda je horizontalno razpočena v obliki Triglava tako, da razpočna linija sledi zgornjemu robu levega in desnega spodnjega kraka, ki ni vzporeden s spodnjim robom krakov, temveč je kot linij proti središču zvezde višji. Modra zvezda leži v belem polju, ki ga z vseh strani krakov zvezde enakomerno oddaljena omejuje prav tako modra krožnica. V rdeči krožnici je napis zgoraj in spodaj, enakomerno razporejen levo in desno, glede na središčno vertikalno linijo. Uporabljajo se velike črke pisave »Arial« v beli barvi in so enakomerno oddaljene od notranjega in zunanjega roba krožnice. Zgoraj na krožnici je napis PREVOZ PACIENTOV, spodaj SLOVENIJA. Znaku ni dovoljeno spreminjati oblike in besedila napisa.



Priloga 6: Vozila in standardna opremljenost vozil

1. Namen

Priloga določa vrste vozil, njihovo standardno opremljenost, grafično označevanje, tehnične značilnosti in zahteve glede uporabe vozil v službi nujne medicinske pomoči ter za izvajanje prevozov pacientov. Opredeljuje razvrstitev reševalnih in spremljevalnih vozil, posebna pravila za karoserijsko izvedbo, svetlobno in zvočno signalizacijo, ki omogočajo prepoznavnost in varnost na terenu.

Vozila so dodatno opremljena z medicinsko opremo, kot je to opredeljeno v Prilogi 4 tega pravilnika. Napisi namembnosti in označbe vozil so lahko izvedeni tudi s pomočjo magnetnih nalepk, kadar se vozila uporabljajo za druge namene.

Pri uporabi tega pravilnika je treba upoštevati najnovejše veljavne različice standardov, navedenih v besedilu.

Priloga vsebuje tudi določila glede največje dovoljene kilometrine in starosti vozil, ki se uporabljajo za izvajanje službe NMP ter prevozov pacientov, ter minimalne prostorske pogoje, ki jih zagotavljajo enote na svojih lokacijah.

1.1. Klasifikacija reševalnih vozil

Klasifikacija je po standardu SIST EN 1789 in v skladu s pravilnikom, ki ureja dele in opremo vozil.

1.1.2 Reševalna vozila po SIST EN 1789

Reševalno vozilo tipa A - vozilo za prevoz pacientov

Vozilo, zasnovano in opremljeno za prevoz pacientov, pri katerih se ne pričakuje, da bodo postali nujni pacienti.

Opomba 1 k terminu: Obstajata dve vrsti reševalnih vozil za prevoz pacientov:

— tip A1: primerno za prevoz enega pacienta,

— tip A2: primerno za prevoz enega ali več pacientov (na nosilih in/ali sedežih).

Reševalno vozilo tipa B - nujno reševalno vozilo za osnovno zdravljenje

Vozilo, zasnovano in opremljeno za prevoz, osnovno zdravljenje in spremljanje pacientov.

Reševalno vozilo tipa C - nujno reševalno vozilo za napredno zdravljenje

Vozilo, zasnovano in opremljeno za prevoz, napredno zdravljenje in spremljanje pacientov.

1.1.3 Vozilo urgentnega zdravnika

Vozilo, zasnovano in opremljeno za hitro oskrbo pacienta.

1.1.4 Vozilo dežurnega zdravnika

Vozilo, zasnovano in opremljeno za osnovno zdravljenje pacientov.

1.1.5 Reševalni motor

Motorno kolo, zasnovano za hitro posredovanje, opremljeno za začetno oskrbo pacientov.

1.1.6 Helikopter

Zrakoplov na motorni pogon, težji od zraka, ki dobi med letom vzgon v zraku predvsem zaradi reakcije zraka na največ dva rotorja, ki ju poganja motor, na pretežno navpičnih oseh, dodatno opremljeno za prevoz, napredno zdravljenje in spremljanje pacientov.

1.2. Karoserija vozila

Karoserija in sprednji odbijač vozil za izvajanje službe NMP sta v rumeni barvi RAL 1016. Zadnji odbijač, bočni zaščitni elementi, ogledala in ostali plastični deli so lahko v barvi osnovne izvedbe (črna). Vozilo v osnovni barvi se polepi s folijo rumene barve RAL 1016 (skladno s SIST EN 1789).

Na robovih notranjega dela vrat (vsaj stranski in spodnji del) je retroreflektivna folija v rdeči barvi, ki omogoča večjo vidljivost odprtih vrat.

Vsi snemljivi deli reševalnega motorja (stranske zaščitne obloge, sprednji blatnik, zunanja zaščitna obloga stranskih kovčkov in zunanja obloga centralnega kovčka) so v rumeni barvi RAL 1016.

1.3. Oznake vozila

Zunanje oznake se izvede z mikroprizmatično retroreflektivno odsevno folijo v skladu z regulacijo ECE104 (Class C), ki definira odsevnost. Retrorefleksni elementi učinkovito vračajo svetlobo pod različnimi koti. Barve zunanjih oznak so tovarniške, tisk na osnovno barvo ni dovoljen, saj zmanjša odsevnost. Ker so barve zunanjih oznak tovarniške, ni mogoče zagotoviti popolnega ujemanja z RAL lestvico, vendar se uporablja tovarniške barvne odtenke, ki so čim bližje omenjeni specifikaciji.

Na vseh površinah se uporablja zelena in rumeno-zelena barva, razen na zadnjem delu vozila se uporablja rdeča in rumeno-zelena barva (SIST EN 1789).

Zelena barva čim bližje RAL 6026, kot je Avery Dennison Visiflex V-8007 Green (zelena) ter Orafol Oralite VC 612 #027 Green (zelena).

Rumeno-zelena barva, kot je Avery Dennison Visiflex V-8013 Fluorescent Yellow-Green (fluorescentna rumeno-zelena).

Rdeča barva čim bližje RAL 3024, kot je Avery Dennison Visiflex V-8008 Red (rdeča) ter Orafol Oralite VC 612 #012 Red (rdeča).

Napisi so s pisavo Arial Black reflektivne rdeče barve RAL 3024; če so na zatemnjenem steklu, so v beli reflektivni barvi. Prav tako so napis urgencia, logotip klicne številke 112 in enoznačna koda vozila v reflektivni rdeči barvi RAL 3024.

Vsa intervencijska vozila za izvajanje nujne medicinske pomoči imajo na levem in desnem boku pod kljukami vrat Battenburgovo oznako (7 stolpcev, 2 vrstici blokov enakih dimenzij - celotna višina med 50 in 60 cm, do višine sredine kljuke), v izmenjujoči zeleni in rumeno-zeleni barvi, ki poveča vidnost vozila podnevi in ponoči. Logotip enote ali zavoda na sredini sprednjih vrat, kjer je tudi presečišče štirih Battenburgovih oznak.

Vzorec ribje kosti (chevron) se uporablja na bokih, spredaj in zadaj. Širina trakov vzorca ribje kosti 10 cm pod kotom 45 stopinj. Sprednji del vzorca ribje kosti na pokrovu motorja (od maske proti vetrobranskemu steklu) višine 14 cm, nato se širina prilagodi linijam pokrova.

Na strehi vozila je logotip NMP, na zadnjem delu enoznačna koda vozila, ki jo določi dispečerska služba zdravstva.

Slovenska zastava je na vseh straneh vozila, razen spredaj. Velikost zastave je 7 cm x 10 cm. Grb zastave je vedno v smeri vožnje.

Vozila za prevoz pacientov nimajo predpisane grafične podobe razen elementov, ki so opisani spodaj. Napisi so RAL 5017.

Vozila za izvajanje NMP:


Skice vozil, ki so uporabljene v tej prilogi, prikazujejo primere grafične podobe vozil.

1.4. Vozilo urgentnega zdravnika (VUZ)


Vozilo urgentnega zdravnika je namenjeno za hiter prihod zdravnika in reševalca na kraj dogodka ter za izvajanje naprednih ukrepov nujne medicinske pomoči na terenu. Vozilo ni opredeljeno v klasifikaciji tipov vozil po standardu SIST EN 1789, vendar mora po konstrukcijskih, varnostnih in tehničnih zahtevah izpolnjevati vse pogoje, ki veljajo za vozilo za posebne namene (M1G ali M1/SG).

Medicinska in tehnična oprema v vozilu VUZ dopolnjuje opremo nujnega reševalnega vozila (NRV), s katerim se vozilo pri intervencijah I. prioritete aktivira hkrati in deluje kot skupna enota tipa C po standardu SIST EN 1789.

Vozilo izpolnjuje pogoje za terensko osebno vozilo ali osebno vozilo z obliko nadgradnje AC – karavan s stalnim ali priklopljivim štirokolesnim pogonom (M1G ali M1) in avtomatskim menjalnikom. Vozilo dobi obliko nadgradnje »SG – vozilo za posebne namene« in dodatni opis »NMP-urgentni zdravnik«. V vozilu je nameščena oprema definirana v tej in Prilogi 4 tega pravilnika. Vozilo je opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo po točki 2.3 te priloge.



a.



b.

1.4.1.	bočno	<p>enoznačna koda vozila in slovenska zastava na zgornjem delu sprednjega blatnika</p> <p>napis imena zavoda ali enote med steklom in kljuko sprednjih vrat</p> <p>napis URGENTNI ZDRAVNIK med steklom in kljuko zadnjih vrat</p> <p>logotip NMP (premer: 15-20 cm) na steklu za C stebričkom</p> <p>logotip klicne številke 112 pod steklom za C stebričkom</p> <p>Battenburgova oznaka po opisu v točki 1.3 te priloge</p> <p>logotip enote ali zavoda na sredini sprednjih vrat v presečišču štirih Battenburgovih oznak (premer 40 % skupne višine Battenburgovih oznak)</p> <p>napisi in logotip 112 so visoki od 6-8 cm</p>
1.4.2.	spredaj	<p>vzorec ribje kosti na odbijaču, pokrovu motorja (sprednji del vzorca ribje kosti višine 20 cm od zgornjega roba maske, nato se prilagodi linijam pokrova - v vertikalni liniji sredine kolesa širina vzorca vsaj 12-30 cm)</p> <p>zrcalni napis URGENCA (višina črk: 10 cm - širina: 70 cm) in logotip klicne številke 112 (višina znaka: 10 cm, širina: 32 cm) na pokrovu motorja</p>
1.4.3.	zadaj	<p>vzorec ribje kosti na karoseriji prtljažnika in blatnika</p> <p>enoznačna koda vozila na levem delu in slovenska zastava na desnem delu spodnjega dela stekla prtljažnika</p> <p>višina napisov od 3-7 cm</p> <p>izvlečna platforma ima reflektivne oznake</p>
1.4.4.	streha	<p>na sprednjem in zadnjem delu karoserije strehe pas vzorca ribje kosti (15 cm)</p> <p>logotip NMP (premer 30-50 cm) čim bližje sredini strehe vozila</p> <p>enoznačna koda vozila (višina napisa 15 cm) na zadnjem delu strehe</p>
1.4.5.	svetlobna	<p>bočno: vsaj ena v višini napisov nad sprednjo pnevmatiko in vsaj</p>

	signalizacija	ena nad zadnjo pnevmatiko spredaj: vsaj dve (priporočljivo štiri) v maski vozila od teh polovica blitz belih luči; ena na vsaki strani na ohišju obeh ogledal zadaj: na spodnjem delu vozila odprt prtljažnik: utripajoča opozorilna luč oranžne barve streha: blok strešne opozorilne signalizacije, viden iz vseh strani (3 enote modrih opozorilnih luči, 1 enota belih blitz) streha delovne luči: na vsaki strani strehe bočno vsaj ena delovna luč, v kolikor je samo ena, mora biti pozicionirana na sredini vozila, moč delovne luči mora biti minimalno 1870 lumnov.
--	---------------	---

1.5. Vozilo dežurnega zdravnika (VDZ)

VDZ je namenjen za prevoz zdravnika in reševalca v dežurni službi. Izpolnjuje pogoje za terensko osebno vozilo ali osebno vozilo z obliko nadgradnje AC – karavan s stalnim ali priklopljivim štirikolesnim pogonom (M1G ali M1). Vozilo dobi obliko nadgradnje »SG – vozilo za posebne namene« in dodatni opis »NMP-dežurni zdravnik«. V vozilu je nameščena oprema, določena v tej in Prilogi 4 tega pravilnika. Vozilo je opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo po točki 2.3 te priloge.

Vozilo dežurnega zdravnika je enak opisu točke 1.4 te priloge, razen:

- zrcalni napis DEŽURNI ZDRAVNIK (minimalna višina črk 10 cm) na pokrovu motorja
- napis DEŽURNI ZDRAVNIK med steklom in kljuko zadnjih vrat
- napis DEŽURNI ZDRAVNIK na sredini spodnjega dela stekla prtljažnika

1.6. Nujno reševalno vozilo (NRV)

Nujno reševalno vozilo je namenjen za izvajanje službe NMP in nujne prevoze pacientov. Po konstrukcijskih in varnostnih zahtevah v celoti ustreza standardu SIST EN 1789 tip C. Zaradi načina organizacije sistema NMP v Republiki Sloveniji se del medicinske opreme, ki je predviden v vozilu tipa C, nahaja v vozilu urgentnega zdravnika (VUZ), s katerim se NRV pri intervencijah I. prioritete aktivira hkrati in deluje kot skupna enota.

Vozilo izpolnjuje pogoje za osebni avtomobil s stalnim ali priklopljivim štirokolesnim pogonom (kategorija vozila M1 ali M1G). Vozilo dobi obliko nadgradnje »SC – reševalno vozilo« in dodatni opis »NMP - nujno reševalno vozilo«. V vozilu je nameščena oprema določena v tej in Prilogi 4 tega pravilnika. Vozilo je opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo po točki 2.3 te priloge.



1.6.1.	bočno	<p>enoznačna koda vozila in slovenska zastava na zgornjem delu sprednjega blatnika</p> <p>napis imena zavoda ali enote med steklom in kljuko sprednjih vrat</p> <p>napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ v višini imena enote/zavoda na zadnjem delu vozila (višina napisa: 12-13 cm)</p> <p>logotip klicne številke 112 na karoseriji ali steklu zadnjih drsnih vrat na obeh straneh vozila (višina znaka: 25 cm)</p> <p>logotip NMP na karoseriji ali steklu zadnjega dela vozila v višini logotipa klicne številke 112 (premer znaka: 47 cm)</p> <p>vzorec ribje kosti na zgornjem delu vozila po celi dolžini v višini 15 centimetrov oziroma glede na obliko vozila</p> <p>Battenburgova oznaka po opisu v točki 1.3 te priloge</p> <p>logotip enote ali zavoda na sredini sprednjih vrat v presečišču štirih Battenburgovih oznak (premer 40 % skupne višine Battenburgovih oznak)</p>
--------	-------	---

		v primeru izvlečne stopnice je ta označena z retroreflektivno folijo
1.6.2.	spredaj	vzorec ribje kosti na pokrovu motorja (sprednji del vzorca ribje kosti višine 20 centimetrov od zgornjega roba maske, nato se prilagodi linijam pokrova (v vertikalni liniji sredine kolesa širina vzorca vsaj 12-30 cm) zrcalni napis URGENCA (višina črk 10 cm) in logotip klicne številke 112 na pokrovu motorja (višina 10 cm) svetlobni napis URGENCA in enoznačna koda vozila nad vetrobranskim steklom
1.6.3.	zadaj	vzorec ribje kosti nad steklom zadnjih vrat logotip NMP (premer znaka: 47 cm) na sredini stekla/karoserije in enoznačna koda vozila (višina: 6 cm) v levem spodnjem delu stekla/karoserije levih vrat logotip klicne številke 112 (višina znaka: 25 cm) na sredini stekla/karoserije ter slovenska zastava (dimenzija 6 x 12 cm) v desnem spodnjem delu stekla/karoserije desnih vrat vzorec ribje kosti na karoseriji pod steklom obeh vrat <i>v primeru dvižnih zadnjih vrat zgornji opis velja za levo in desno polovico enojnih vrat</i>
1.6.4.	streha	na sprednjem in zadnjem delu karoserije strehe pas vzorca ribje kosti (višina: 15 cm) logotip NMP čim bližje sredini strehe vozila (vsaj 47 cm) enoznačna koda vozila na zadnjem delu strehe
1.6.5.	svetlobna signalizacija	bočno: vsaj ena posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo modre barve v višini napisov nad sprednjo pnevmatiko in vsaj ena posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo modre barve na zadnjem delu vozila v višini napisov spredaj: vsaj dve posebni opozorilni svetilki, ki oddajata svetlobo modre barve v maski vozila ter vsaj dve posebni opozorilni svetilki, ki oddajata svetlobo bele barve v maski vozila; ena posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo modre barve na vsaki strani v ogledalu zadaj: na višini med 100 cm in 140 cm vsaj dve modri posebni opozorilni svetilki, ki oddajata svetlobo modre barve odprt prtlačnik: posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo oranžne barve, ob prižganih posebnih opozorilnih svetilkah, ki oddajajo svetlobo modre barve lahko tudi s svetlobo modre barve, če zadnja vrata prekrijejo strešni blok streha: Integrirane posebne opozorilne svetilke, ki oddajo svetlobo modre barve, vidne z vseh strani. V vsakem kotu strehe reševalnega vozila minimalno 1 modul z vsaj 10 posebnimi opozorilnimi svetilkami, ki oddajajo svetlobo modre barve, postavljene pod kotom 45 stopinj streha sprednji del: osvetljen napis URGENCA, 4 bele posebne opozorilne svetilke, ki oddajajo svetlobo bele barve streha delovni žarometi: na vsaki strani strehe bočno vsaj en delovni žaromet, v kolikor je samo en, mora biti pozicioniran na sredini vozila, moč delovnega žarometa mora biti minimalno 1870 lumnov. Na zadnjem delu vozila delovni žaromet, ki služi tudi kot dodatni žaromet za vzvratno vožnjo.

1.7. Reševalni motor (RM)

Motorno kolo je specialno vozilo, namenjeno reševalcu motoristu in je prilagojeno za izvajanje nujne medicinske pomoči (L3e ali L5e). Vozilo dobi obliko nadgradnje »SG – vozilo za posebne namene« in dodatni opis »NMP-reševalni motor« Pri predelavi so upoštevana vsa navodila proizvajalca motornega kolesa z vidika varnosti vožnje in ohranitve garancije. V kovčkih motornega kolesa je nameščena naslednja medicinska oprema iz Priloge 4 tega pravilnika. Vozilo je opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo po točki 2.3 te priloge.


1.7.1.	bočno	enoznačna koda vozila in slovenska zastava na zgornjem delu stranske zaščitne obloge napis imena zavoda ali enote na zgornjem delu stranske zaščitne obloge napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ na zunanji strani stranskih kovčkov logotip klicne številke 112 na zunanji strani stranskih kovčkov logotip NMP na centralnem kovčku na zunanji strani na obeh straneh Battenburgova oznaka po opisu v točki 1.3 te priloge: na obeh zunanjih straneh zaščitnih oblog in stranskih kovčkov po celotni dolžini motornega kolesa
1.7.2.	spredaj	polovica vetrobranskega stekla naj bo polepljena v rumeni barvi RAL 1016 na spodnjem polepljenem delu vetrobranskega zaščitnega stekla napis URGENCA in logotip NMP na sprednji maski na obeh straneh pod nivojem ročk krmila vzorec ribje kosti na spodnjem delu motorja
1.7.3.	zadaj	vzorec ribje kosti na zadnji strani centralnega kovčka
1.7.4.	svetlobna signalizacija	spredaj: vsaj dve posebni opozorilni svetilki, ki oddajata svetlobo modre barve, ki zagotovita vidnost od spredaj in vsaj dve posebni opozorilni svetilki, ki oddajata svetlobo modre barve, ki zagotavljata vidnost s strani, spredaj v sredini vsaj ena posebna opozorilna svetilka, ki oddajata svetlobo modre barve zadaj: posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo modre barve na teleskopski palici ali na kovčku in za sedežem na obeh straneh

Vozila za prevoz pacientov:

1.8. Vozilo za nenujne reševalne prevoze (RV)

Nenujno reševalno vozilo je namenjeno za prevoz pacientov, ki med prevozom potrebujejo spremstvo ali osnovno zdravstveno obravnavo zdravstvenega delavca, vendar niso življenjsko ogroženi. Po konstrukcijskih in varnostnih zahtevah ustreza standardu SIST EN 1789 tip B.

Vozilo izpolnjuje pogoje za osebni avtomobil z obliko nadgradnje »AC – karavan« s stalnim ali priklopljivim štirikolesnim pogonom (kategorija vozila M1 ali M1G). Vozilo dobi obliko nadgradnje »SC – reševalno vozilo« in dodatni opis »NMP - nenujno reševalno vozilo«. V vozilu je nameščena oprema, določena v tej in Prilogi 4 tega pravilnika. Vozilo je opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo po točki 2.3 te priloge.



1.8.1.	bočno	Koda vozila in slovenska zastava na zgornjem delu sprednjega blatnika napis imena zavoda ali enote med steklom in kljuko sprednjih vrat napis PREVOZ PACIENTOV v višini imena enote/zavoda na zadnjem delu vozila telefonska številka enote/zavoda/podjetja na karoseriji ali steklu zadnjih drsnih vrat na obeh straneh vozila logotip PREVOZ PACIENTOV na karoseriji ali steklu zadnjega dela vozila v višini telefonske številke enote/zavoda/podjetja logotip enote/zavoda/podjetja na sredini sprednjih vrat
1.8.2.	spredaj	napis PREVOZ PACIENTOV (minimalna višina črk 10 cm) na pokrovu motorja
1.8.3.	zadaj	vzorec ribje kosti nad steklom zadnjih vrat logotip PREVOZ PACIENTOV (premer znaka: 47 cm) na sredini stekla/karoserije in koda vozila (višina: 6 cm) v levem spodnjem delu stekla/karoserije levih vrat Ime enote/zavoda in telefonska številka na sredini stekla/karoserije ter slovenska zastava (dimenzija 6 x 12 cm) v desnem spodnjem delu stekla/karoserije desnih vrat vzorec ribje kosti na karoseriji pod steklom obeh vrat


		<i>v primeru dvižnih zadnjih vrat zgornji opis velja za levo in desno polovico enojnih vrat</i>
1.8.4.	streha	logotip PREVOZ PACIENTOV čim bližje sredini strehe vozila
1.8.5.	svetlobna signalizacija	svetlobna signalizacija na strehi na vse strani vozila spredaj: vsaj dve posebni opozorilni svetilki, ki oddajata svetlobo modre barve v maski odprt prtijažnik: posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo oranžne barve, streha: blok strešne opozorilne signalizacije, ki vsebuje posebne opozorilne svetilke, ki oddajajo svetlobo modre barve, viden iz vseh strani

1.9. Sanitetno vozilo

Sanitetno vozilo je namenjeno za prevoz pacientov, ki med prevozom ne potrebujejo spremstva ali zdravstvene obravnave zdravstvenega delavca, prevoz z javnim prevoznim sredstvom pa bi lahko bil za njihovo zdravje škodljiv.

Po konstrukcijskih in varnostnih zahtevah ustreza standardu SIST EN 1789 tip A. Vozilo je zasnovano za izvajanje sanitetnih prevozov pacientov v sedečem ali ležečem položaju ter mora biti prilagojeno varnemu vstopu, izstopu in pritrditvi nosil ali sedežev.

Vozilo izpolnjuje pogoje za osebni avtomobil (kategorija vozila M1, z eno od oblik nadgradnje: »AA – limuzina«, »AB – vozilo z dvižnimi vrati zadaj«, »AC – karavan«, »AF – večnamensko vozilo«). Vozilo dobi obliko nadgradnje »SG – vozilo za posebne namene« in dodatni opis »NMP - sanitetno vozilo« V vozilu je nameščena oprema, določena v tej prilogi in Prilogi 4 tega pravilnika. Vozilo je opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo po točki 2.3 te priloge.



1.9.1.	bočno	Koda vozila in slovenska zastava na zgornjem delu sprednjega blatnika napis imena zavoda ali enote med steklom in kljuko sprednjih vrat napis PREVOZ PACIENTOV v višini imena enote/zavoda na zadnjem delu vozila telefonska številka enote/zavoda/podjetja na karoseriji ali steklu zadnjih vrat na obeh straneh vozila logotip PREVOZ PACIENTOV na karoseriji ali steklu zadnjega dela vozila v višini telefonske številke enote/zavoda/podjetja logotip enote/zavoda/podjetja na sredini sprednjih vrat
1.9.2.	spredaj	napis PREVOZ PACIENTOV (minimalna višina črk 10 cm) na pokrovu motorja
1.9.3.	zadaj	vzorec ribje kosti na spodnjem delu karoserije prtljažnika napis PREVOZ PACIENTOV na zadnjih vratih telefonska številka na zadnjih vratih
1.9.4.	streha	logotip PREVOZ PACIENTOV čim bližje sredini strehe vozila
1.9.5.	svetlobna signalizacija	avtomobil naprav za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih signalov ne sme imeti

2.1. Svetlobna signalizacija

Posebne opozorilne svetilke na reševalnih vozilih so homologirane v skladu s pravnim aktom EU, ki ureja homologacijo posebnih opozorilnih svetilk za motorna vozila in njihove priklopnike

Zahteve za posebne opozorilne svetilke na reševalnih vozilih:

- Zagotavljajo dobro vidljivost podnevi in ponoči
- Trije načini svetlobne signalizacije:
 - Dnevni (100 % svetilnosti posebnih opozorilnih svetilk, ki oddajajo svetlobo modre in bele barve)
 - Nočni (70 % svetilnosti le posebnih opozorilnih svetilk, ki oddajajo svetlobo modre barve)
 - Megla (70 % svetilnosti le posebnih opozorilnih svetilk, nameščenih nad vetrobranskim steklom in ki oddajajo svetlobo modre barve)
- Vidnost 360° okoli vozila
- Navpični vidni kot omogoča vidljivost z različnih višin
- Barve svetlobe posebnih opozorilnih svetilk
 - modra in bela za nujne intervencije
 - rumena za opozorila
- Odpornost na udarce, tresljaje in vplive okolja (voda, prah, UV-svetloba)
- Opozorilne svetilke so nameščene tako, da ne ovirajo delovanja drugih komponent vozila in so zaščitene pred poškodbami
- Električni sistem je skladen z napajalnimi specifikacijami vozila (običajno 12V ali 24V)

Lokacije namestitev svetlobne signalizacije so specificirane v tabelah specifikacije vozil.

Svetlobna signalizacija na bočnih in zadnjih straneh vozil v dveh nivojih:

- spodnji nivo (med 100 cm in 140 cm)
- zgornji nivo (streha vozila)

Svetlobna signalizacija na sprednji strani na treh nivojih:

- spodnji nivo (maska vozila)
- srednji nivo (ogledala vozila)
- zgornji nivo (streha vozila)

Krmilna enota ima osvetljena in označena stikala za vklop posamezne funkcije. Z vklopom tona sirene se avtomatsko vključijo vse posebne opozorilne svetilke na vozilu.

2.2. Zvočna signalizacija

Zvočna signalizacija reševalnih vozil je homologirana v skladu s pravnim aktom EU, ki ureja homologacijo zvočnih signalnih naprav in motornih vozil glede na dajanje zvočnih signalov.

Vsa vozila, razen sanitetnega vozila, so opremljena z zvočno signalizacijo, nameščeno na sprednjem delu vozila. Zvočnik je nameščen za masko vozila ali na drugem mest prednjem delu, ki zagotavlja optimalno jakost zvoka naprej, brez večjih ovir med zvočnikom in okolico. Oblika zvočnika je prilagojena mestu montaže glede na tip vozila. Namestitev zvočne signalizacije na streho vozila ni dovoljena.

Jakost zvočne elektronske signalizacije je med 110 dB in 118 dB (merjeno po krivulji C) na razdalji 1 metra. Minimalna moč zvočnika je 100 W. Reševalni motor ima dva zvočnika z močjo najmanj 30 W vsak. Moč sirenskega ojačevalnika je prilagojena zvočniku, da zagotavlja optimalno delovanje. V skladu s pravilnikom, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu, jakost zvoka v notranjosti vozila pri hitrosti 120 km/h ne sme presegati 77 dB. Dovoljena je uporaba zračnih siren, čeprav ti sistemi ne izpolnjujejo vseh zahtev v skladu s pravnim aktom EU, ki ureja homologacijo zvočnih signalnih naprav in motornih vozil glede na dajanje zvočnih signalov .

Sirena omogoča najmanj dva različna tona (počasni in hitro zavijajoči), ki se aktivirata s pritiskom na volan. *Opcijski sistem zračna sirena, kot je Martin Horn ali enakovredno, se aktivira s stopalko na levi strani zavornega pedala.*

Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter dodatna električna napeljava je izvedena strokovno, v skladu s pravnim aktom EU, ki ureja homologacijo vozil glede na elektromagnetno združljivost.

2.3. Informacijska in telekomunikacijska oprema izvajalcev NMP in prevozov pacientov

2.3.1. Oprema v vozilih:

- Mobilna radijska postaja DMR, kot je Motorola DM 4601e z mikrofonom s tipkovnico ali enakovredno s programiranimi vsemi predpisanimi kanali in omogočeno šifriranje podatkov (seznam dosegljiv uradnemu serviserju aparata pri DSZ). Mobilna postaja je vgrajena v reševalno vozilo in priklopljena na anteno, nameščeno na zunanji strani vozila. Antena je resonančna na 150 MHz.
- Namenski nosilec za ročno radijsko postajo prostoru za zdravljenje.
- Oddajnik za spremljanje lokacije vozila - Global positioning system (v nadaljnjem besedilu: GPS), hitrosti vožnje, teka motorja in uporabe opozorilne intervencijske signalizacije (vozila za prevoz pacientov ne potrebujejo oddajanja uporabe opozorilne intervencijske signalizacije).
- Antena na strehi vozila ojača signal VHF, GPS ter mobilnih podatkov, če ima vozilo router.
- Tablični računalnik v vozilu ali enakovredno s programom za prikaz podatkov
 - Navigacijska naprava, povezana z informacijsko rešitvijo, s samodejnim zajemom začetne lokacije, ki jo v reševalno vozilo posreduje DSZ.
- Tiskalnik (opcijsko).

Uporabljene informacijske rešitve zagotavljajo, da se podatki do DSZ prenašajo v realnem času oziroma z maksimalnim zamikom deset sekund. Zagotovljeno je njihovo delovanje v 99,5 %.

Naštete zahteve ne veljajo za enote HNMP v prehodnem obdobju, ki traja do nabave ali angažiranja namenskih helikopterjev za izvajanje HNMP. V vmesnem obdobju se za komuniciranje in prenos podatkov uporabljajo obstoječe tehnične rešitve. Namenski helikopterji za izvajanje HNMP izpolnjujejo naštete zahteve.

2.3.2. Oprema ekip:

- Ročna radijska postaja DMR, kot je Motorola R7 ali enakovredno s programiranimi vsemi predpisanimi kanali in omogočeno šifriranje podatkov (seznam dosegljiv uradnemu serviserju aparata pri DSZ),
- Mobilni telefon z zaščito pred vodo in prahom IP68.

Uporabniki morajo imeti ročne radijske postaje in mobilne telefone vedno pri sebi, ne glede na to kje se nahaja. Ročna in mobilna radijska postaja mora biti vedno na ustreznem kanalu in nastavljena na ustrezno glasnost. Zaradi zagotavljanja redundance in neprekinjene dosegljivosti mora biti vsak od obeh mobilnih telefonov priklučen na omrežje drugega operaterja javnih komunikacij.

2.3.3. Sprejemno mesto UC oziroma SUC ima:

- Fiksno radijsko postajo DMR, kot je Motorola DM 4600e z mikrofonom s tipkovnico ali enakovredno s programiranimi vsemi predpisanimi kanali in omogočeno šifriranje podatkov (seznam dosegljiv s strani DSZ uradnemu serviserju aparata). Fiksna radijska postaja je priklopljena na anteno, nameščeno na ustreznem zunanjem mestu, npr. na strehi stavbe. Antena je širokopasovna za območje VHF (*velja tudi za urgentne ambulante, ki niso organizirane v okviru UC*),

- Računalnik oziroma dodaten zaslon za spremljanje prihajajočih pacientov (*velja tudi za urgentne ambulante, ki niso organizirane v okviru UC*),
- Računalnik in oprema za oddaljeno monitoriranje pacientov,
- Monitor za spremljanje vitalnih funkcij z možnostjo povezljivosti v splet (kot opisan v zgornji točki),
- Digitaliziran POCT.

Izvajalci prevozov pacientov, ki se vključujejo v sistem NMP, imajo vsaj eno mobilno ali ročno radijsko postajo DMR, mobilni telefon ter oddajnik za spremljanje lokacije vozila GPS, hitrosti vožnje, teka motorja in uporabe opozorilne signalizacije.

2.4 Dimenzije pacientovega prostora

Dimenzije se nanašajo na pacientov prostor z notranjo oblogo (glede na SIST EN 1789). Zaradi zagotavljanja konstrukcijske trdnosti je v omejenih območjih dovoljeno zmanjšanje dimenzij do največ 5%; to ne velja za odprtine vrat. V = višina, merjena od tal do stropa.

Tip B:

- višina (V): minimalno 1600 mm
- dolžina bolniškega prostora: minimalno 2500 mm
- širina bolniškega prostora merjena na najširši točki: minimalno 1740 mm

Tip C:




- višina (V): minimalno 1800 mm
- dolžina bolniškega prostora: minimalno 3000 mm
- širina bolniškega prostora merjena na najširši točki: minimalno 1740 mm

V reševalnih vozilih tipa C mora biti pacientov prostor ustrezno dimenzioniran, da omogoča območje za zdravljenje, skladno z merami, prikazanimi na spodnji sliki. Vsi konstrukcijski elementi, ki segajo v to območje, morajo biti oblikovani in izdelani tako, da jih je mogoče zložiti ali umakniti, s čimer se zagotovi spoštovanje minimalnih predpisanih dimenzij.

Sedež v shranjenem položaju ter medicinska oprema, ki se uporablja z njegovega delovnega mesta, lahko segata v območje za zdravljenje pod naslednjimi pogoji:

- največje dopustno seganje v območju vzglavja nosil znaša 125 mm,
- ali največ 125 mm na eni strani oziroma skupno največ 125 mm na obeh straneh.

Preverjanje skladnosti dimenzij prostora za zdravljenje se opravi, ko so nosila postavljena v srednjem položaju prostora za zdravljenje.



Reševalno vozilo tip C. vir: SIST EN 1789

3. Standardna opremljenost vozil za izvajanje službe NMP in prevoze pacientov

3.1. Standardna opremljenost NRV (SIST EN 1789 tip C) vključuje vsaj:

- nosila s tremi prečnimi in čezramenskimi pasovi ter stojalom za infuzije;
- kardiološki stol z gosenicami;
- dve kisikovi jeklenki s kapaciteto po 10 litrov;
- na levi steni bolniškega prostora: monitor/defibrilator, ventilator, aspirator in perfuzor;
- kamera za nadzor bolniškega prostora;
- grelec infuzijskih raztopin;
- hladilnik infuzijskih raztopin;
- zabojnik za ostre predmete;
- dve čeladi za tehnično reševanje z vizirjem in naglavno lučko v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika;
- oprema in pripomočki v skladu s Prilogo 4 tega pravilnika;
- varnost potnikov in ekipe je dodatno zagotovljena s skladnostjo s SIST EN 1789, ki določa zahteve za crash-teste nosil, omaric in sistemov za pritrditev opreme v reševalnem vozilu.

3.2. Standardna opremljenost VUZ vključuje vsaj:

- grelec infuzijskih raztopin;
- hladilnik infuzijskih raztopin;
- dve čeladi za tehnično reševanje z vizirjem in naglavno lučko v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika;
- oprema in pripomočki v skladu s Prilogo 4 tega pravilnika.

3.3. Standardna opremljenost reševalnega motorja vključuje vsaj:

- oprema in pripomočki v skladu s Prilogo 4 tega pravilnika.

3.4. Standardna opremljenost VDZ vključuje vsaj:

- dve čeladi za tehnično reševanje z vizirjem in naglavno lučko;
- oprema in pripomočki v skladu s Prilogo 4 tega pravilnika.

3.5. Standardna opremljenost RV vključuje vsaj:

- nosila s tremi prečnimi in čezramenskimi pasovi;
- kardiološki stol na elektromotorni pogon;
- dve kisikovi jeklenki kapacitete po 10 litrov;
- dve čeladi za tehnično reševanje z vizirjem in naglavno lučko v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika;
- grelec infuzijskih raztopin;
- hladilnik infuzijskih raztopin;
- oprema in pripomočki v skladu s Prilogo 4 tega pravilnika;
- varnost potnikov in ekipe je dodatno zagotovljena s skladnostjo s SIST EN 1789, ki določa zahteve za crash-teste nosil, omaric in sistemov za pritrditev opreme v reševalnem vozilu.

3.6. Standardna opremljenost sanitetnega vozila vključuje vsaj:

- polavtomatski defibrilator;
- dihalnim balonom z obraznimi maskami;
- osebna zaščitna oprema (nitrilne rokavice, maske IIR in FFP2/3);
- obvezilni sanitetni material;
- vrečke za bruhanje.

3.7. Vozila za prevoz osebja

Vozilo izpolnjuje pogoje za osebno vozilo (M1) z osmimi sedeži in je namenjeno za prevoz zdravstvenega osebja na kraj dogodka v primeru večjih nesreč ali drugih izrednih dogodkov (npr. javne prireditve). Tam, kjer je to smiselno, se lahko to vozilo uporablja za izvajanje sanitetnih prevozov. Vozilo dobi obliko nadgradnje »SG – vozilo za posebne namene« in dodatni opis »NMP -prevoz osebja«. V vozilih je nameščena naslednja medicinska oprema:

- polavtomatski defibrilator
- torba za oživljanje z dihalnim balonom in obraznimi maskami
- obvezilni sanitetni material
- vratne opornice, ki omogočajo kontrolo pulza (vse velikosti za odrasle in otroke)
- osebna zaščitna oprema (nitrilne rokavice, maske IIR in FFP2/3)
- vrečke za bruhanje

3.8. Vozila za vodenje, podporo in komunikacije

Vozilo izpolnjuje pogoje za osebno vozilo (M1) ali tovorno vozilo (N1 oziroma N2) in je namenjeno za izvajanje vodenja v primeru velikih nesreč in drugih izrednih dogodkov, za izvajanje podpore delovanju ekip NMP na terenu ter za zagotavljanje komunikacij v primeru velikih nesreč ali drugih izrednih dogodkih. Vozilo dobi obliko nadgradnje »SG – vozilo za posebne namene« in dodatni opis »NMP - vodenje in komunikacija«. Vozilo je razdeljeno na tri funkcionalne dele:

3.8.1. Vozniška kabina je namenjena upravljanju vozila in izvajanju osnovnih komunikacij na poti na kraj dogodka. Voznikov in sovoznikov sedeža sta vrtljiva, tako da se po potrebi uporabljata v srednjem delu vozila.

3.8.2. Srednji del je namenjen za vodenje zahtevnejših intervencij na terenu in za izvajanje kontrole kakovosti dela. V tem delu se nahaja prostor za operativno osebje, vsi elementi za upravljanje z dodatnimi ITK sistemi, prostor za delo ter prostor za hranjenje dokumentacije.

3.8.3. Zadnji del je namenjen za namestitvev medicinske in reševalne opreme: navozna izvlečna ploščad s potrebnimi prostori za namestitvev/shrambo opreme. Navozna ploščad ima sistem za enostavno snetje z vozila. Na izvlečni ploščadi so vgrajeni naslednji sistemi:

- grelec infuzijskih tekočin (volumen grelca zadošča za min 8 infuzijskih raztopin)
- hladilnik infuzijskih tekočin
- polavtomatski defibrilator
- komplet imobilizacijskih vakuumskih opornic
- zajemalna nosila
- prenosni električni aspirator
- prenosni ventilator
- prostor za obstoječi mobilni repetitor
- nahrbtnik za nujno medicinsko pomoč
- oprema za zahtevnejše intervencije in reševanje z višine ali globine:
 - plezalni nahrbtnik 2 kosa
 - klasičen gorniški enodelni pas, namenjen tako za alpinizem kot za varovanje na zavarovanih planinskih poteh, z enostavnim oblačenjem, popolnoma nastavljiv. 2 kom
 - vponka (karabin) na vzmet, 10 kom.
 - osmica (močna) za varovanje in spuščanje po vrvi, 2 kom.
 - ročni prižem za vzpenjanje po vrvi, 2 kom.
 - prsni prižem za vzpenjanje po vrvi, 2 kom.
 - samovarovalni komplet za plezanje, 2 kom.
 - pomožna vrvica, Ø = 8, dolžina 5,5 m, 2 kom

- pomožna vrvica, Ø = 7, dolžina 5,5 m, 2 kom
- pomožna vrvica, Ø = 6, dolžina 1,5 m, 2 kom
- plezalna vrv Ø = 10 (ali 10,2), dolžina 60 m (lahko dinamična ali statična) 1 kom.
- neskončen trak 150 cm, 2 kom.
- gorniške rokavice z ojačanimi dlanmi, 2 kom
- triažni komplet z vsaj 50 triažnimi kartoni
- Dve 10 litrski kisikovi jeklenki z reducirnim ventilom, 50 metriskim podaljškom in 5 dozatorji za kisik brez vlažilcev zraka
- komplet za aplikacijo kisika v torbi z 2 litrsko jeklenko, reducirnim ventilom in dozatorjem kisika brez vlažilca za zrak 5 kosov
- bencinski agregat moči vsaj 2 kW. Agregat je namenjen za notranjo uporabo, zaprt in zvočno izoliran

Vozilo je opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo po točki 2.3 te priloge.

3.9 Mobilna bolnišnica

Vozilo izpolnjuje pogoje za eno izmed vozil kategorije M2, M3, N2 ali N3 (vključno z različicami z raztegljivo karoserijo), vlečno vozilo s polpriklopnikom (N3 + O3/O4), vozilo z dvižno kljuko in zamenljivimi kontejnerskimi moduli, priklopno vozilo (O3 ali O4) s stalno nameščeno ali raztegljivo nadgradnjo. Vozilo dobi obliko nadgradnje »SG – vozilo za posebne namene« in dodatni opis »NMP-vodenje in komunikacija«. Vozilo dobi obliko nadgradnje »SG – vozilo za posebne namene« in dodatni opis »NMP - mobilna bolnišnica«. Vozilo je namenjeno zagotavljanju začasnih kapacitet za triažo, obravnavo in zdravljenje pacientov na terenu ter nudenju podpore ob množičnih nesrečah, večjih intervencijah in pri organiziranju zdravstvenega varstva na večjih javnih ali posebnih dogodkih.

Vozilo mora biti opremljeno z:

- medicinsko opremo za osnovno ali napredno oskrbo pacientov,
- sistemom za električno napajanje (lastni agregat ali zunanji priklop),
- ustrezno razsvetljava in ogrevanjem/hlajenjem bolniškega prostora,
- vgrajenimi sistemi za pritrjevanje nosil, sedežev in medicinske opreme skladno s SIST EN 1789.

Na zgornjem delu vozila spredaj in zadaj vsaj ena delovna luč, na straneh vsaj dve, moč delovne luči mora biti minimalno 1870 lumnov. Na zadnjem delu vozila delovna luč, ki služi tudi kot luč za vzvratno vožnjo.

Mobilna bolnišnica je lahko dodatno konfigurirana kot KBRJ enota, infekcijsko izolacijsko vozilo, mobilna kirurška enota, logistični center ali učni modul, če so temu prilagojeni prostori in oprema.

Vozilo je opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo po točki 2.3 te priloge.

4. Določitev največjega števila prevoženih kilometrov, starost in tehnična ustreznost vozil za izvajanje službe NMP ter prevoze pacientov

4.1. Vozila za izvajanje službe NMP

- vozilo sme v službi NMP izvajati funkcijo MoE NRV do prevoženih 350.000 km ali do dopolnjenih 6 let starosti vozila;
- vozilo sme v službi NMP izvajati funkcijo MoE VUZ do prevoženih 350.000 km ali do dopolnjenih 10 let starosti vozila;
- reševalni motor sme v službi NMP izvajati funkcijo MoE RM do prevoženih 100.000 km ali do dopolnjenih 6 let starosti motorja;
- vozilo sme v službi NMP izvajati funkcijo MoE VDZ do prevoženih 350.000 km ali do dopolnjenih 10 let starosti vozila.

Vozila, ki dosegajo omenjene meje, se lahko nato uporabljajo za potrebe rezervnih vozil, vendar samo do meje 450.000 km ali dopolnjene starosti 10 let (MoE NRV) oziroma 12 let (MoE VUZ/VDZ) in 150.000 km ali dopolnjene starosti 10 let (MoE RM).

4.2. Vozila za prevoze pacientov

- nenujno reševalno vozilo sme izvajati nenujnih reševalnih prevozov do prevoženih 550.000 km ali do dopolnjenih 10 let starosti vozila
- sanitetno vozilo sme prevoze pacientov izvajati do prevoženih 650.000 km ali do dopolnjenih 10 let starosti vozila

Vozila, ki dosegajo omenjene meje, se lahko nato uporabljajo za potrebe rezervnih vozil, vendar samo do meje 650.000 km ali dopolnjene starosti 12 let (nenujno reševalno vozilo) in 750.000 km ali dopolnjene starosti 14 let (sanitetno vozilo). Upošteva se postavka, ki je bila prej dosežena - bodisi kilometrina, bodisi starost vozila.

5. Prostorske zahteve

Navedena je minimalna vsebina, enote lahko po lastni presoji vsebino razširijo.

5.1. Prostorske zahteve na lokaciji izvajalca

- garažni prostor za operativna vozila
- garažni prostor ali prostor z nadstreškom za rezervna vozila
- garažni prostor ali prostor z nadstreškom za pranje vozil z visokotlačnim čistilcem
- prostor za shranjevanje visokotlačnega čistilca, krpe, čistila in ostale pripomočke za čiščenje vozil
- prostor za osebje (garderobe, kuhinja z jedilnico, prostori za počitek, pisalne mize, predavalnica, sanitarije, prostor za usposabljanje in prostor za skladiščenje opreme, pripomočkov in materiala)

5.2. Prostorske zahteve na dislociranih lokacijah izvajalca

- prostor z nadstreškom ali garažni prostor
- prostor za higiensko vzdrževanje vozil z visokotlačnim čistilcem ali
- znotraj kraja dislocirane enote avtopralnica za higiensko vzdrževanje vozil
- prostor za ekipo (miza s stoli, sanitarije in ležišča)

Vsi prostori imajo možnost električnega napajanja vozil.

Priloga 7: Podatki, ki jih obdobjno poročajo MoE NMP, DSZ, SUC in UC

Poročanje je ločeno na posamezne entitete. Poroča se vsakih šest mesecev. Prvo poročanje se najkasneje do septembra izvede za obdobje od januarja do junija tekočega leta. Drugo poročanje pa se najkasneje do marca izvede za obdobje od julija do decembra preteklega leta.

MoE NMP, ki niso vključene v DSZ, poročajo tudi podatke naštetih pod DSZ, ki so označene z zvezdico(*)

Poroča DSZ
Število izvedenih intervencij z možnostjo pregleda po: <ul style="list-style-type: none">– Dispečerskem centru zdravstva,– izvajalcu službe NMP,– po identifikacijski številki vozila,– prioritetah,– odzivih,– preklicih.
Prikaz podatkov na podlagi zgornje točke: <ul style="list-style-type: none">– aktivacijski čas MoE (od aktivacije s strani DSZ do statusa SPREJETO),– odzivni čas MoE (od statusa SPREJETO do statusa NA POTI)*,– izvozni čas (od aktivacije s strani DSZ do statusa NA POTI)*,– dostopni čas (od javljanja zdravstvenega dispečerja na klic do statusa NA KRAJU)*,– čas obravnave pacienta na kraju (od statusa NA KRAJU do statusa SE VRAČA)*,– čas trajanja intervencije MoE NMP (od statusa SPREJETO do statusa NA CILJU)*,– čas predaje pacienta (od statusa NA CILJU do statusa ZAKLJUČEK INT)*,– skupni čas trajanja intervencije ekipe NMP (od statusa SPREJETO do statusa PROST)*,– število prevoženih kilometrov*,– število obravnavanih intervencij ločeno po karticah in kriterijih ob oddaji intervencije,– število pripeljanih pacientov (ločeno po končnih lokacijah: UC, SUC, druge zdravstvene zavode)*.
Število klicev z možnostjo filtriranja po: <ul style="list-style-type: none">- DCZ
Prikaz podatkov na podlagi zgornje točke: <ul style="list-style-type: none">– število klicev iz številke 112*,– število aktivacij Regijske koordinacijske skupine zdravstva,– podatki o klicatelju na dogodkih, ločeno po kategorijah (svojci, očitvidci, policija, zdravnik, zdravstveni dispečer, drugo)*,– število dogodkov, ki niso rezultirali v izvoz MoE, ločeno po kategorijah (posvet zdravstvenega dispečerja, posvet zdravnika NMP, ostalo)*,– število dispečersko podprtih oživiljanj,– število podanih zahtev za aktivacijo PPO*.

DSZ podatke pripravi v excel tabeli z možnostjo filtriranja ali drugem enakovrednem programu.

Poroča enota NMP

Delo znotraj ambulant nujne medicinske pomoči:

- število pacientov, obravnavanih v časovnem obdobju,
- število oživljanj.

Delo na terenu:

- število pacientov, obravnavanih na terenu,
- število pripeljanih pacientov v UC,
- število pripeljanih pacientov v SUC,
- število pripeljanih pacientov v ZD/DM,
- število pripeljanih pacientov v druge zdravstvene zavode,
- število pacientov, ki so po obravnavi ostali na kraju dogodka,
- število mrtvih pred prihodom na kraj dogodka,
- skupno število oživljanj na terenu
 - število oživljanj z uspešno vzpostavitvijo spontanega krvnega obtoka,
 - število oživljanj brez uspešne vzpostavitve spontanega krvnega obtoka,
- število endotrahealnih intubacij,
- število uporabljenih supraglotičnih pripomočkov,
- število vzpostavljenih venskih poti,
- število vzpostavljenih osalnih poti,
- število posnetih 12 kanalnih EKG,
- število pacientov, ki so bili defibrilirani,
- število pacientov, pri katerih je bila uporabljena zunanja elektro stimulacija,
- število pacientov, pri katerih je bila uporabljena zunanja elektro konverzija,
- število pacientov, ki so bili pod vplivom alkohola,
- število pacientov, ki so bili pod vplivom mamil,
- število pacientov, pri katerih je bilo potrebno posredovanje policije.

Posredovanja prvih posredovalcev (PPo):

- število aktivacij PPo,
- povprečni odzivni čas PPo (čas od klica do prihoda na kraj dogodka),
- število oživljanj, ki so jih začeli PPo
 - število pacientov, ki so bili defibrilirani s strani PPo,
- število oživljanj z uspešno povrnitvijo spontanega krvnega obtoka s strani PPo pred prihodom MoE NMP,
- število oživljanj, pri katerih je prišlo do povrnitve spontane cirkulacije po prihodu MoE NMP,
- število aktivacij PPo zaradi tujkov v dihalnih poteh,
- število aktivacij PPo zaradi večjih zunanjih krvavitev,
- povprečni čas od prihoda PPo do prihoda MoE NMP.

Administracija dela PPo:

- trenutno število PPo z veljavnim potrdilom,
- število inštruktorjev, ki sodelujejo pri izobraževanju PPo,
- število izvedenih osnovnih izobraževanj za PPo
 - skupno število tečajnikov na osnovnem izobraževanju,
- število izvedenih obnovitvenih izobraževanj za PPo
 - skupno število tečajnikov na obnovitvenih izobraževanjih.

Poroča UC/SUC

Sprejem in triaža:

1. število prihodov pacientov
 - po trižnih kategorijah Manchestrskega trižnega sistema (MTS),
 - po izbranem algoritmu MTS glede na vodilno pacientovo težavo,
 - po načinu prihoda (sam / MoE NMP),
 - v časovnem obdobju,
 - z/brez napotnice,
 - po občini prebivanja,
2. po napotnih zdravnikih,
3. povprečni čas čakanja na pregled po trižnih kategorijah,
4. število re-triažiranih pacientov.

Obravnavanje pacienta:

5. število obravnav po enotah
 - število prvih pregledov (v časovnih obdobjih),
 - število pacientov sprejetih na bolnišnično zdravljenje,
6. povprečni čas obravnave (od pregleda v enoti do odpusta/sprejema),
7. opazovalnica
 - število opazovanih pacientov po enotah,
 - povprečna zasedenost opazovalnice po urah,
8. število pacientov premeščenih na višji nivo zdravstvene obravnave.

Kakovost dela UC/SUC:

9. povprečni čas izvajanja triže,
10. število/delež podtriažiranih ali nadtriažiranih pacientov,
11. število/delež prekoračitve dopustnega čakalne časa glede na opredeljeno trižno kategorijo,
12. število/delež prekoračenega časa obravnave v UC/SUC,
13. število varnostnih odklonov.

Priloga 8: Osnovni in obnovitveni program usposabljanja za prve posredovalce

ZAP. ŠT.	TEMA	OBSEG MINUTAH	V	OSNOVNI	OBNOVITVENI
	PREDAVANJA				
1.	sistem NMP, AED in prvi posredovalci	20 min		X	
2.	pregled trenutnega delovanja sistema, pogovor o intervencijah in novosti	20 min			X
3.	ocena varnosti in srčni zastoj	20 min		X	
4.	TPO odraslih	20 min		X	
5.	AED	20 min		X	
6.	TPO otrok	20 min		X	
7.	tujki v dihalnih poteh in krvavitve	20 min		X	
8.	vprašanja in diskusija	10 min		X	
	DELAVNICE				
9.	TPO odraslih z uporabo AED	70 min		X	X
10.	TPO otrok z uporabo AED	70 min		X	X
11.	ukrepanje ob tujkih v dihalnih poteh, zaustavljanje večjih zunanjih krvavitev in položaj za nezavestnega	70 min		X	X
12.	praktično preverjanje znanja	70 min		X	X
	ZAKLJUČEK				
13.	teoretično preverjanje znanja	20 min		X	
14.	aktivacija PPO, predaja pacienta ekipi NMP in pogovor po intervenciji	20 min		X	
15.	nameščanje aplikacij, potrdila o udeležbi in zaključek usposabljanja	10 min		X	
	SKUPNO ŠTEVILO (min/ur)	480 min		8 ur	5 ur

Dodatna obrazložitev:

- a. Udeleženci usposabljanja prejmejo Priročnik za prve posredovalce najmanj 21 dni pred začetkom usposabljanja;
- b. Teoretično in praktično preverjanje znanja se izvede pod strokovnim nadzorom zdravstvenega delavca z ustreznimi znanji in usposobljenostjo iz točke 2.1. Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ki tudi poda potrditev o uspešno opravljenem preverjanju;
- c. Pomen kratic:
 - AED = avtomatski zunanji defibrator (ang. automated external defibrillator),
 - TPO = temeljni postopki oživljanja,
 - PPO = prvi posredovalci.

Priloga 9: Obrazec prijave javne prireditve oziroma shoda za izračun potrebnega zdravstvenega varstva in načrt zdravstvenega varstva na prireditvi

Obrazec je potrebno izpolniti za vsako prireditev in ga priložiti prijavi prireditve policiji oziroma v primeru potrebe po dovoljenju pristojni upravnici enoti. Priporočamo uporabo spletnega obrazca na e-upravi: <https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/drustva-javne-prireditve/javne-prireditve-in-shodi.html>. Obrazec je dostopen tudi na spletni strani ministrstva.

Navodila:

Lokacija: če obstaja naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta), če naslova ni, vpišite najbližji naslov in opišite dostop do lokacije, ter dopišite

GPS koordinate: koordinate lokacije po Google Maps (npr. 46.05338, 14.50272 ali 46°03'12.2"N 14°30'09.8"E).

Datum/ura začetka: Datum in ura predvidenega začetka prireditve.

Datum/ura zaključka: Datum in ura predvidenega zaključka prireditve.

Vrsta prireditve (opis dogajanja): Opišite vrsto prireditve (npr. športno-kolesarska, gasilska veselica, tekmovanje v lokostrelstvu, ipd.).

1.ŠTEVILO UDELEŽENCEV (ŠU): Pričakovano število udeležencev na prireditvi. Obkrožite eno izmed ponujenih trditvev.

2. ZDRAVSTVENO TVEGANJE (ZT): Izračunate starostno strukturo udeležencev v % in izberete eno izmed ponujenih trditvev. Pri izbiri trditve **a** je ZT nizko, pri izbiri trditvev **b** ali **d** je ZT srednje in pri izbiri trditvev **c** ali **e** je ZT visoko.

3. TVEGANJE ZA DOGODKE (TD): Našteti so določeni dejavniki, ki vplivajo na oceno ogroženosti prireditve. Obkrožite tiste, ki veljajo za prireditev. Če je v vseh točkah obkrožen NE, potem je TD nizko, če je obkrožen vsaj en DA, je TD visoko.

4. POSEBNE OKOLIŠČINE (PO): V rubriki obkrožite tiste trditve, ki veljajo za prireditev. Če je v vseh točkah obkrožen NE, potem PO okoliščin za prireditev ni, če je obkrožen vsaj en DA, potem PO so.

Posebne okoliščine se upoštevajo samo pri določenih vrstah prireditvev, kjer je zaradi razdeljenega prizorišča ali daljše oddaljenosti lokalne enote NMP potrebno zagotoviti dodatne člane ali ekipe NMP.

Drugi ukrepi zagotovljeni na prireditvi oziroma podatki, ki lahko vplivajo na zdravstveno ogroženost: V rubriko vpišete informacije, ki bi pri presoji določitve potrebnega zdravstvenega varstva na prireditvi imele vpliv (če bo npr. na prireditvi organizirana požarna straža, prisotnost gorskih reševalcev, reševalcev iz vode,...).

Vrsta prireditve: Vrsto prireditve izračunajte s pomočjo kalkulatorja na strani ministrstva in jo prepisite v ta razdelek. Vrsto prireditve lahko na podlagi kriterijev izračunate tudi iz Priloge 10 tega pravilnika.

Organizator: V predvidene rubrike vpišite uradni naziv organizatorja, naslov, e-mail naslov in telefon, na katerega bo uradna oseba organizatorja dosegljiva med postopkom izdaje dovoljenja za javno prireditev in med samo prireditvijo.

Izvajalec zdravstvenega varstva: V predvidene rubrike vpišite uradni naziv izvajalca, naslov, e-naslov in telefon, na katerega bo izvajalec zdravstvenega varstva na prireditvi dosegljiv med samo prireditvijo in na katerega ga bo po potrebi kontaktiral tudi pristojni dispečerski center zdravstva. Če so zagotovljene ustrezne tehnične možnosti, je lahko izvajalec dosegljiv tudi preko sistema radijskih zvez.

Podpis in žig: Obrazec se lahko podpiše tudi z digitalnim podpisom. V tem primeru žig ustanove/izvajalca ni potreben.

Potrdi pristojna enota NMP: Za manj zahtevno prireditev mora biti obrazec ob vložitvi vloge pristojnemu organu predhodno potrjen s strani izvajalca službe NMP, ki deluje na območju, kjer se bo prireditev izvedla

POZOR:

- Podatki o dogodku, izvajalcu zdravstvenega varstva in kontaktni podatki bodo sporočeni DSZ.
- Za srednjo, zahtevno, zelo zahtevno in tvegano prireditev je potrebno izdelati tudi načrt zdravstvenega varstva na prireditvi v skladu z 22. členom tega pravilnika.

Obrazec prijave javne prireditve/shoda za izračun potrebnega zdravstvenega varstva

Lokacija		GPS koordinate	
Datum/ura začetka		Datum/ura zaključka	
Vrsta prireditve (opis dogajanja):			

1. ŠTEVILO UDELEŽENCEV (ŠU)		2. ZDRAVSTVENO TVEGANJE (ZT)	
<input type="checkbox"/> a) <500	<input type="checkbox"/> e) 5.000- 10.000	<input type="checkbox"/> a) >70% udeležencev pod 50 let	
<input type="checkbox"/> b) 500 – 1.000	<input type="checkbox"/> f) 10.000- 20.000	<input type="checkbox"/> b) >30% oseb starejših od 65 let	
<input type="checkbox"/> c) 1.000- 3.000	<input type="checkbox"/> g) 20.000- 30.000	<input type="checkbox"/> c) >50% starejših od 65 let	
<input type="checkbox"/> d) 3.000- 5.000	<input type="checkbox"/> h) >30.000	<input type="checkbox"/> d) enakovredna porazdelitev st.skupin	
		<input type="checkbox"/> e) prisotne zdr. ogrožene skupine ljudi	

3. TVEGANJE ZA DOGODKE (TD)	
a) Uporaba predmetov in naprav, ki lahko ogrožajo zdravje in/ali življenje udeležencev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
b) Izvajanje aktivnosti s hujšimi telesnimi obremenitvami udeležencev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
c) Možnost nekontroliranega ali škodljivega oziroma nasilnega ravnanja udeležencev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
d) Možnost poškodb udeležencev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

4. POSEBNE OKOLIŠČINE (PO)	
a) Prireditev se odvija na različnih mestih oziroma poteka prireditve ni možno vnaprej natančno oceniti zaradi nepredvidljivega obnašanja udeležencev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
b) Prireditev je od najbližjega izvajalca službe NMP oddaljena več kot 15 minut vožnje	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
c) Prireditve se ob morebitnem transportu pacienta v nadaljnjo zdravstveno obravnavo ne sme ali ne želi prekiniti.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

Drugi ukrepi, zagotovljeni na prireditvi oziroma podatki, ki lahko vplivajo na zdr. ogroženost:

Določena vrsta prireditve (po prilogi 10). Za izračun vrste prireditve upoštevamo točke 1-4.
Vrsta prireditve:

*Telefonska številka, na kateri bo izvajalec zdravstvenega varstva na prireditvi dosegljiv med samo prireditvijo.

Organizator		Izvajalec zdravstvenega varstva	
Naziv		Naziv	
Naslov		Naslov	
Tel. št.*		Tel. št.*	
e-pošta		e-pošta	
Podpis in žig		Podpis in žig	

Potrdi pristojna enota NMP, če gre za manj zahtevno prireditev.

Naziv pristojne enote NMP		Datum in žig	
Ime, priimek ter podpis potrjevalca			

Načrt zdravstvenega varstva na prireditvi

Datum in ura začetka prireditve	
Datum in ura zaključka prireditve	
Vrsta določene prireditve	

Pripravljalavec načrta	
Ime in priimek	
Kontakt (e-mail, telefon)	

Odgovorna oseba zdravstvenega varstva na prireditvi	
Ime in priimek	
izobrazba	
Kontakt (e-mail, telefon)	

Načrt odobril Enota NMP:	
Ime in priimek odgovorne osebe	
Kontakt (telefon, e-mail)	
Datum	
Podpis in žig*	

Načrt odobril DSZ	
Ime in priimek odgovorne osebe	
Kontakt (telefon, e-mail)	
Datum	
Podpis in žig*	

Načrt odobril UC:	
Ime in priimek odgovorne osebe	
Kontakt (telefon, e-mail)	
Datum	
Podpis in žig*	

* Obrazec se lahko podpiše tudi z digitalnim podpisom. V tem primeru žig ustanove/izvajalca ni potreben.

Vsebina	
1	O načrtu 111
2	Opis prireditve, število udeležencev in možnih tveganj 111
2.1	Dogodki znotraj prireditve 111
3	Skica prireditvenega prostora z vrisanimi elementi zdravstvenega varstva 112
4	Predvidene ekipe in vozila 112
4.1	Ekipe 112
4.2	Vozila 113
5	Načrt komunikacij 113
5.1	Komunikacije med člani ekip na prireditvi 113
5.2	Komunikacija z DSZ 113
6	Seznanitev z načrtom 114

1 O načrtu

Načrt se izdelata za vse srednje, zahtevne in zelo zahtevne ter tvegane prireditve. Načrt pripravi organizator prireditve v sodelovanju z izvajalcem zdravstvenega varstva na prireditvi.

V primeru dogodkov na prireditvi, ki narekujejo večji obseg izvajanja zdravstvenega varstva, kot ga opredeljuje dogovor med organizatorjem prireditve in izvajalcem zdravstvenega varstva na prireditvi, stroške krije organizator prireditve. Enako velja, če sta zaradi prireditve dodatno obremenjena izvajalec službe NMP na območju prireditve, UC in dispečerska služba zdravstva.

Pri zelo zahtevni in tvegani prireditvi, ki je od najbližjega UC oddaljena več kot 30 minut nujne vožnje, mora biti predvideno tudi mesto za pristanek helikopterja.

2 Opis prireditve, število udeležencev in možnih tveganj

Navodila: Vpišite kaj se bo na prireditvi dogajalo, število predvidenih gledalcev. Število aktivnih udeležencev, možna tveganja glede na vrsto prireditve.

2.1 Dogodki znotraj prireditve

Navodila: To točko izpolnite, kadar traja prireditev več dni in/ali na različnih prizoriščih. Če ni relevantna jo izpustite..

3 Skica prireditvenega prostora z vrisanimi elementi zdravstvenega varstva

Navodila: Dodajte sliko prireditvenega prostora, za vse vrisane elemente dodajte legendo. Vrisati je potrebno glede na velikost in vrsto prireditve naslednje elemente: predvidena mesta reševalnih vozil, šotorov prvih pomoči oz. stacionarnih mest NMP, kontaktne točke, predvidena pot odvoza, zbirno mesto, določeno mesto za pristanež helikopterja, ... Kadar se prireditve izvaja na različnih lokacijah vključite skupno skico vseh lokacij in nato skice posamezne lokacije.

4 Predvidene ekipe in vozila

Seznam predvidenih ekip in vozil je namenjen lažjemu načrtovanju in koordinaciji med samim dogodkom. Kadar pride do spremembe ali zamenjave predvidenih članov MoE ali vozila po odobritvi načrta, se to primerno označi. Popravljen verzija lahko od podpisane odstopa zgolj z enakovrednimi zamenjavami (Organizator prireditve mora razpolagati z dogodka.

4.1 Ekipe

Navodila: Poimensko vpišite člane ekip izvajalca zdravstvene dejavnosti na prireditvi in označite njihovo usposobljenost glede na Pravilnik o NMP.

Člani ekip	naziv	Usposobljenost

4.2 Vozila

Navodila: Za predvidena vozila vpišite registrsko oznako, namembnost (VUZ, NTV, motor) ter številko, ki je dodeljena iz klasifikacijskega načrta DSZ. Če je ni, vpišite interno oznako vozila/ klicni znak.

Registrska oznaka	namembnost	DSZ oznaka vozila

5 Načrt komunikacij

Da se ob prisotnosti več MoE doseže optimalno pokritost prizorišča (kolesarske dirke, maratoni, zelo zahtevne in tvegane prireditve), je potrebno poskrbeti za enoten sprejem nujnih obvestil, medsebojno koordinacijo in komunikacijo z dispečerskim centrom zdravstva. Ob takšnih prireditvah se predvidi prisotnost dispečerja – koordinatorja.

5.1 Komunikacije med člani ekip na prireditvi

Navodila: Opišite kako bo zagotovljena komunikacija med ekipami, dodajte imenik telefonskih številk/ radijskih frekvenc. Opišite način sprejema nujnega obvestila o dogodku in pot obveščanja.

5.2 Komunikacija z DSZ

Zdravstveni delavci, se morajo ob začetku in zaključku izvajanja zdravstvenega varstva na prireditvi javiti pristojnemu DCZ.

Navodila: Opišite kako bo zagotovljena komunikacija med prizoriščem in DSZ, telefon/frekvenca. Kdo je za to odgovoren, kdaj in katere podatke se sporoča.

6 Seznani tev z načrtom

Načrt za srednje in zahtevne prireditve potrdi odgovorna oseba službe NMP na območju prireditve, za zelo zahtevne in tvegane prireditve pa še odgovorna oseba DSZ in UC.

Potrjevalci načrta lahko načrt potrdijo v celoti ali zahtevajo dopolnitve. Načrt je sprejet, ko ga potrdijo vse glede na vrsto prireditve določene odgovorne osebe.

Z načrtom morajo biti seznanjeni vsi izvajalci zdravstvenega varstva na prireditvi.

Priloga 10: Vrste prireditev in izvajalci zdravstvenega varstva na prireditvah

UDELEŽENCI				VRSTA PRIREDITVE	IZVAJALCI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	
ŠU ¹	ZT ²		TD ³ PO ⁴			
<500	VSE ⁵	in	NT ⁶	Nezahtevna prireditev A	Posebno zdravstveno varstvo ni potrebno, razen če organizator ali uradni organ glede na vrsto in program prireditve presodi drugače.	
500 - 999	NT, ST ⁷	in	NT	Nezahtevna prireditev B	Prisotnost najmanj ene osebe s strani organizatorja, ki ima opravljen najmanj 8-urni tečaj prve pomoči, ki ni starejši od petih let in vključuje znanja in veščine temeljnih postopkov oživljanja in ima za nudenje prve pomoči pri sebi komplet za prvo pomoč, ki je del obvezne opreme motornih vozil.	
<1000	VSE	in	VT ⁸	Manj zahtevna prireditev B	Prisotnost najmanj ene MoE NRV.	
1000 – 3000	NT, ST	in	in PO	NT	Manj zahtevna prireditev A	Prisotnost najmanj ene ekipe za izvajanje nenujnih prevozov, v skladu s tem pravilnikom.
					Manj zahtevna prireditev A+	Zaradi posebnih okoliščin še dodaten zdravstveni reševalec ali dodatna ekipa za izvajanje nenujnih prevozov.
1000 - 3000	VT	ali	in PO	VT	Srednje zahtevna prireditev A	Prisotnost najmanj ene MoE NRV z zdravnikom
					Srednje zahtevna prireditev A+	Zaradi posebnih okoliščin še dodaten zdravstveni reševalec ali dodatna ekipa za izvajanje nenujnih prevozov.
3000 - 5000	NT	in	in PO	NT	Manj zahtevna prireditev B	Prisotnost najmanj ene MoE NRV.
					Manj zahtevna prireditev B+	Zaradi posebnih okoliščin še dodaten zdravstveni reševalec ali dodatna ekipa za izvajanje nenujnih prevozov
3000 - 5000	ST, VT	ali	VT	Srednje zahtevna prireditev B	Prisotnost najmanj ene MoE NRV z zdravnikom in ene MoE NRV	
5000 - 10000	NT	in	NT	Srednje zahtevna prireditev B	Prisotnost najmanj ene MoE NRV z zdravnikom in ene MoE NRV	
5000 - 10000	ST, VT	ali	VT	Zahtevna prireditev	Prisotnost najmanj ene MoE NRV z zdravnikom in dveh MoE NRV	
10000 - 20000	NT	in	NT	Zahtevna prireditev	Prisotnost najmanj ene MoE NRV z zdravnikom in dveh MoE NRV	
10000 - 20000	ST, VT	ali	VT	Zelo zahtevna prireditev A	Vsaj eno delovišče zdravstvene obravnave z zdravnikom in diplomiranim zdravstvenikom ter najmanj ene MoE NRV z zdravnikom in dveh MoE NRV.	
20000 - 30000	VSE			Zelo zahtevna prireditev B	Vsaj eno delovišče zdravstvene obravnave z zdravnikom in diplomiranim zdravstvenikom ter najmanj dveh MoE NRV z zdravnikom in dveh MoE NRV. Število ekip se prilagodi stopnji tveganja.	
>30000	VSE			Tvegana prireditev A	Vsaj eno delovišče zdravstvene obravnave z zdravnikom in diplomiranim zdravstvenikom ter	

			najmanj dveh MoE NRV z zdravnikom in treh MoE NRV. Število ekip se prilagodi stopnji tveganja.
>20000	VSE in PO	Tvegana prireditve B	Vsaj eno delovišče zdravstvene obravnave z zdravnikom in diplomiranim zdravstvenikom ter najmanj ene ekipe NRV z zdravnikom in ene ekipe NRV v vsaki coni oziroma na vsakem prizorišču, kjer je 10000 udeležencev. Ekipe se nahajajo na vnaprej določenih točkah po načrtu.

¹ŠU = število udeležencev, ²ZT = zdravstveno tveganje, ³TD = tveganje za dogodke, ⁴PO = posebne okoliščine, ⁵VSE = velja za vsa tveganja, ⁶NT = nizko tveganje, ⁷ST = srednje tveganje, ⁸VT = visoko tveganje

Pri izračunu se kombinirajo naslednji kriteriji (izračun se lahko izvede tudi s pomočjo kalkulatorja na strani ministrstva <https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-zagotavljanje-zdravstvenega-varstva-na-prireditvah/>):

1. Število udeležencev (ŠU): pričakovano število udeležencev prireditve.

2. Zdravstveno tveganje (ZT): določimo glede na starostno in zdravstveno strukturo udeležencev

- a) Nizko tveganje (NT) – **a**) večinoma (> 70%) udeleženci pod 50 let,
- b) Srednje tveganje (ST) – **d**) prisotne vse starostne skupine približno enakovredno ali **b**) > 30% oseb starejših od 65 let,
- c) Visoko tveganje (VT) – **c**) več kot polovica udeležencev (> 50%) je starejših od 65 let ali **e**) kadar so prisotne zdravstveno ogrožene skupine ljudi.

3. Tveganje za dogodke (TD): določimo glede na vrsto dejavnosti na prireditvah. Za visoko tveganje (VT) gre, kadar se/je:

- a) uporabljajo predmeti in naprave, ki lahko ogrožajo zdravje in/ali življenje udeležencev,
- b) izvajajo aktivnosti z hujšimi telesnimi obremenitvami za udeležence,
- c) možnost nekontroliranega ali škodljivega oziroma nasilnega ravnanja udeležencev (uživanja alkohola, drog,...),
- č) možnost poškodb udeležencev.

4. Posebne okoliščine (PO): doda se posamezen član ekipe ali ekipa ob okoliščinah kot so:

- a) Prireditve se odvija na različnih mestih oziroma poteka prireditve zaradi nepredvidljivega obnašanja udeležencev ni možno vnaprej natančno oceniti,
- b) Prireditve je od najbližjega izvajalca službe NMP oddaljena več kot 15 minut vožnje,
- c) Prireditve se ob morebitnem transportu pacienta v nadaljnjo zdravstveno obravnavo ne sme ali ne želi prekiniti.

Obrazložitev:

MoE NRV z zdravnikom je ali kombinirana MoE NRV in MoE VUZ, ali MoE NRV z zdravnikom, ki je usposobljen v skladu s Prilogo 1 tega pravilnika in ima v vozilu dodatno opremo, ki je predpisana za VUZ iz Priloge 4 tega pravilnika in ni že sestavni del opreme NRV-ja.

POZOR:

Pri določanju števila ekip se upošteva tudi oddaljenost od najbližjega UC in podatki o dogodkih na prireditvi iz preteklih let.

Za vsako prireditve je potrebno priložiti izpolnjen obrazec iz Prilogi 9 tega pravilnika. Podatki o izvajalcu in dogodku bodo posredovani DSZ.

